

Ultrasonic Anemometer 1D


Bedienungsanleitung

4.3865.xx.xxx

4.3866.xx.xxx

4.3867.xx.xxx

ab Softwareversion V3.15

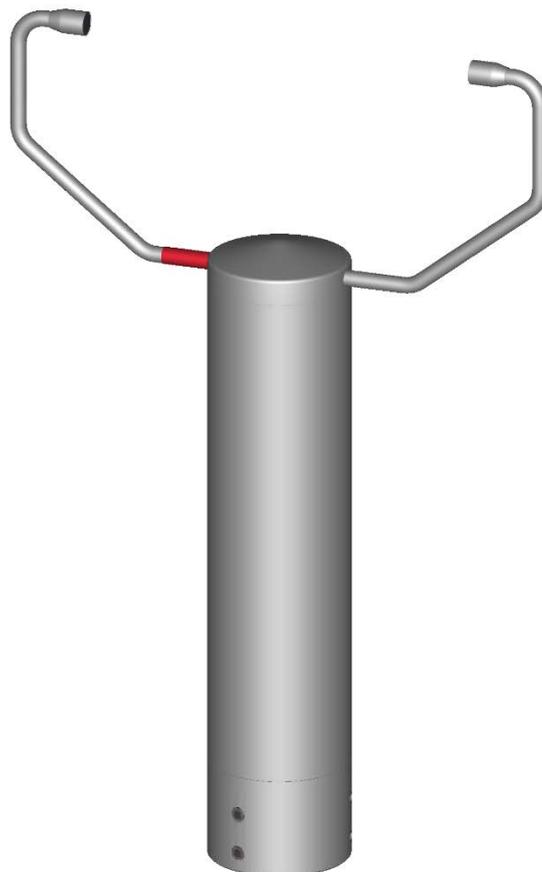

Dok. No. 021567/08/22

THE WORLD OF WEATHER DATA

Sicherheitshinweise

- Vor allen Arbeiten mit und am Gerät / Produkt ist die Bedienungsanleitung zu lesen. Diese Bedienungsanleitung enthält Hinweise, die bei Montage, Inbetriebnahme und Betrieb zu beachten sind. Eine Nichtbeachtung kann bewirken:
 - Versagen wichtiger Funktionen
 - Gefährdung von Personen durch elektrische oder mechanische Einwirkungen
 - Schäden an Objekten
- Montage, Elektrischer Anschluss und Verdrahtung des Gerätes / Produktes darf nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, der die allgemein gültigen Regeln der Technik und die jeweils gültigen Gesetze, Vorschriften und Normen kennt und einhält.
- Reparaturen und Wartung dürfen nur von geschultem Personal oder der **Adolf Thies GmbH & Co KG** durchgeführt werden. Es dürfen nur die von der **Adolf Thies GmbH & Co KG** gelieferten und/oder empfohlenen Bauteile bzw. Ersatzteile verwendet werden.
- Elektrische Geräte / Produkte dürfen nur im spannungsfreien Zustand montiert und verdrahtet werden
- Die **Adolf Thies GmbH & Co KG** garantiert die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes / Produkts, wenn keine Veränderungen an Mechanik, Elektronik und Software vorgenommen werden und die nachfolgenden Punkte eingehalten werden.
- Alle Hinweise, Warnungen und Bedienungsanordnungen, die in der vorliegenden Bedienungsanleitung angeführt sind, müssen beachtet und eingehalten werden, da dies für einen störungsfreien Betrieb und sicheren Zustand des Messsystems / Gerät / Produkt unerlässlich ist.
- Das Gerät / Produkt ist nur für einen ganz bestimmten, in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anwendungsbereich vorgesehen.
- Das Gerät / Produkt darf nur mit dem von der **Adolf Thies GmbH & Co KG** gelieferten und/oder empfohlenen Zubehör und Verbrauchsmaterial betrieben werden.
- Empfehlung: Da jedes Messsystem / Gerät / Produkt unter bestimmten Voraussetzungen in seltenen Fällen auch fehlerhafte Messwerte ausgeben kann, sollten bei **sicherheitsrelevanten Anwendungen** redundante Systeme mit Plausibilitäts-Prüfungen verwendet werden.

Umwelt

- Die Adolf Thies GmbH & Co KG fühlt sich als langjähriger Hersteller von Sensoren den Zielen des Umweltschutzes verpflichtet und wird daher alle gelieferten Produkte, die unter das Gesetz „ElektroG“ fallen, zurücknehmen und einer umweltgerechten Entsorgung und Wiederverwertung zuführen. Wir bieten unseren Kunden an, alle betroffenen Thies Produkte kostenlos zurückzunehmen, die frei Haus an Thies geschickt werden.
- Bewahren Sie die Verpackung für die Lagerung oder für den Transport der Produkte auf. Sollte die Verpackung jedoch nicht mehr benötigt werden führen Sie diese einer Wiederverwertung zu. Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.



Dokumentation

- © Copyright **Adolf Thies GmbH & Co KG**, Göttingen / Deutschland
- Diese Bedienungsanleitung wurde mit der nötigen Sorgfalt erarbeitet; die **Adolf Thies GmbH & Co KG** übernimmt keinerlei Haftung für verbleibende technische und drucktechnische Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.
- Es wird keinerlei Haftung übernommen für eventuelle Schäden, die sich durch die in diesem Dokument enthaltene Information ergeben.
- Inhaltliche Änderungen vorbehalten.
- Das Gerät / Produkt darf nur zusammen mit der/ dieser Bedienungsanleitung weitergegeben werden.

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbereich	5
1.1	Arbeitsweise	6
2	Messprinzip	7
2.1	Windgeschwindigkeit und Richtung	7
2.2	Akustische Virtuell Temperatur.....	8
3	Betriebsvorbereitung.....	11
3.1	Wahl des Aufstellortes	11
3.2	Gebrauchsrichtung des ULTRASONIC Anemometers	12
3.3	Mechanische Montage: US - Anemometer 4.3865.xx.xxx und 4.3866.xx.xxx .	12
3.4	Mechanische Montage: US- Anemometer 4.3867.xx.xxx	13
3.5	Elektrische Montage: US- Anemometer mit Stecker (4.3866... und 4.3867...).	13
3.5.1	Anschluss, Kabel, Kabelkonfektionierung und Montage der Kupplungsdose ..	14
3.5.2	Stecker Anschlussbelegung (Funktionsbeispiele)	15
3.6	Elektrische Montage für US - Anemometer mit Kabel (4.3865....)	16
3.6.1	Kabel Anschlussbelegung (Funktionsbeispiele)	16
4	Wartung	17
5	Kalibrierung	18
6	Garantie	18
7	Funktionsbeschreibung.....	18
7.1	Serielle Kommunikation	19
7.1.1	Duplex Modus.....	19
7.1.2	Antwortverzögerung.....	20
7.1.3	Allgemeiner Telegrammaufbau.....	21
7.1.4	Rückgabewerte vom ULTRASONIC	22
7.1.5	Zugriffsmodus.....	22
7.1.6	Baudrate	23
7.1.7	Geräte ID	24
7.1.8	Busbetrieb	25
7.2	Analoge und Digitale E/A.....	25
7.2.1	Analoge Eingänge	25
7.2.2	Analoge Ausgänge	27
7.2.3	Skalierung der analogen WG.....	27
7.2.4	Ausgabe der analogen WR.....	27
7.2.5	Ausgabe der analogen Virtuell Temperatur	28
7.3	Datenerfassung	28
7.3.1	Momentanwerte und Ausgabe der Rohmesswerte	29
7.3.2	Mittelung	29
7.3.3	Standardabweichung.....	30
7.3.4	Messung im Burst- Mode.....	30
7.3.5	Böenerfassung	34
7.4	Serielle Datenausgabe	35
7.4.1	Datenabfrage	35

7.4.2 Selbstständige Telegrammausgabe	36
7.4.3 Feste Telegrammformate	36
7.4.4 Bildung der Prüfsumme	37
7.4.5 Anwenderspezifisches Telegramm	37
7.4.6 Statusinformationen	45
7.5 Verhalten des Gerätes unter extremen Messwertaufnahme-Bedingungen	48
7.5.1 Eintreten des Fehlerfalls:	49
7.5.2 Verhalten der analogen Ausgänge	49
7.5.3 Verhalten der Telegrammausgabe	49
7.6 Heizungssteuerung	49
8 Kundenseitiges Konfigurieren des Ultrasonic- Anemometers	59
15 Weitere Informationen / Dokumente als Download	105
16 EC-Declaration of Conformity	106
17 UK-CA-Declaration of Conformity	107

Abbildung

Abbildung 1: Gebrauchsrichtung	12
Abbildung 2: Maßbild 4.3865... und 4.3866...	103
Abbildung 3: Maßbild 4.3867...	104

Tabelle

Tabelle 1: Einschränkungen in Voll- und Halb-Duplex-Betrieb	20
Tabelle 2: Rückgabewerte bei fehlerhafter Befehlsinterpretation	22
Tabelle 3: Zugriffsschlüssel für verschiedene Befehlsebenen	23
Tabelle 4: Konfiguration der Analogausgänge WG/RXD- u. WR/RXD+ mit Parameter AN u. SC	27
Tabelle 5: Liste der vordefinierten Datentelegramme	36
Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm	41
Tabelle 7: Einstellen der Mittelungszeiträume mit Parameter AV	70
Tabelle 8: Messgeräteadressen im Bayern Hessen Befehlsinterpreter	71
Tabelle 9: Liste der Baudrate mit Telegramm BR	72
Tabelle 10: Liste der Baudrate mit Telegramm BX	73
Tabelle 11: Tastverhältnis beim Einschalten der Heizung	81
Tabelle 12: Umrechnungsfaktoren zwischen verschiedenen Windgeschwindigkeiten	85
Tabelle 13: Konfiguration der Analogausgänge WG/RXD- u. WR/RXD+ mit Parameter AN u. SC	88

Lieferumfang

- 1 x Ultrasonic Anemometer 2D
- 1 x Kurz - Bedienungsanleitung (die gesamte Bedienungsanleitung steht als Download zur Verfügung)
- 1 x Beiblatt: Werkseinstellung
- 1 x Werkzeugegnis

Die Bedienungsanleitung liegt unter folgendem Link zum Download bereit:

https://www.thiesclima.com/db/dnl/4.386x.xx.xxx_US-Anemometer-1D_d.pdf

Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt alle Anwendungs- und Einstellungsmöglichkeiten des Gerätes. Die Auslieferungseinstellung des Ultrasonic Anemometer 1D erfolgt im Werk. Die Zuordnung zur Werkseinstellung ergibt sich aus der Bestell-Nr. und der dazu gehörigen „Werkseinstellung“.

Bestellnummer und Einstellung siehe Beiblatt „Werkseinstellung“

Der Anwender kann mit Hilfe dieser ausführlichen Bedienungsanleitung die Werkseinstellung über die serielle Schnittstelle des Ultrasonic Anemometer 1D auf seine Bedürfnisse anpassen.

1 Anwendungsbereich

Das **Ultrasonic Anemometer 1D** dient zur 1 – dimensionalen Erfassung der horizontalen Komponenten der **Windgeschwindigkeit** und der **Windrichtung** sowie der **Virtuell-Temperatur**.

Das Gerät ist besonders geeignet für den Einsatz in:

- Strömungsgerichteten Umgebungen, bei denen der Hauptwindvektor nur aus zwei entgegengesetzten Richtungen zu erwarten ist.
- Verkehrstechnik, Tunnelmesstechnik.
- Strömungen in Rohren.
- Indoor Strömungsmessung.

Über 25 verschiedene Messwerte sind verfügbar, unter anderen:

- Windgeschwindigkeit (Y– Strecke).
- Windrichtung (Ausgabe: 0°, 1° oder 181°).
- Akustische virtuelle Temperatur [°C].
- Standardabweichung der vektoriellen Windgeschwindigkeit (Y – Strecke).
- Standardabweichung der akustischen virtuellen Temperatur.
- Windgeschwindigkeit der Böe.
- Windrichtung der Böe.
- Messungen im Burst- Mode mit Trigger über Stecker-Pin und Aufzeichnung eines analogen Eingangswertes.
- Weitere Messwerte siehe Kapitel 7.4.5.5 (Verfügbare Messwerte und Datenformate).

Aufgrund des Messprinzips eignet sich das Gerät hervorragend zur trägheitslosen Böen- und Spitzenwertmessung.

Die erreichte Genauigkeit bei der Messung der Lufttemperatur (Virtuell-Temperatur) übertrifft nach Korrektur des Feuchteinflusses bei bestimmten Wettersituationen die der klassischen Verfahren, bei denen Temperaturmessfühler in einem Wetter- und Strahlungsschutz verwendet werden.

Die Messwerte können digital und / oder analog ausgegeben werden.

Digital- Ausgabe: Zur seriellen Kommunikation steht eine RS485/422 zur Verfügung. Sie kann im Voll- bzw. Halbmodus betrieben werden. Für die Ausgabe von Messwerten stehen einige vordefinierte Telegramme oder ein benutzerdefiniertes Telegramm zur Verfügung (z.B. WG, WR, akustische virtuelle Temperatur, Standardabweichung, Statusinformation, NMEA usw.).

Analoge Ausgänge: Windgeschwindigkeit und Richtung, sowie die akustische virtuelle Temperatur werden wahlweise als Strom- oder Spannungssignal ausgegeben. Individuelle Messbereichs-skalierungen der Analogausgänge für WG u. WR sind einstellbar.

Die analogen Ausgänge können alternativ und individuell als analoge Spannungseingänge (maximal 3) geschaltet werden. Die Ausgabe dieser Messwerte erfolgt über die serielle Schnittstelle im Rahmen eines benutzerdefinierten Telegramms.

Die serielle und analoge Ausgabe der Daten kann wahlweise als Momentanwert oder als gleitender Mittelwert erfolgen.

Die Sensorarme werden im Bedarfsfall bei kritischen Umgebungstemperaturen automatisch beheizt. Somit wird die Funktion auch bei Schneefall und Eisregen sichergestellt, sowie die Möglichkeit einer Funktions-Störung durch Vereisung minimiert.

1.1 Arbeitsweise

Das **Ultrasonic Anemometer 1D** besteht aus 2 Ultraschall-Wandlern, die sich im Abstand von 200 mm gegenüberstehen. Die Wandler fungieren sowohl als Schallsender als auch als Schallempfänger.

Über die Steuerungselektronik wird die Messrichtung angewählt. Mit dem Start einer Messung läuft eine Sequenz von 2 Einzelmessungen in beide Richtungen der Messstrecke mit maximal möglicher Geschwindigkeit ab.

Aus den beiden Einzelmessungen werden die Mittelwerte gebildet und zur weiteren Berechnung verwendet.

Die benötigte Zeit für eine Messsequenz liegt bei der maximalen Messgeschwindigkeit bei ca. 2,5msec bei +20°C.

2 Messprinzip

2.1 Windgeschwindigkeit und Richtung

Der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls in ruhender Luft überlagert sich die Geschwindigkeitskomponente einer Luftbewegung in Windrichtung.


Eine Windgeschwindigkeitskomponente in Ausbreitungsrichtung des Schalls unterstützt dessen Ausbreitungsgeschwindigkeit, führt also zu einer Erhöhung derselben, eine Windgeschwindigkeitskomponente entgegen der Ausbreitungsrichtung führt dagegen zu einer Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit.

Die aus der Überlagerung resultierende Ausbreitungsgeschwindigkeit führt zu unterschiedlichen Laufzeiten des Schalls bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten und Richtungen über eine feststehende Messstrecke.

Da die Schallgeschwindigkeit stark von der Temperatur der Luft abhängig ist, wird die Laufzeit des Schalls in **beide** Richtungen gemessen. Dadurch kann der Einfluss der Temperatur auf das Messergebnis ausgeschaltet werden.

Bei der Verwendung einer Messstrecke erhält man als Winkelinformation die Richtung 0° bzw. 180° , die intern in 1° und 181 umgesetzt und ausgegeben werden. Die Ausgabe 0° ist für Windstille vorbehalten.

Beim ULTRASONIC 1D wird vom Windgeschwindigkeitsvektor nur die Y-Komponente ausgewertet! Die X-Komponente der Windgeschwindigkeit wird nicht erfasst.

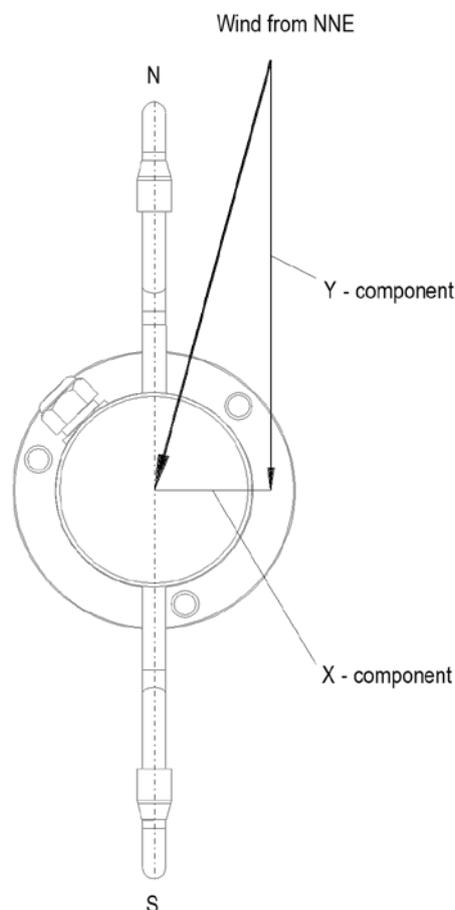

2.2 Akustische Virtuell Temperatur

Der thermodynamische Zusammenhang zwischen der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls und der absoluten Lufttemperatur ist über eine Wurzelfunktion definiert. Die Schallgeschwindigkeit ist außerdem annähernd unabhängig vom Luftdruck und nur geringfügig abhängig von der absoluten Luftfeuchte.

Dieser physikalische Zusammenhang zwischen Schallgeschwindigkeit und Temperatur kann ideal für eine Temperaturmessung der Luft genutzt werden, solange deren chemische Zusammensetzung bekannt und konstant ist.

Die Anteile der Gase in unserer Atmosphäre sind konstant und ändern sich mit Ausnahme des Wasserdampfgehaltes selbst über längere Zeiträume höchstens im Bereich von einigen 100ppm (CO₂).

Die Bestimmung der Gastemperatur über seine Schallgeschwindigkeit erfolgt direkt aus der Messung dessen physikalischer Eigenschaften ohne den Umweg der sonst notwendigen thermischen Kopplung des Gases zu einem Temperatursensor.

Die Vorteile dieser Messmethode bestehen zum einen in ihrer trägheitsfreien Reaktion auf die aktuelle Gastemperatur, zum anderen in der Vermeidung von Messfehlern wie sie z.B. durch Aufheizung eines Festkörper - Temperatursensors durch Strahlung oder Abkühlung durch Verdunstung von Wasser auf dem Sensor bekannt sind.

Viele Vergleichstests zwischen verschiedenen Wetter- und Strahlungsschutzgehäusen zeigen den indirekten Einfluss der vorgenannten Messfehlerquellen auf den Temperatursensor. [1]

Auf Standorten mit hoher Vereisungswahrscheinlichkeit werden ULTRASONIC- Anemometer bereits auch als akustische Thermometer eingesetzt, da klassische Temperatursensoren in Wetter- und Strahlungsschutzgehäusen nach Vereisung nicht mehr belüftet werden und aufgrund der verschlechterten thermischen Kopplung zur Außenwelt nur stark zeitverzögert reagieren, oder des fehlenden Abflusses der eigenen Verlustleistung eine zu hohe Temperatur messen. [2]

Wegen der, wenn auch schwachen, Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Schalls von der Luftfeuchte, bezieht sich die „akustische virtuelle Temperatur“ auf trockene Luft ohne jeglichen Anteil von Wasserdampf.

Die Abweichung der gemessenen „akustischen Temperatur“ zur realen Lufttemperatur ist linear vom absoluten Feuchtegehalt der Luft abhängig.

Der Anteil des Wasserdampfes in der Luft führt anteilmäßig zu einer Erhöhung der Schallgeschwindigkeit, da H₂O Moleküle etwa nur die Hälfte der Masse der restlichen Luftmoleküle (O₂ und N₂) besitzen.

Die Erhöhung der Schallgeschwindigkeit wächst jedoch nur unterproportional mit dem Mol-Massenanteil von Wasserdampf in der Luft.

Der Grund liegt in der kleineren mittleren translatorischen Geschwindigkeit der Wasserdampfmoleküle im Vergleich zu den restlichen Luftmolekülen. Bei den komplexeren H₂O Molekülen sind mehr Bewegungs-Freiheitsgrade möglich als bei dem einfachen aufgebauten O₂ und N₂ Molekülen, so dass der Gesamtenergieinhalt (Temperatur) sich auf die möglichen Translations- und Rotationsfreiheitsgrade als kinetische Energie aufteilt.

O₂ und N₂ Moleküle besitzen 3 Translations- und 2 Rotationsfreiheitsgrade, H₂O Moleküle 3 Translations- und 3 Rotationsfreiheitsgrade.

Die Gesamtanzahl der Freiheitsgrade bestimmt den Adiabatenexponent γ des jeweiligen Gases nachfolgendem Zusammenhang:

$$\gamma = 1 + \frac{2}{n}$$

Die gemessenen Adiabatenexponenten von trockener Luft γ_d und Wasserdampf γ_v betragen:

$$\gamma_d = 1,399463 \text{ und } \gamma_v = 1,331$$

Die Abhängigkeit der akustischen virtuellen Temperatur T_v vom Wasserdampfgehalt der Luft kann über folgende Beziehung berechnet werden:

$$T_v = T_t \cdot \left[1 + \left[\frac{\gamma_v}{\gamma_d} - \frac{M_v}{M_d} \right] \cdot \frac{e}{p - \left[1 - \frac{M_v}{M_d} \right] \cdot e} \right] \quad [1]$$

wobei T_t die akustische virtuelle Temperatur trockener Luft ist und M_v die Molmasse von Wasserdampf, sowie M_d die Molmasse von trockener Luft beschreibt.

Die Quotienten $\frac{M_v}{M_d}$ mit dem Wert 0,621978 und $\frac{\gamma_v}{\gamma_d}$ mit dem Wert 0,95108 können als feste [3] Konstanten in die Gleichung aufgenommen werden.

Der Quotient $\frac{e}{p}$ beschreibt den Wasserdampfdruck dividiert durch den Luftdruck, korrigiert um den Einfluss des Wasserdampfdruckes auf den Luftdruck.

Der Dampfdruck e kann gemäß der Beziehung $e = \frac{RH}{100} \cdot e_s$ berechnet werden, wobei RH für die relative Feuchte und e_s für den Sättigungsdampfdruck steht.

Der Sättigungsdampfdruck ist eine Funktion der Temperatur und kann gemäß der Magnus-Formel mit Koeffizienten nach Sonntag

$$e_s(T) = 6,112 \text{ hPa} \cdot e^{\frac{17,62 \cdot T}{243,12 \text{ K} + T}} \quad [4]$$

bei der interessierenden Temperatur errechnet werden, wobei T in °C angegeben werden muss.

Zur Berechnung der bei feuchter Luft gemessenen akustischen virtuellen Temperatur ergibt sich der folgende vereinfachte Ausdruck mit T als Temperatur in Kelvin:

$$T_v = T_t \cdot \left[1 + 0,329102 \cdot \frac{e}{p - [0,378022] \cdot e} \right]$$

Der Korrektoreinfluss des Wasserdampfdrucks auf den Luftdruck ist relativ gering und beträgt z.B. bei +40°C und 100% relativer Feuchte ca. 2,8%.

Die zu erwartenden Wasserdampfdrücke in der Natur liegen deutlich darunter, der Fehler bei Vereinfachung des Formalismus ist somit fast vernachlässigbar.

Vereinfachte Formel:

$$T_v = T_t \cdot \left[1 + 0,329 \cdot \frac{e}{p} \right]$$

Ein Beispiel:

Bei einer Lufttemperatur von +20°C, einer relativen Feuchte von 100% und einem Luftdruck von 1000hPa wird eine akustische virtuelle Temperatur von 22,25°C aus der Schallgeschwindigkeit berechnet.

Die akustische virtuelle Temperatur liegt also um 2,25°C über der tatsächlichen Lufttemperatur und kann über die obige Gleichung bei Kenntnis des Feuchtegehaltes der Luft z.B. der relativen Feuchte und des Luftdruckes entsprechend korrigiert werden.

Kalibrierte Messungen im Klimaschrank bei unterschiedlichen Temperaturen als Parameter und relativen Feuchten zwischen 10% und 90% haben ergeben, dass der Faktor in obiger Gleichung eher bei 0,30 liegen muss.

$$T_v = T_t \cdot \left[1 + 0,30 \cdot \frac{e}{p} \right]$$

Bei Bedarf können zur Steigerung der Genauigkeit der berechneten tatsächlichen Lufttemperatur ein oder mehrere Iterationsschritte zur Bestimmung des genauen Sättigungsdampfdrucks bei Verwendung der gemessenen relativen Feuchte und der gemessenen akustischen Temperatur als korrigierende Größen vorgenommen werden, da zur Berechnung des Sättigungsdampfdrucks die tatsächliche Lufttemperatur (korrigierte akustische Virtuell-Temperatur) benötigt wird.

Referenzen:

- [1] Dr. Lanzinger, Eckhard (Deutscher Wetterdienst), Langmack, Hans (Universität Hamburg): Measuring air temperature by using an ultrasonic anemometer.
- [2] Musa, Mark (Meteo Swiss), Tammelin, Bengt (Finnish Meteorological Institute) et al.: Measurement of temperature with wind sensors during severe winter conditions.
- [3] Aspirations-Psychrometer-Tafeln, Deutscher Wetterdienst, 7. Auflage.
- [4] Koeffizienten der Magnus-Formel nach Prof. Dr. Sonntag.

3 Betriebsvorbereitung

Achtung:

Die Gebrauchslage des Anemometers 4.3865..4.3866..: Beliebig. Die Gebrauchslage des Anemometers 4.3867..: Stehend

Das Anemometer ist im Winkel von 10° zur Hauptwindrichtung zu montieren.

Bei Montage, Demontage, Transport oder Wartung des Anemometers ist sicherzustellen, dass in Schaft u. Stecker bzw. Kabelverschraubung des Anemometers kein Wasser eindringt.

Bei Verwendung eines Blitzschutzstabes ist darauf zu achten, dass dieser immer unter 90° zur Messstrecke montiert ist. Anderenfalls kann es zu Messwertabweichungen kommen.

3.1 Wahl des Aufstellortes

Wie vorstehend bereits beschrieben, sendet das ULTRASONIC - Anemometer Schallpakete aus, die für die Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit benötigt werden. Treffen diese **Schallpakete** auf gut schall-reflektierende Flächen, werden sie als **Echo** zurückgeworfen und können unter ungünstigen Bedingungen zu **Fehlmessungen** führen.

Es ist daher ratsam, das US - Anemometer in einem **Mindestabstand von 1 Meter zu Gegenständen in der Messebene** aufzustellen.

Das ULTRASONIC - Anemometer weist eine elektromagnetische Verträglichkeit auf, die weit über den geforderten Normgrenzwerten liegt.

Elektromagnetische Felder mit 20V/m (Leistungsgrenze des Prüfsenders) im gesamten, von der Norm geforderten Frequenzbereich konnten keine Beeinflussung der Messwertaufnahme des Gerätes bewirken.

Bei einer geplanten Aufstellung des Gerätes an Sendemasten oder anderen Quellen starker elektromagnetischer Strahlung, welche Feldstärken weit oberhalb der Norm-Grenzwerte am Aufstellort erzeugen, sollte Rücksprache mit dem Hersteller gehalten werden.

3.2 Gebrauchsrichtung des ULTRASONIC Anemometers

Die Gebrauchsrichtung des Gerätes ist die Längsrichtung zur Strömungsgerichteten Umgebung (Tunnel, Röhre, Kanal usw.). Zur Messung müssen die Sensorarme des ULTRASONIC

mit $+10^\circ$ oder -10° zur Längsrichtung der Hauptströmung weisen, siehe Abbildung 1.

- Der rote markierte Sensorarm ist der Strömungsrichtung „ 1° “ zugeordnet.
- Der nicht markierte Sensorarm ist der Strömungsrichtung „ 181° “ zugeordnet.

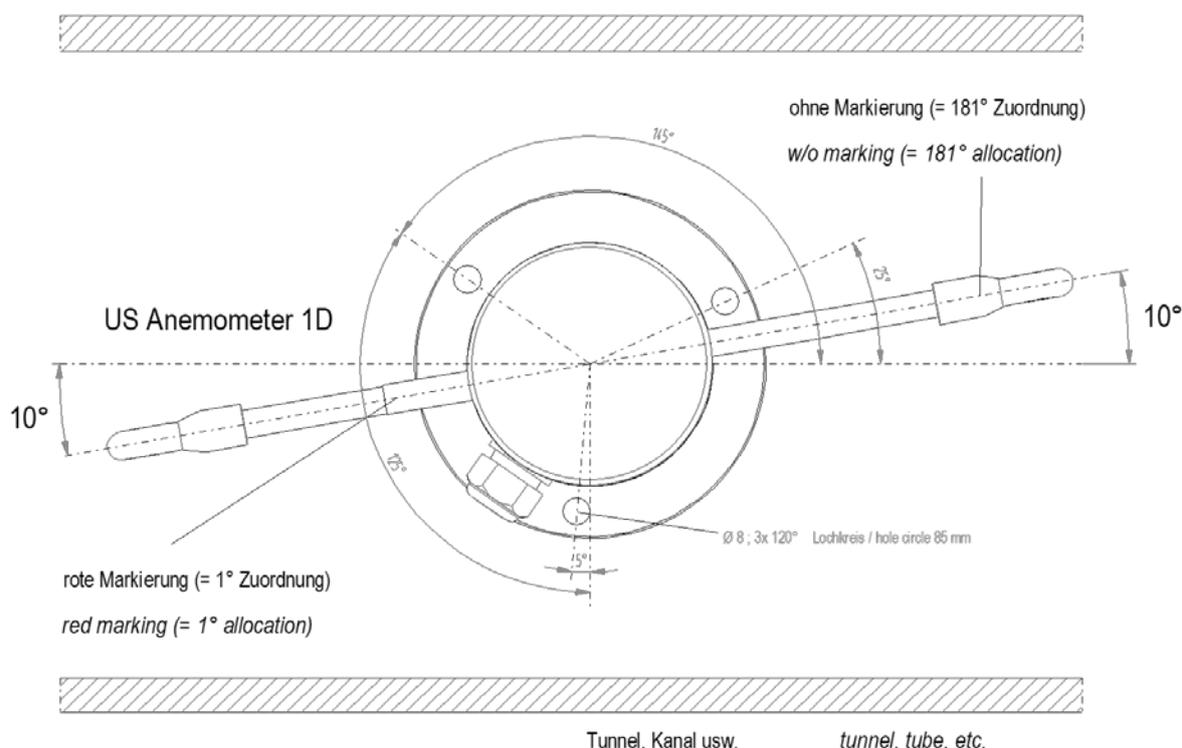


Abbildung 1: Gebrauchsrichtung

3.3 Mechanische Montage: US - Anemometer 4.3865.xx.xxx und 4.3866.xx.xxx

Die bestimmungsmäßige Montage erfolgt durch einen Flansch des Anemometers. Die Bohrmaße sind dem Maßbild (Kapitel 13) zu entnehmen.

- Gebrauchslage: Stehend oder hängend.

Zur Messung müssen die beiden Sensorarme in Längsrichtung zur Hauptwindrichtung (Tunnelrichtung) zeigen, siehe Kapitel 3.2. Gebrauchsrichtung.

3.4 Mechanische Montage: US- Anemometer 4.3867.xx.xxx

Die bestimmungsgemäße Montage des ULTRASONIC - Anemometers erfolgt auf einen Rohrstützen von R1½" (Ø 48,3mm) und \geq 50mm Länge. Der Innendurchmesser des Rohrstützens muss \geq 40mm betragen, da das ULTRASONIC - Anemometer von unten elektrisch angeschlossen wird. Siehe auch Maßbild Kapitel 13.

- Gebrauchslage: Stehend (Sensorarme: Oben).

Nach elektrischen Anschluss (siehe Kapitel 3.5) wird das ULTRASONIC - Anemometer auf den Rohr-, bzw. Maststützen gesetzt. Danach erfolgt die mechanische Ausrichtung des Gerätes, hierzu siehe Kapitel 3.2 Gebrauchsrichtung.

Mit den vier Innensechskantschrauben (M8X12 NIRO V4A DIN 916) am Schaft muss das Gerät sicher befestigt werden.

- Die Schrauben haben lt. Hersteller ein max. Anzieh-Drehmoment von 10Nm. Beachten Sie beim Verschrauben, dass sich das Material des bauseitigen Rohrstützens / Mast etc. nicht verformt.

Geeignetes Werkzeug:

- Innensechskantschlüssel Gr. 4 oder
- Drehmomentschlüssel mit entsprechender Adaptierung.

3.5 Elektrische Montage: US- Anemometer mit Stecker (4.3866... und 4.3867...)

Das ULTRASONIC - Anemometer ist mit einem Stecker für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Eine Kupplungsdose (Gegenstück) gehört zum Lieferumfang. Diese befindet sich im unteren Teil der Transportverpackung. Zum Lieferumfang der Kupplungsdose gehört eine Montagehilfe aus Kunststoff mit der der Buchseneinsatz beim Verschrauben mit der Kupplungshülse festgehalten werden kann.

- Bei Ausführung 4.3866.xx.xxx ist der Stecker seitlich am Gehäuse befestigt (siehe Maßbild, Kapitel 13).
- Bei Ausführung 4.3867.xx.xxx ist befindet sich der Stecker im Anemometerfuß (siehe Maßbild Kapitel 13).

3.5.1 Anschluss, Kabel, Kabelkonfektionierung und Montage der Kupplungsdose

Anschluss:

Die Anschlussbelegung ist dem Beiblatt „Werkseinstellung“ zu entnehmen.

(Beispiele siehe Kapitel 3.5.2)

Kabel:




Das anzuschließende Kabel selbst muss folgende Eigenschaften aufweisen:

8 Adern; 0,5 bis 0,75mm² Aderquerschnitt für die Versorgung; min. 0,14mm² Aderquerschnitt für die Datenkommunikation; 7- 8mm Kabeldurchmesser, UV- Beständigkeit, Gesamt-Schirmung.

Hinweis :

Für das ULTRASONIC - Anemometer kann optional ein fertig konfektioniertes Anschlusskabel mitgeliefert werden (siehe Zubehör).


Kabelkonfektionierung und Montage der Kupplungsdose:

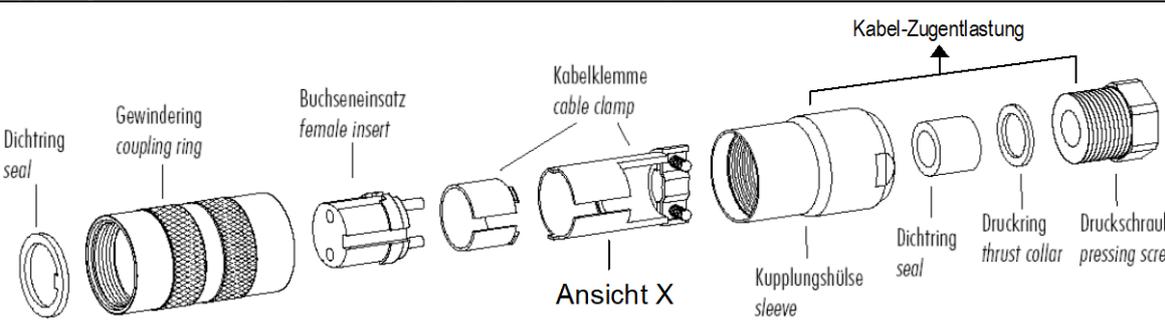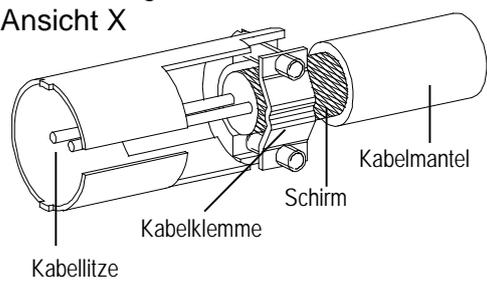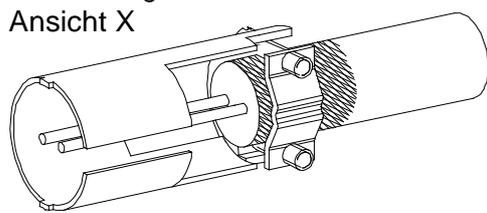
Kupplungsdose 211173 (oder 507550) (Binder, Serie 423), EMV mit Kabelklemme	
	
<ol style="list-style-type: none"> Teile nach obiger Darstellung auf Kabel auffädeln. Kabelmantel 20mm abisolieren, Freiliegenden Schirm 15mm kürzen, Kabellitzen 5mm abisolieren. <p>zu <i>Kabelmontage 1</i> Schrumpfschlauch oder Isolierband zwischen Litzen und Schirm bringen.</p> <p>zu <i>Kabelmontage 2</i> wenn es der Kabeldurchmesser erlaubt, Schirm nach hinten auf Kabelmantel legen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kabel-Litzen an Buchseneinsatz anlöten, Schirm in Kabelklemme positionieren. Kabelklemme anschrauben. Übrige Teile gemäß oberer Darstellung montieren. Kabel- Zugentlastung mit Schraubenschlüssel (SW16 und 17) fest anziehen. 	<p><i>Kabelmontage 1</i> Ansicht X</p>  <p><i>Kabelmontage 2</i> Ansicht X</p> 


3.5.2 Stecker Anschlussbelegung (Funktionsbeispiele)

Anmerkung:

- Die genaue Funktionszuordnung ist dem Beiblatt „Werkseinstellung“ zu entnehmen.
- Die Pins 1 bis 6 (einschließlich) sind galvanisch von der Versorgungsspannung und vom Gehäuse getrennt.

• Serielle Schnittstelle, Vollduplex			Sicht auf Lötanschluss der Kupplungsdose
Pin	Belegung	Funktion	
1	RXD-	serielle Schnittstelle	
2	TXD-	serielle Schnittstelle	
3	ADIO	Funktion nicht voreingestellt	
4	RXD+	serielle Schnittstelle	
5	TXD+	serielle Schnittstelle	
6	AGND	Analog-Masse	
7	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
8	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
⏏	Schirm		

• Serielle Schnittstelle, Halbduplex und analoge Ausgänge			Sicht auf Lötanschluss der Kupplungsdose
Pin	Belegung	Funktion	
1	WG	Analogausgang Windgeschwindigkeit	
2	TXD- / RXD-	serielle Schnittstelle	
3	ADIO	Funktion nicht voreingestellt	
4	WR	Analogausgang Windrichtung	
5	TXD+ / RXD+	serielle Schnittstelle	
6	AGND	Analog-Masse	
7	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
8	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
⏏	Schirm		

• Serielle Schnittstelle, Halbduplex und analoge Eingänge			Sicht auf Lötanschluss der Kupplungsdose
Pin	Belegung	Funktion	
1	0-10,0V	Analogeingang	
2	TXD- / RXD-	serielle Schnittstelle	
3	0-10,0V	Analogeingang	
4	0-10,0V	Analogeingang	
5	TXD+ / RXD+	serielle Schnittstelle	
6	AGND	Analog-Masse	
7	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
8	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher	
⏏	Schirm		

3.6 Elektrische Montage für US - Anemometer mit Kabel (4.3865....)

Das ULTRASONIC- Anemometer ist über eine Kabelverschraubung mit einem fest angeschlossenen Kabel ausgestattet. Das Kabelende ist offen. Die Pinnummern der Ader-Enden sind mittels Kabel-Kennzeichnungsringen gekennzeichnet.

3.6.1 Kabel Anschlussbelegung (Funktionsbeispiele)

Anmerkung:

- Die genaue Funktionszuordnung ist dem Beiblatt „Werkseinstellung“ zu entnehmen.
- Die Pins 1 bis 6 (einschließlich) sind galvanisch von der Versorgungsspannung und vom Gehäuse getrennt.

• Serielle Schnittstelle, Vollduplex			
Ader	Farbcode	Belegung	Funktion
1	weiß	RXD-	serielle Schnittstelle
2	grün	TXD-	serielle Schnittstelle
3	Schwarz 1	ADIO	Funktion nicht voreingestellt
4	braun	RXD+	serielle Schnittstelle
5	gelb	TXD+	serielle Schnittstelle
6	Schwarz 2	AGND	Analog-Masse
7	schwarz 3	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
8	Schwarz 4	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
⏏	grün / gelb	Schirm	

• Serielle Schnittstelle, Halbduplex und analoge Ausgänge			
Ader	Farbcode	Belegung	Funktion
1	weiß	WG	Analogausgang Windgeschwindigkeit
2	grün	TXD- / RXD-	serielle Schnittstelle
3	Schwarz 1	ADIO	Funktion nicht voreingestellt
4	braun	WR	Analogausgang Windrichtung
5	gelb	TXD+ / RXD+	serielle Schnittstelle
6	Schwarz 2	AGND	Analog-Masse
7	schwarz 3	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
8	Schwarz 4	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
⏏	grün / gelb	Schirm	

• Serielle Schnittstelle, Halbduplex und analoge Eingänge			
Ader	Farbcode	Belegung	Funktion
1	weiß	0-10,0V	Analogeingang
2	grün	TXD- / RXD-	serielle Schnittstelle
3	Schwarz 1	0-10,0V	Analogeingang
4	braun	0-10,0V	Analogeingang
5	gelb	TXD+ / RXD+	serielle Schnittstelle
6	Schwarz 2	AGND	Analog-Masse
7	schwarz 3	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
8	Schwarz 4	AC/DC	Versorgung, verpolungssicher
	grün / gelb	Schirm	

4 Wartung

Da das Gerät ohne bewegliche Teile, d.h. verschleißfrei arbeitet, sind nur minimale Servicearbeiten erforderlich. Die Sensorflächen sind gelegentlich von Rückständen zu befreien. Die Reinigung kann mit nicht-aggressiven Reinigungsmitteln in Wasser und einem weichen Tuch bei routinemäßigen Überprüfungen, soweit notwendig, durchgeführt werden.

Achtung:

Bei Lagerung, Montage, Demontage, Transport oder Wartung des Anemometers ist sicherzustellen, dass in den Schaft u. Stecker bzw. die Kabelverschraubung des Anemometers kein Wasser eindringt.

Info:

Wir empfehlen die Gewinde der Stecker regelmäßig mit einem geeigneten Korrosionsschutzmittel gegen Korrosion zu schützen.

5 Kalibrierung

Das ULTRASONIC - Anemometer enthält keine einstellbaren Bauelemente wie elektrische oder mechanische Trimmelemente. Alle verwendeten Bauelemente und Materialien verhalten sich zeitlich invariant. Eine regelmäßige Kalibrierung aufgrund von Alterung entfällt somit. Lediglich eine mechanische Deformation der Wandlerarme und die damit verbundenen Messstreckenlängenänderungen führen zu Messwertfehlern.

Die Messstreckenlänge ist auf 200mm kalibriert. Weicht die ausgegebene Virtuelltemperatur mehr als 6 Kelvin von der tatsächlichen Außentemperatur ab, kann von einer mechanischen Deformation ausgegangen werden. Im Falle einer Veränderung der Messstrecken des Anemometers, sollte mit dem Hersteller Rücksprache über eine Neu-Kalibrierung gehalten werden.

Wichtig:

Eine mechanische Deformation der Messarme kann zu Messwertfehlern führen. Eine neue Kalibration ist erforderlich

6 Garantie

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Fremdeinwirkung, z.B. durch Blitzeinschlag, entstehen fallen nicht unter die Garantiebestimmung. Wird das Gerät ohne Zustimmung des Herstellers geöffnet, erlischt der Garantieanspruch.

Wichtig:

Der Rücktransport des ULTRASONIC- Anemometers muss in der Originalverpackung erfolgen, da andernfalls der Garantieanspruch bei mechanischer Beschädigung, z.B. durch Deformation der Messarme, erlischt.

7 Funktionsbeschreibung

Im Folgenden werden die Gerätefunktionen des ULTRASONIC beschrieben. Aufgrund der begrenzten Anzahl Adern im Kabel schließen einigen Funktionen den gleichzeitigen Betrieb mit anderen Funktionen aus. Diese Abhängigkeiten sind jeweils beschrieben.

Auch ergeben sich Einschränkungen bei der Funktionsdefinition des Anschlusskabels. Der Grund liegt in der Doppelbelegung bestimmter Pins.

7.1 Serielle Kommunikation

Zur seriellen Kommunikation stellt das ULTRASONIC eine RS485 / RS422 Schnittstelle zur Verfügung. Sie kann wahlweise im Voll- bzw. Halbduplex Modus und bei unterschiedlichen Baudraten betrieben werden.

Die Kommunikation mit dem ULTRASONIC kann z.B. mit Hilfe eines Standard-Terminal-Programms erfolgen. Bei einem auf Windows basierendem Betriebssystem gehört Hyper-Terminal zum Lieferumfang.

Es muss bei Bedarf nachinstalliert werden.

Da der Hersteller in der Regel keine Kenntnis über einen möglichen Einsatz des ULTRASONIC in einem Busverband hat, enthält das Gerät einen softwareseitig zuschaltbaren Wellenabschluss-widerstand für den Halb-Duplex-Betrieb. Siehe Befehl: BT (Busterminierung).

Beim Starten des ULTRASONIC werden die Kommunikationsparameter der seriellen Schnittstelle ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt bei 9600,8N1. Es werden die Baudrate, der Duplex-Modus und die ID ausgegeben:

Beispiel:
THIES ULTRASONIC
!00BR00005
!00DM00001

Das ULTRASONIC startet mit ID 00, mit einer Baudrate von 9600,8N1 und im Voll-Duplex-Modus.

7.1.1 Duplex Modus

Der Duplex Modus entscheidet über die Art der physikalischen Verbindung der seriellen Schnittstelle. Im Voll-Duplex-Modus werden jeweils Sende und Empfangssignale über getrennte Leitungspaare übertragen. Es ist somit ein zeitgleiches Senden und Empfangen möglich.

Im Halb-Duplex-Betrieb findet die Übertragung der Sende- bzw. Empfangssignale über das gleiche Leitungspaar im Zeitmultiplex (nacheinander) statt, siehe **Befehl DM**.

Für einen Busbetrieb im Halb-Duplex-Modus (RS485) in dem das ULTRASONIC in der Regel als „Slave“ betrieben wird, ist es notwendig, dass der Line-transmitter in den Sendepausen in den „High Impedanzen State“ geschaltet wird um die Antworten der anderen Busteilnehmer nicht zu unterdrücken.

Bei Punkt zu Punkt Verbindungen im Voll-Duplex-Modus (RS422) kann es je nach Störverhältnissen auf den Kommunikationsleitungen wichtig sein, den Line-transmitter in den Sendepausen eingeschaltet zu lassen, so dass ein maximaler Differenzsignalpegel zu einem maximalen Signal-Störabstand führt.

Über den **Befehl DM** (Duplex-Mode) kann der Halb-Duplex-Modus angewählt werden. In dieser Einstellung wird der Line-transmitter grundsätzlich immer nur beim Senden eingeschaltet.

Für den Voll-Duplex-Betrieb gibt es 2 Modi, einen für Busbetrieb (RS 485), bei dem der Line-transmitter wie im Halb-Duplex-Modus gesteuert wird und einen weiteren (RS 422), bei dem der Line-transmitter auch im Empfangsfall eingeschaltet bleibt. Siehe **Befehl DM**.

Für den ULTRASONIC ergeben sich je nach gewählter Übertragungsart Einschränkungen in der Parameterkombination bzw. Funktion der Anschlussklemmen. Bedingt durch die begrenzte Anzahl der Steckerverbinderkontakte sind Mehrfachbelegungen der Anschlüsse erforderlich.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionsmöglichkeiten bei den Modi Voll und Halb-Duplex-Betrieb:

Voll-Duplex-Betrieb	Halb-Duplex-Betrieb
Selbstständige Telegrammausgabe möglich (siehe Befehl TT)	Selbstständige Telegrammausgabe ab Softwareversion V3.10 möglich. Telegrammausgabe wird eine Minute nach Gerätestart bzw. nach Setzen des Kommandos aktiv.
Kein Busbetrieb möglich (DM=00002), Busbetrieb möglich (DM=00001)	Busbetrieb möglich (DM=00000).
Keine Ausgabe der Analogwerte an PIN RXD- und RXD+	Ausgabe der Analogwerte möglich.
Kein Einlesen der ID von externen PINs (siehe Befehl XI)	Einlesen der ID von externen PINs möglich (siehe Befehl XI).
Keine analogen Eingänge an PINs RXD- und RXD+ möglich. (siehe Befehl AA, Befehl AB)	Analoge Eingänge an PINs RXD- und RXD+ möglich (siehe Befehl AA, Befehl AB).
Heizungssteuerung über PIN ADIO möglich	Heizungssteuerung über PIN ADIO möglich.

Tabelle 1: Einschränkungen in Voll- und Halb-Duplex-Betrieb

7.1.2 Antwortverzögerung

Bei der seriellen Kommunikation ist zu berücksichtigen, dass das ULTRASONIC sehr schnell auf eingehende Telegramme reagiert. Die Antwortzeit des Gerätes liegt im unteren Millisekunden-bereich. Unter Umständen ist die Verzögerung zwischen Empfangs- und Sendesignal für manche Schnittstellenwandler zu kurz. Es ist möglich, dass ein Schnittstellenwandler in dieser Zeit noch nicht zwischen den Modi ‚Senden‘ und ‚Empfangen‘ umgeschaltet hat. Dieses kann zu unverständlichen Telegrammen führen.

Um diesen Effekt zu vermeiden, besitzt das ULTRASONIC den Parameter RD (Response Delay, Antwortverzögerung). Mit diesem Parameter wird bei Empfang die Antwort zusätzlich um den eingestellten Wert in Millisekunden verzögert. Der Parameter ist abhängig von der Artikelnummer der Geräte.

7.1.3 Allgemeiner Telegrammaufbau

Zur seriellen Kommunikation besitzt das ULTRASONIC ein festes Telegrammformat, das auch die Kommunikation im Busbetrieb zulässt. Es hat die Form:

NNBB<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

für eine Datenabfrage bzw.

NNBBPPPPP<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

für eine Parameteränderung.

Die einzelnen Buchstaben haben folgende Bedeutung:

NN: Zweistellig ID des ULTRASONIC. Sie kann im Bereich von 00 bis 99 eingestellt werden. In der Voreinstellung ist die ID ,00', siehe auch **Befehl ID** und **Befehl XI**.

BB: Zweistelliger Befehl. Eine komplette Auflistung befindet sich im Abschnitt Befehlsliste.

PPPPP: Soll ein neuer Parameter gesetzt werden, wird mit einem 5-stelligen Wert der Parameter geändert. Der Parameter ist immer rechtsbündig, muss also von links mit Nullen aufgefüllt werden.

Beispiel:

Es soll das Telegramm Nummer 4 abgefragt werden. Das entsprechende Kommando ist:

00TR00004<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Voraussetzung ist, dass die ULTRASONIC ID den Wert ,0' hat.

Beispiel:

Mit dem Kommando

00BR<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

wird der gewählte Datensatz für die Baudrate zurückgegeben.

!00BR00005

Anmerkung:

Der Empfangspuffer des ULTRASONIC kann durch das Senden von Carriage Return <CR> geleert werden. Hat das ULTRASONIC evtl. ungültige Zeichen im Empfangspuffer, kann durch Senden von Carriage Return dieser abgearbeitet werden. Es empfiehlt sich in diesem Fall zu Beginn eines Telegramms ein Carriage Return zu senden, z.B.:

<cr>00BR<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

7.1.4 Rückgabewerte vom ULTRASONIC

Nach der Eingabe eines gültigen Befehls, sendet das ULTRASONIC eine entsprechende Quittung z.B. die Übernahme des Parameters oder die Ausgabe eines Datentelegramms.

Bei einem Standardkommando beginnt die Antwort mit einem ‚!‘, gefolgt von der ID und dem Parameterwert.

Ist der eingegebene Befehl TR oder TT, sendet das ULTRASONIC als Antwort ein Datentelegramm.

Kann aus einem bestimmten Grund der Befehl nicht abgearbeitet werden, sendet das Gerät ein Telegramm mit dem Fehlercode ‚CE‘ (Command Error). Die Bedeutung der Werte für CE sind in **Tabelle 2: Rückgabewerte bei fehlerhafter Befehlsinterpretation**, zusammengefasst:

Ausgegebener Wert im CE - Telegramm	Bedeutung
8	Falscher Zugriffsmodus
16	Parameter nicht im gültigen Bereich
4 oder 32	Verletzung zu Parametern anderer Befehle

Tabelle 2: Rückgabewerte bei fehlerhafter Befehlsinterpretation

7.1.5 Zugriffsmodus

Zur Konfiguration besitzt das ULTRASONIC einen Satz von Befehlen, die das Verhalten zur Laufzeit bestimmen. Die Befehle sind in drei Ebenen unterteilt:

- Abfrage Modus
- Benutzermodus
- Konfigurationsmodus

Abfragemodus:

Zu diesem Modus gehören Befehle, die die Parameter des ULTRASONIC nicht beeinflussen. Hierzu gehört z.B. die Ausgabe des Systemstatus und die Abfrage des Datentelegramms mit TR.

Benutzermodus:

Zu diesem Modus gehören Befehle, die das Verhalten des ULTRASONIC beeinflussen. Die entsprechenden Parameter können durch den Anwender geändert werden. Mit diesen Befehlen wird das Systemverhalten des Gerätes angepasst. In diese Befehlsgruppe fallen z.B. Einstellungen zur Datenübertragung und Mittelung.

Konfigurationsmodus:

Zu diesem Modus gehören Befehle, die beim werksseitigen Geräteabgleich benötigt werden. Sie sind mit einer Kalibrierung gleichzusetzen. Diese Parameter dürfen nicht geändert werden.

Um bei der Parametrisierung des ULTRASONIC zwischen Befehlen der drei Gruppen zu unterscheiden, verfügt das Gerät über einen Zugriffsschlüssel KY. Durch Eingabe des Schlüssels werden die einzelnen Ebenen geöffnet.

Ein Zugriff auf die Befehle einer höheren Ebene schließt den Zugriff auf Befehle mit niedriger Ebene ein.

Zugriffsschlüssel	Antwort vom ULTRASONIC	Befehlsebene
00KY00000	WRITE PROTECTED !00KY00000	Abfragemodus (voreingestellt)
00KY00001	USER ACCESS !00KY00001	Benutzermodus
00KYxxxxx	CONFIG ACCESS !00KYxxxxx	Konfigurationsmodus Schlüssel muss beim Hersteller erfragt werden

Tabelle 3: Zugriffsschlüssel für verschiedene Befehlsebenen

Nach der Änderung des Zugriffsschlüssels sendet das ULTRASONIC eine Antwort, die sowohl den eingegebenen Parameter als auch den Zugriffsmodus enthält.

Nach einer Parameteränderung mit dem Schlüssel ‚00001‘ oder ‚xxxxx‘ muss das ULTRASONIC mit dem Befehl 00KY00000 wieder in die Ausgangsposition zurückgesetzt werden.

Bei Unterbrechung der Stromversorgung wird das Gerät automatisch in den Abfragemodus zurückgesetzt.

Beispiel:

00KY00001	
USER ACCESS	Antwort vom ULTRASONIC
!00KY00001	Antwort vom ULTRASONIC
00AV00005	Änderung des Mittelungszeitraums
00KY00000	
WRITE PROTECTED	Antwort vom ULTRASONIC
!00KY00000	Antwort vom ULTRASONIC

7.1.6 Baudrate

Mit der Baudrate wird die Übertragungsgeschwindigkeit über die RS485 eingestellt. Der Parameterbereich erstreckt sich von 1200 Baud bis 921,6 kBaud.

Um ein versehentliches Umprogrammieren der Baudrate über 115,2 kBaud zu vermeiden, sind die Baudraten oberhalb 115,2 kBaud mit dem Befehl BX zu erreichen.

Das Umprogrammieren der Baudrate mit dem Befehl BR wirkt sich sofort auf den ULTRASONIC aus. Nach dem Absenden eines Befehls, muss das benutzte Anwenderprogramm auf die entsprechende Baudrate gesetzt werden.

Beim Verwenden einer Baudrate im erweiterten Bereich (230400 Baud ... 921600 Baud) ist ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus eingebaut, der ein ungewolltes Einstellen der Baudrate verhindert. Bei Verwendung des Befehls BX schaltet das ULTRASONIC seine Baudrate sofort um, speichert diese Änderung aber nicht ab. Beim nächsten Neustart startet das ULTRASONIC mit der alten Baudrate.

Um die Änderungen zu speichern muss die Baudrate des PC auf die neue Geschwindigkeit gestellt werden, und der gleiche Befehl noch einmal zum ULTRASONIC gesendet werden. Nach dem Senden quittiert das ULTRASONIC den Befehl mit der Ausgabe ‚Baudrate saved‘.

Beispiel:

Die Baudrate soll auf 962100 Baud geändert werden:

Kommando:	Antwort ULTRASONIC	Kommentar
00KY00001	USER ACCESS	Zugriff erlauben
	!00KY00001	
00BX00103	For saving change baudrate and insert command again	
		Hier Baudrate vom PC auf 921600 ändern
00BX00103	Baudrate saved	
	!00BX00103	

7.1.7 Geräte ID

Die Geräte ID bestimmt die Adresse, auf die das ULTRASONIC bei der seriellen Kommunikation reagieren soll. Die Geräte ID liegt im Bereich von ,00' bis ,99'. Die voreingestellte ID ist ,00'. Jedes Telegramm vom ULTRASONIC beginnt mit der eingestellten ID. Dadurch ist unter bestimmten Voraussetzungen ein Busbetrieb möglich, siehe **Busbetrieb**.

Die Umprogrammierung der ID erfolgt mit dem Befehl ,ID'. Als Parameter wird die neue ID des ULTRASONIC festgelegt. Nach der Änderung reagiert das ULTRASONIC sofort auf die neue Adresse.

Beispiel:

00KY00001	
USER ACCESS	Antwort vom ULTRASONIC
!00KY00001	Antwort vom ULTRASONIC
00ID00004	Ändern der ID auf Adresse 4
!04ID00004	ULTRASONIC bestätigt neue ID
	Das ULTRASONIC reagiert jetzt, auch nach Neustarts, auf die neue ID ,04'
04AV	Abfrage der Mittelungsdauer mit neuer ID
!04AV00005	Rückgabe der Mittelungsdauer

Es ist weiterhin möglich, die ID beim Start über die externen PINs WG/RXD-, WR/RXD+ und ADIO festzulegen. Hierzu müssen die Parameter der Befehle AA, AB, AC und XI richtig gesetzt sein, siehe **Befehl AA**, **Befehl AB**, **Befehl AC**, **Befehl XI**.

7.1.8 Busbetrieb

Durch das Konzept der ID basierten Kommunikation ist ein Betrieb des ULTRASONICs im Busverband möglich. Die Voraussetzungen hierfür sind:

- Halbduplexbetrieb
- Unterschiedliche IDs der einzelnen Busteilnehmer
- Master-Slave Struktur, d.h. es existiert ein Gerät im Bus (Steuerung, PC...), der die Daten der einzelnen ULTRASONICs zyklisch abfragt und die ULTRASONICs evtl. parametrisiert.

Im Busbetrieb gibt es keine Einschränkung in der Parametrisierbarkeit und im Programmupload. Auch im Busbetrieb kann gezielt eine Station ein neues Programm erhalten. Bei einem Update muss für jeden ULTRASONIC das Programmupdate ausgeführt werden.

7.2 Analoge und Digitale E/A

Zusätzlich zur Ausgabe der Daten über die serielle RS485, verfügt das ULTRASONIC über die Möglichkeit, die Daten über ein analoges Interface auszugeben. Als Option können diese Ausgänge auch als analoge Eingänge geschaltet werden, die eine externe Spannung von 0...10,0V einlesen, digital konvertieren und über das anwenderspezifische Telegramm ausgeben.

Weiterhin verfügt das ULTRASONIC über die Leitung ADIO, die zusätzlich zum analogen Eingang auch digitale Ausgangsfunktionen enthält.

7.2.1 Analoge Eingänge

Die Pins WG/RXD-, WR/RXD+ und ADIO des Steckers können unter bestimmten Voraussetzungen als analoge Eingänge genutzt werden. WG/RXD- und WG/RXD+ sind nur dann als Eingänge verfügbar, wenn der Halbduplexmodus gewählt ist und die elektronischen Schalter über die Befehle AA, AB und AC dementsprechend gesetzt sind, siehe **Befehl AA**, **Befehl AB**, **Befehl AC**.

Die Funktion des Pins ADIO ist unabhängig vom Duplex-Modus und kann jederzeit als Analog- Eingang geschaltet werden.

Die eingelesenen Messwerte können mit dem anwenderspezifischen Telegramm ausgegeben werden, siehe **Anwenderspezifisches Telegramm**. Der Eingangsspannungsbereich beträgt 0...+10,0V, die Abtastrate lässt sich in weiten Bereichen über den Befehl AU (Analog Update rate) einstellen. Die minimale Wandlungszeit beträgt 2,5msec pro Kanal. Sind z.B. alle drei Kanäle als analoge Eingänge konfiguriert, beträgt die maximale Abtastfrequenz $1 / 7,5ms = ca. 133Hz$.

Der Parameter AU gibt das Abtastintervall in ms an. Die Zeitdauer einer Abtastung für alle gewählten Analogkanäle ist der Wert von AU multipliziert mit der Anzahl der Kanäle.

Zur Skalierung der Ausgabe der analogen Messwerte stehen die Parameter AY, AZ; BY, BZ; CY, CZ zur Verfügung. Mit diesen Parametern kann der Messbereich (0...+10,0 V) in eine lineare Ausgabe umgerechnet werden.

Die _Y-Parameter geben immer den Wert an, der 0V entspricht, die _Z-Parameter geben immer den Wert an, der 10,0V entspricht. Weil der Befehlsinterpreter des ULTRASONIC keine negativen Zahlen und kein Kommata unterstützt, müssen die Skalierungswerte vor der Eingabe umgerechnet werden.

Die Abkürzung **SKAW** steht für „skalierter Ausgabewert“. Damit ist der Wert gemeint, der nach der Umrechnung der Messgröße im Telegramm ausgegeben werden soll.

Der bei AY, AZ; BY, BZ; CY, CZ einzugebende Parameterwert wird wie folgt berechnet:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (\text{SKAW} * 10)$$

Beispiel:

An dem PIN ADIO soll ein Temperatursensor angeschlossen werden. Der Sensor hat folgende Kennwerte:

$$0,0 \text{ V} = -40^{\circ}\text{C}$$

$$+10,0 \text{ V} = 80^{\circ}\text{C}$$

Der Parameter CY definiert den Ausgabewert für den Messwert 0 V. Er berechnet sich wie folgt:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (-40 * 10) = 29600$$

Mit dem Befehl 00CY29600 wird damit der untere Ausgabewert definiert.

Der Parameter CZ beschreibt den Ausgabewert für den Messwert +10,0V. Der Ausgabewert für Messwert +10V soll +80°C betragen. Die Umrechnung lautet wie folgt:

$$\text{Kommandowert} = 30000 + (+80 * 10) = 30800$$

Mit dem Befehl 00CZ30800 wird damit der obere Ausgabewert definiert.

Zur Ausgabe der Datenwerte wird das benutzerdefinierte Telegramm verwendet.

Soll der Messwert des ADIO-PIN mit Vorzeichen, zwei Vorkomma und einem Nachkommazichen ausgegeben werden, so muss die Definition

00UT@21, 05, 1,1@

angefügt werden. Siehe hierzu auch **Anwenderspezifisches Telegramm**.

Für weitere Informationen siehe

Befehl AA, Befehl AB, Befehl AC, Befehl AY, Befehl AZ, Befehl BY, Befehl BZ, Befehl CY, Befehl CZ.

7.2.2 Analoge Ausgänge

Als weitere Möglichkeit bieten die Analogausgänge WG/RXD- und WR/RXD+ die Möglichkeit, die Windgeschwindigkeit und Windrichtung als analogen Wert sowohl als Spannung als auch als Stromwert auszugeben. Weiterhin ist wählbar, ob bei dem Strom bzw. Spannungsausgang ein konstanter Offset von 20% des Messbereichsendwertes beim Messwert 0 ausgegeben wird.

Es werden damit die Schnittstellen 4...20mA realisiert. Zu möglichen Kombinationen siehe Tabelle:

	Parameter SC=0	Parameter SC=1
Parameter AN=0	0..10V	2..10V
Parameter AN=1	0..20mA	4..20mA
Parameter AN=2	Keine Ausgabe	Keine Ausgabe

Parameter AA= 0; AB = 0

Tabelle 4: Konfiguration der Analogausgänge WG/RXD- u. WR/RXD+ mit Parameter AN u. SC

7.2.3 Skalierung der analogen WG

Bei der analogen Windgeschwindigkeit hat der Anwender die Möglichkeit mit dem Befehl AR die Geschwindigkeit für den Messbereichsendwert festzulegen. Im voreingestellten Wert ist die Skalierung 0...60m/s, siehe **Befehl AR**. Der Endwert der Skalierung wird in m/s festgelegt. Zum Beispiel skaliert der Befehl 00AR00030 den analogen Ausgangsbereich von 0...30m/s Windgeschwindigkeit. Bei einer Einstellung von 2...10V entspricht

WG = 0 m/s -> 2V und

WG = 30 m/s -> 10V

Siehe auch **Befehl AR**.

7.2.4 Ausgabe der analogen WR

Der gemessene Winkel des ULTRASONIC Anemometers beträgt 0° für Windstille, 1° für Wind aus Norden und 181° für Wind aus Süden.

Der Wert kann über die analoge Windrichtung ausgegeben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, eine Kombination von Windgeschwindigkeit und Windrichtung über den Ausgang auszugeben, siehe hierzu **Befehl AO**.

Durch die Einschränkung des messbaren Winkels kann der WR-Ausgang zur gleichzeitigen Ausgabe von WR und WG genutzt werden.

Kombinierte Ausgabe von WR und WG

Bei 0m/s Windgeschwindigkeit wird genau die Hälfte des analogen Wertes ausgegeben (5 V; 10 mA; bzw. 6V; 2mA).

Für einen Stromausgang 0...20mA gilt:
0..10mA = 20...0m/s (aus Richtung Norden)
10..20mA = 0...20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Stromausgang 4...20mA gilt:
4...12mA = 20...0m/s (aus Richtung Norden)
12...20mA = 0...20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Spannungsausgang 0...10V gilt:
0...5V = 20...0m/s (aus Richtung Norden)
5...10V = 0...20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Spannungsausgang 2...10V gilt:
2...6V = 20...0m/s (aus Richtung Norden)
6...10V = 0...20m/s (aus Richtung Süden)

7.2.5 Ausgabe der analogen Virtuell Temperatur

Die analoge Virtuell Temperatur kann an PIN 3 (ADIO) ausgegeben werden. Die Funktion von PIN3 (ADIO) wird mit Befehl AC eingestellt, siehe auch **Befehl AC**.

Die Skalierung der Virtuell Temperatur ist fest eingestellt. Das Ausgangssignal (Spannung, Strom) ist wie folgt skaliert: -40°...+80°C.

7.3 Datenerfassung

Die Hauptaufgabe der ULTRASONIC – Firmware ist die Datenerfassung und Datenaufbereitung. Zur Erfassung der Daten werden Schallimpulse von einem Sensor ausgesendet und vom gegenüberliegenden Sensor empfangen. Die gemessene Laufzeit ist ein Maß für die Geschwindigkeit. Hat jeder Sensor einmal gesendet und empfangen, ist ein Messzyklus abgeschlossen. Der so komplette Datensatz wird mit einem Zeitstempel versehen und in die nächste Ebene weitergereicht. Nach dem Plausibilitätstest werden die einzelnen Komponenten berechnet und, je nach Einstellung, entweder ausgegeben (siehe **7.3.1 Momentanwerte und Ausgabe der Rohmesswerte**) oder in den Mittelungspuffer geschrieben (siehe **Mittelung**) aufbereitet und ausgegeben.

7.3.1 Momentanwerte und Ausgabe der Rohmesswerte

Die Ausgabe der Momentanwerte ist in der Regel ein Sonderfall. Aufgrund der hohen Messwertaufnahme-geschwindigkeit ist in den meisten Fällen eine Mittelung der Daten sinnvoll. Sollen Momentanwerte ausgegeben werden, darf keine Mittelung eingeschaltet sein. Der Parameter AV ist auf ‚0‘ zu setzen, siehe **Befehl AV**.

Mit dem Parameter OR wird die Ausgaberate bei selbstständiger Ausgabe eingestellt. Bei einem Wert von ‚0‘ wird immer dann ein Telegramm ausgegeben, wenn ein neuer Messwert ermittelt wurde. Stellt man in diesem Modus die Baudrate entsprechend hoch und definiert ein kurzes anwenderspezifisches Telegramm, können die Rohmesswerte des ULTRASONIC ausgegeben werden.

Hinweis:

Im anwenderspezifischen Telegramm steht ein Datenwert ‚Messwertzähler‘ (Index 8) zur Verfügung, der bei jedem neuen Messwert inkrementiert wird. Ist die Differenz des Messwertzählers zwischen zwei ausgegebenen Telegrammen eins, so wird jeder Messwert ausgegeben. Die Messwerterfassung erfolgt in der Standardeinstellung alle 20ms.

Um die Messwerterfassung auf ein Maximum zu steigern (ca. alle 1,2ms einen neuen Messwert), müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Abschalten der Plausibilität 00PC00000
Messverzögerung auf null setzen: 00MD00000
Automatische Messanpassung aus: 00MA00000

Mit einer entsprechend hohen Baudrate können jetzt alle Messwerte des ULTRASONIC ausgegeben werden. Es wird empfohlen, sich ein anwenderspezifisches Telegramm zu erstellen und durch den ULTRASONIC selbstständig ausgeben zu lassen (00TT00006). Das Datenfeld Zeitstempel (Index 5 im benutzerdefinierten Telegramm) zeigt die relative Zeit des Messwertes zum Systemstart in ms an.

7.3.2 Mittelung

Aufgrund der hohen Datenerfassungsrate ist eine Mittelung in den meisten Fällen empfehlenswert. Der Mittelungszeitraum ist von 600ms bis zu 100 Minuten in weiten Grenzen frei einstellbar. Siehe auch ‚**Tabelle 7: Einstellen der Mittelungszeiträume mit Parameter AV**‘ unter ‚**Befehl AV**‘.

Grundsätzlich gilt, dass nur gültige Werte in den Mittelungspuffer geschrieben werden. Die Größe des Puffers ist nicht durch die Anzahl von Datensätzen festgelegt, sondern durch die Differenz des Zeitstempels zwischen erstem und letztem Datensatz. Dadurch haben evtl. fehlende Messwerte keinen Einfluss auf das Ergebnis der Mittelung. Im Statuswert des ULTRASONIC wird der Füllstand des Mittelungspuffers wiedergegeben. Es ist das Verhältnis zwischen tatsächlich belegten Speicher und maximal benötigtem Speicher (errechneter Wert). Die Ausgabe erfolgt in acht bzw. 16 Schritten, siehe **Statusinformationen**.

Im Ultrasonic 1D ist die vektorielle Mittelung integriert.

Die vektorielle Mittelwertbildung berücksichtigt bei der Mittelung der Windgeschwindigkeit die Windrichtung und bei der Mittelung der Windrichtung die Windgeschwindigkeit.

Beide gemittelten Größen, Windgeschwindigkeit und Windrichtung sind also mit der jeweils anderen Messgröße bewertet.

Dieses Verfahren der Mittelwertbildung ist z.B. für Schadstoff-Ausbreitungs-Messungen und -Bewertungen gut geeignet.

7.3.3 Standardabweichung

Die Berechnung der Standardabweichung ist ein weiteres Feature des ULTRASONIC. Bei einer Mittelungsdauer > 1sec werden die Standardabweichungen für die Windgeschwindigkeit, Windrichtung und Virtuelltemperatur ermittelt. Die Berechnung der Werte erfolgt nach folgender Formel:

$$S = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} (\bar{x} - x_k)^2} \quad \text{mit} \quad \bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} x_k$$

Die Standardabweichung wird durch das Kommando „DE00001“ eingeschaltet. Bei verwendeter Standardabweichung wird der benutzte Mittelwertspeicher auf 2000 Messwerte begrenzt. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen bei der Verwendung der Standardabweichung.

Welche berechneten Werte bei der Verwendung der Standardabweichung zur Verfügung stehen, ist unter **Verfügbare Messwerte und Datenformate** im Kapitel „**Anwenderspezifisches Telegramm**“ ersichtlich.

In der Voreinstellung ist die Berechnung der Werte für die Standardabweichung abgeschaltet. Sie muss explizit mit dem Befehl 00DE00001 eingeschaltet werden.

7.3.4 Messung im Burst- Mode

Eine weitere Messmethode ist die Messung im Burst- Mode. Hierbei misst das ULTRASONIC und speichert die gemessenen Werte im internen Datenspeicher ab. Ist der interne Datenspeicher voll, oder die angegebene Anzahl der Messwerte erreicht, gibt das ULTRASONIC die gemessenen Werte über die serielle Schnittstelle aus. Der Burst- Modus kann dazu verwendet werden Messwerte mit hoher Geschwindigkeit aufzunehmen und mit einer niedrigeren Baudrate auszugeben. Im Burst- Modus können maximal 40000 Messzyklen gespeichert werden. Die Speichertiefe kann mit dem Parameter BS eingestellt werden, siehe **Befehl BS**.

Weiterhin bietet der Burst-Modus die Möglichkeit Daten vor dem Triggerereignis mit aufzuzeichnen und auszugeben. Diese Funktion wird durch den Parameter BP festgelegt. BP gibt die Zeit in ms an, bei der die Datenaufzeichnung vor dem eigentlichen Triggerereignis startet.

Aktiviert wird der Burst- Modus durch den Befehl 00AC00016 bzw. 00AC00017, siehe **Befehl AC**. Hierbei wird der PIN 3 (ADIO) als Triggersignal zum Start der Messung benutzt.

Im Burst-Modus ist es außerdem möglich, die analogen Daten des Kanals WG/RXD+ mit aufzuzeichnen. Hierzu muss das Gerät allerdings in den Halbduplexmodus geschaltet werden.

Während der Messung im Burst- Modus werden keine Daten ausgegeben. Ist die Messung beendet werden die gemessenen Daten in dem eingestellten Ausgabetelegramm ausgegeben, siehe **Befehl TB**.

Beim Aktivieren des Burst-Modus wird der interne Millisekundenzähler auf null gesetzt. Nach Aktivieren des Burst-Modus muss dieser innerhalb von 49 Tagen gestartet werden um einen Timerüberlauf zu vermeiden. Bei der Datenausgabe nach Beendigung des Burst-Modus wird der Triggerzeitpunkt ausgegeben. Während der Datenausgabe wird an der Stelle des Triggersignals ein Telegramm „Trigger“ ausgegeben. Diese Ausgabe zeigt den Triggerzeitpunkt an.

Parametrisieren des Burst- Modus

Vor dem Starten des Burst- Modus können Systemparameter zur Messwertaufnahme angepasst werden:

- Die benutzte Anzahl von Messwerten wird mit dem Parameter BS eingestellt.
- Um eine maximale Messgeschwindigkeit zu erzielen kann der Parameter MD auf 0 und MA auf 0 geschaltet werden, siehe **Befehl MA** und **Befehl MD**. Hiermit wird die maximale Messfrequenz eingeschaltet.
- Eventuell ist es sinnvoll das Plausibilitätsfilter mit 00PC00000 abzuschalten, siehe **Befehl PC**.

Starten des Burst- Modus

- Lassen Sie den PIN 3 (ADIO) offen oder legen Sie ihn auf ein 5V Potential.
- Stellen Sie das gewünschte Ausgabetelegramm mit dem Befehl TB ein, siehe **Befehl TB**.
- Stellen Sie die gewünschte Puffertiefe für die Messung ein, siehe **Befehl BS**.
- Stellen Sie mit MD und MA die Messwerterfassungsgeschwindigkeit ein.
- Stellen Sie mit BP den Wert für den Pretrigger ein, z.B. zeichnet der Parameter PB00100 die Daten 100ms vor dem Triggerereignis mit auf.
- Schalten Sie evtl. die Plausibilitätsüberprüfung mit dem Befehl PC ab.

- Aktivieren Sie mit dem Befehl 00AC00017 den Burst- Modus.
Das ULTRASONIC gibt den Text aus:
Burst mode init.
Starts when ADIO goes low.
- Jetzt kann über PIN 3 (ADIO) die Messung gestartet werden. Nachdem der Messwertpuffer gefüllt ist, werden die Daten automatisch ausgegeben. Die Ausgabe kann nicht angehalten werden.

Arbeiten mit zusätzlichem analogem Messwert

Der Burst- Mode ist in der Lage einen zusätzlichen analogen Messwert aufzunehmen, abzuspeichern und mit dem Telegramm auszugeben. Zur Ausgabe des analogen Messwertes muss ein benutzerdefiniertes Telegramm angelegt werden, in dem der analoge Messwert mit ausgegeben wird.

Als Analogwert kann nur der Messwert auf PIN 4 mit erfasst werden.

Um den analogen Messwert von PIN 4 in die Burstmessung mit aufzunehmen, konfigurieren Sie das System wie folgt:

- Schalten Sie das System in den Halbduplex - Modus, siehe **Befehl DM**.
- Schalten Sie mit dem Befehl AB00001 PIN4 als analogen Eingang, siehe **Befehl AB**.
- Stellen Sie mit BP den Wert für den Pretrigger ein, z.B. zeichnet der Parameter PB00100 die Daten 100ms vor dem Triggerereignis mit auf.
- Formatieren Sie den Analogwert mit den Befehlen BY und BZ, siehe **Befehl BY**, **Befehl BZ**.
- Passen Sie mit dem Befehl AU die Abtastgeschwindigkeit des Eingangs ab, siehe **Befehl AU**.
- Konfigurieren Sie ein anwenderspezifisches Telegramm, siehe **Anwenderspezifisches Telegramm**.
- Konfigurieren Sie den Burstmode wie oben beschrieben.
- Stellen Sie das Ausgabetelegramm auf TB00006.

Beispiele zur Burstmodekonfiguration

Einfache Burstmodekonfiguration

00KY00001
 00TB00002 (VDT- Ausgabetelegramm)
 00BS00100 (100 Messungen im Burst-Mode)
 00AC00016 (Aktivieren des Burst-Modes)

Burstmodekonfiguration mit maximaler Messgeschwindigkeit, ohne Plausibilitätstest und wissenschaftlichem Ausgabetelegramm

00KY00001
 00TB00012 (Datenausgabe nach Messung: Wissenschaftliches-
 Ausgabetelegramm).
 00BS00100 (100 Messungen im Burst-Mode).
 00BP00100 Aufzeichnen der Daten 100ms vor dem Triggerereignis.
 00MD00000 (kein Delay zwischen Messungen).
 00MA00000 (Abschalten der automatischen Messgeschwindigkeitsanpassung).
 00PC00000 (Abschalten der Plausibilität).
 00AC00016 (Aktivieren des Burst-Modes).

Burstmodekonfiguration mit maximaler Messgeschwindigkeit, mit Plausibilitätstest, analogem Messwert und anwenderspezifischem Ausgabetelegramm

00KY00001
 00DM00000 (Schalten in den Halbduplex-Modus. ACHTUNG!! Verdrahtung
 der RS485 anpassen!!!)
 00KY00001
 00AB00001 (Aktivieren des analogen Eingangs).
 00TB00006 (Datenausgabe nach Messung: Anwenderspezifische-
 Ausgabetelegramm).
 00UT@5,6,2@,@6,6,2@,@19,5,0@,@3,9,0@\0d
 (Konfiguration des anwenderspezifischen Telegramms mit
 Windgeschwindigkeit, Windrichtung, analoger Messwert,
 Zeitstempel).
 00US00002 (Speichern des anwenderspezifischen Telegramms).

00AU00001	(Update der Analogeingänge auf Maximalgeschwindigkeit (max. 3ms).
00BS00100	(100 Messungen im Burst-Mode).
00BP00100	Aufzeichnen der Daten 100ms vor dem Triggerereignis.
00MD00000	(Kein Delay zwischen Messungen).
00MA00000	(Abschalten der automatischen Messgeschwindigkeitsanpassung).
00PC00007	(Einschalten der Plausibilität).
00AC00016	(Aktivieren des Burst-Modes).

Beenden des Burst-Modus

- Mit dem Befehl 00AC00000 den Burst- Modus beenden.
- Mit dem Befehl TT das gewünschte Ausgabetelegramm aktivieren.

Einschränkungen im Burst-Modus.

Für die Messung im Burst-Modus gelten folgende Einschränkungen:

- Im Burst-Modus werden keine Standardabweichungen und Kovarianzen berechnet.
- Der Mittelwertpuffer ist nach dem Burst-Modus gelöscht.
- Der Burst-Modus funktioniert nicht im Bus-Betrieb.
- Bei der Verwendung des analogen Eingangs können, je nach Einstellung, die ersten beiden analogen Messwerte fehlerhafte Werte besitzen. Dieses Verhalten ist technisch bedingt und nicht zu vermeiden.
- Im Zeitraum des Pretriggers sind die aufgezeichneten Analogwerte ungültig.

7.3.5 Böenerfassung

Bei einer eingestellten Mittelung ermittelt das ULTRASONIC die Mittelwerte von Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Bei einigen Anwendungen ist es sinnvoll, zusätzlich die maximale Windgeschwindigkeit im Mittelwertzeitraum und die zugehörige Windrichtung auszugeben.

Mit dem Befehl GU (aus dem englischen ‚gust‘) wird die maximale Windgeschwindigkeit im Mittelwertpuffer ermittelt. Die Länge der Böe wird durch den Parameter des Befehls GU in 100ms – Schritten eingestellt und ist liegt zwischen 100 ms bis 3 sec. Der Parameterwert 0 schaltet die Böenmessung aus.

Beispiel:

00GU00010	Schaltet die Böenermittlung ein. Die Böenlänge ist 1 Sekunde.
00GU00000	Schaltet die Böenmessung aus.

Ausgegeben können die Messwerte der Böe nur mit Hilfe des anwenderspezifischen Telegramms, siehe **Anwenderspezifisches Telegramm**.

Beispiel:

00AV00003 Eine Minute Mittelung.

00GU00030 Böenlänge ist 3 Sekunden (WMO-Empfehlung für Böenlänge).

00UT\02@05,04,01@ @06,03@ @07,05,01,01@ @27,04,01@ @28,03@
@15,02,02@* @24,01,27,02,02@\0D\03

Anwenderspezifisches Protokoll. Abfrage mit TR00006 oder TT00006
VDT-Telegramm plus Böe.

(STX) WG WR VT WG_Böe WR_Böe Status*Prüfsumme(CR)(ETX).

00UT00002 Speichern des anwenderspezifischen Telegramms.

00TT00006 Automatische Ausgabe des Datentelegramms.

Die Böenmesswerte haben folgende Eigenschaften:

- Die eingestellte Zeit für die Böe muss kleiner sein als der eingestellte Mittelungszeitraum, siehe **Befehl AV**.
- Ist der Zeitraum der Mittelwerte kleiner oder gleich des Zeitraums für die Böe wird für die Windgeschwindigkeit und Windrichtung der Böe Null ausgegeben.
- Bei Windgeschwindigkeiten der Böe < 0,1m/s wird für die Windrichtung 0 ausgegeben.
- Ist die berechnete Windrichtung 0, wird sie auf 360 gesetzt.

7.4 Serielle Datenausgabe

Als serielle Datenausgabe wird das Senden der Daten über die RS485 Schnittstelle bezeichnet. Zum Senden der Daten stehen zwei Modi zur Verfügung:

- Selbstständiges Senden der Daten.
- Senden der Daten durch Abfragetelegramm.

Das selbstständige Senden der Daten wird mit dem Befehl 00TT000XX eingestellt, wobei XX für die entsprechende Telegrammnummer steht. In diesem Fall sendet das ULTRASONIC zyklisch seine Daten mit der Wiederholrate, die mit dem Parameter OR eingestellt wurde.

7.4.1 Datenabfrage

Mit dem Befehl TR werden die Daten vom ULTRASONIC abgefragt. Der Befehl hat keinen Zugriffsschutz. Nach Abarbeitung des Befehls sendet das Gerät das entsprechende Antworttelegramm zurück. Die Zeit zwischen letztem Zeichen im Anforderungstelegramm und erstem Zeichen im Datentelegramm ist < 0,5ms.

Als Datentelegramme steht das benutzerdefinierte Telegramm sowie die Telegramme, wie unter ‚Feste Telegrammformate‘ beschriebenen Definitionen, zur Verfügung.

7.4.2 Selbstständige Telegrammausgabe

Die selbstständige Telegrammausgabe wird mit dem Befehl TT eingestellt. Nach Eingabe eines gültigen Telegrammtyps sendet das ULTRASONIC selbstständig das gewählte Datentelegramm. Das Sendeintervall wird mit dem Befehl OR in ms eingestellt. Als Standard wird das Telegramm alle 100ms gesendet. Erlaubt die eingestellte Baudrate die Einhaltung des Ausgabezyklus nicht (die Zeit zur Datenübertragung ist größer der Intervallzeit), so kann es vorkommen, dass eine Telegrammausgabe nicht ausgeführt werden kann.

Achtung:

Eine selbstständige Telegrammausgabe ist im Vollduplexbetrieb und ab Softwareversion V3.10 auch im Halbduplexbetrieb möglich.

7.4.3 Feste Telegrammformate

Zur Telegrammausgabe stehen für die selbstständige Ausgabe (Befehle TT) und Datenanfrage (Befehl TR) einige vordefinierte Telegramme zur Verfügung. Der detaillierte Aufbau ist in Anhang 1 (Vordefinierte Datentelegramme) beschrieben. Eine Referenzliste der Telegrammformate ist in Tabelle 5 zu sehen.

Telegrammname	Telegrammnummer	Telegrammaufbau
VD	00001	(STX)vv.v ddd*cc(CR)(ETX)
VDT	00002	(STX)vv.v ddd ttt.t ss*cc(CR)(ETX)
V4DT	00003	(STX)vvv.v ddd ttt.t v ss*cc(CR)(ETX)
NMEA V 2.0	00004	\$WIMWV,ddd.d,R,vvv.v,v,A*xx(CR)(LF)
Standard Abweichung	00005	(STX)vv.v ddd.d ddd ttt.t hhh uuu.u ss*cc(CR)(ETX)
Anwenderspezifisch	00006	Es wird das anwenderspezifische Telegramm ausgegeben (siehe Kapitel 7.4.5)
VD- Variante 1	00008	(STX)vv.v ddd*cc(CRLF)(ETX)
VDT- Variante 1	00009	!iivvdddtttwf(CR)
VDT- Variante 2	00011	Siehe Anhang (Kapitel 10)
Wissenschaftliches Telegramm	00012	Siehe Anhang (Kapitel 10)
VDT- Variante 3	00013	Siehe Anhang (Kapitel 10)

Tabelle 5: Liste der vordefinierten Datentelegramme

Erklärung:

- v: Windgeschwindigkeit (siehe **Befehl OS**)
- h: Standardabweichung der Windgeschwindigkeit
- d: Windrichtung
- t: Temperatur
- u: Standardabweichung der Temperatur
- s: Statusbyte
- c: Prüfsumme Typ 1 (EXOR-Verknüpfung)
- v: Kennung für Skalierung der Windgeschwindigkeit (K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mph)
- b: Windgeschwindigkeit in Y-Richtung (Nord -> Süd)
- w: Statusbyte Variante 1
- f: Prüfsumme Typ 2
- i: Geräte ID

7.4.4 Bildung der Prüfsumme

Abhängig vom Ausgabetelegramm werden zwei unterschiedliche Prüfsummen gebildet, Typ 1 bzw. Typ 2.

7.4.4.1 Typ 1

Die Prüfsumme ist das Ergebnis der byteweisen EXOR-Verknüpfung der im Telegramm ausgegebenen Bytes.

Die EXOR - Verknüpfung umfasst alle Bytes zwischen dem Telegramm-Startzeichen „STX“, oder „\$“ beim NMEA - Telegramm und dem Byte „*“ als Erkennungszeichen für den Beginn der Prüfsumme.

Die Bytes „STX“ bzw. „\$“ und „*“ werden bei der Prüfsummenberechnung also nicht berücksichtigt!

7.4.4.2 Typ 2

Die Prüfsumme ist das Ergebnis der byteweisen EXOR-Verknüpfung der im Telegramm ausgegebenen Bytes ohne das '!' Zeichen zu Beginn des Telegramms.

Bei dem entstehenden Prüfbyte werden High-und-Low-Nibble (4bit) EXOR verknüpft, mit dem Wert 48 addiert und als ASCII-Wert ausgegeben.

7.4.5 Anwenderspezifisches Telegramm

Das ULTRASONIC besitzt die Möglichkeit eigene Telegramme zu definieren. Mit Hilfe eines formatierten Textes können die internen Mess- und Statuswerte des ULTRASONIC ausgegeben werden. Es stehen über 25 verschiedene Werte zur Ausgabe zur Verfügung. Ausgegeben wird das benutzerdefinierte Telegramm mit der Telegrammnummer 6. So wird z.B. durch Eingabe von 00TR00006 das ULTRASONIC aufgefordert, das benutzerdefinierte Telegramm auszugeben.

Zur Definition des benutzerdefinierten Telegramms stehen die Befehle UA, UT, UR und US zur Verfügung. Siehe hierzu auch: **Befehl UA**, **Befehl UR**, **Befehl US**, **Befehl UT**. Mit Hilfe dieser Befehle kann ein neues Telegramm erstellt, ein bestehendes Telegramm erweitert, Telegramminformationen gelöscht und letztendlich die Telegrammdefinition im EEPROM gespeichert werden.

In dem formatierten Text werden die Messwerte ausgewählt und das Format festgelegt.

Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm' zeigt die Liste der zur Verfügung stehenden Daten.

Weiterhin beinhaltet der formatierte Text die Möglichkeit eine feste Zeichenkette auszugeben. Die Definition

```
00UAHallo Welt\0d<cr>    <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)
```

erzeugt die Telegrammausgabe

Hallo Welt

7.4.5.1 Erzeugen eines neuen, anwenderspezifischen Telegramms

Mit dem Befehl UT wird ein bestehendes Telegramm komplett überschrieben. So wird zum Beispiel mit dem Befehl:

```
00UTWindgeschwindigkeit: @5,6,2@m/s\0d<cr>    <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)
```

Die Ausgabe

Windgeschwindigkeit: 001.64 m/s

Mit der Telegrammausgabe zurückgegeben. (Voraussetzung ist natürlich, dass die aktuelle Windgeschwindigkeit 1.64m/s ist).

7.4.5.2 Anhängen von Definitionen

Mit dem Befehl UA können neue Definitionen an das Ende angehängt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Anhängen von Definitionen unter Umständen einen höheren Speicherbedarf hat als die Telegrammdefinition mit dem Befehl UT.

Intern verfügt das ULTRASONIC über 30 Definitionsblöcke. Jeder dieser Blöcke kann die Definition eines Datenwertes oder 5 feste Zeichen aufnehmen. Es ist darauf zu achten, dass ein einmal definierter Block nicht erweitert werden kann.

Das anwenderspezifische Telegramm kann bis zu 28 Definitionen aufnehmen. Eine Definition kann 1 bis 5 Zeichen enthalten, d.h. auch ein einzelnes Semikolon belegt eine Definition.

Beispiel:

Die Definition

00UAHALLO<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

erzeugt einen neuen Block, der die Zeichenkette HALLO enthält.

Die Definitionen

UAH<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

UAA<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

UAL<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

UAL<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

UAO<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

belegen 5 Blöcke, in dem jeweils nur ein Zeichen belegt ist. Die Ausgabe führt in beiden Fällen zum gleichen Ergebnis, der benutzte Speicher ist aber in der zweiten Version erheblich größer.

Ein neuer Block wird generell immer bei einer Messwertdefinition begonnen. Eine Messwertdefinition ist immer mit dem Zeichen ‚@‘ eingerahmt. Auch nach einer Messwertdefinition wird ein neuer Block belegt. Wird dies bei der Eingabe berücksichtigt, kann mit dem Befehl UA die gleiche effektive Speicherbelegung erzielt werden, wie mit dem Befehl UT.

Die Methode mit dem geringsten Speicherbedarf ist die Eingabe des kompletten Telegramms mit dem Befehl UT.

7.4.5.3 Löschen von Definitionen

Das Löschen von Definitionen bezieht sich immer auf die letzten Blöcke in der Definitionsliste, siehe **7.4.5.2 Anhängen von Definitionen**.

Mit dem Befehl UR00002 werden z.B. die letzten zwei Definitionsblöcke gelöscht. Es ist zu beachten, dass eine Definition, eingegeben mit UA oder UT, intern in mehrere Blöcke aufgeteilt werden kann. Es wird daher empfohlen beim Löschen von Definitionen schrittweise vorzugehen und sich die Auswirkung im Telegramm 6 anzusehen.

7.4.5.4 Speichern von Definitionen

Nach der Eingabe des benutzerdefinierten Telegramms kann dieses mit dem Befehl 00US00002 gespeichert werden. Das Speichern ist notwendig, damit das ULTRASONIC beim nächsten Neustart das definierte Telegramm lädt.

7.4.5.5 Verfügbare Messwerte und Datenformate

In dem anwenderspezifischen Telegramm werden innerhalb der Formatierungszeichen ‚@‘ die Messwerte (dargestellt durch eine Nummer) und das Ausgabeformat des Messwertes definiert. Dabei ist jeder Messwert ein Objekt eines Datentyps. Datentypen sind z.B. TEXT, ZAHL oder GANZE_ZAHL. Die Windgeschwindigkeit ist z.B. vom Datentyp ZAHL, siehe **Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm**.

Beispiel:

In dem anwenderspezifischen Telegramm soll die Windgeschwindigkeit ausgegeben werden. Aus der unten stehenden Tabelle kann man entnehmen, dass die Windgeschwindigkeit den Index 5 hat. Also beginnt der Formatierungsstring mit 00UT@5

Weiterhin ist aus der Tabelle ersichtlich, dass die WG vom Datentyp ZAHL ist. Soll die Windgeschwindigkeit ohne Vorzeichen mit insgesamt 6 Zeichen (einschließlich Komma) und 2 Nachkommastellen ausgegeben werden, so lautet der komplette Formatierungsstring

00UT@5,6,2@

Soll weiterhin ein Zeilenvorschub an das Ende der Ausgabe gehängt werden, so muss das ASCII-Zeichen 13 (0Dh) angehängt werden.

00UT@5,6,2@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Messwert-Nummer	Beschreibung	Datentyp
0	Reserviert	
1	Streckenmesswert Nord -> Süd (Zählwert) Bei Mittelung ist es der Mittelwert über alle Messwerte	GANZE_ZAHL
2	Streckenmesswert Süd -> Nord (Zählwert) Bei Mittelung ist es der Mittelwert über alle Messwerte	GANZE_ZAHL
3	Zeitstempel des letzten gemessenen Datensatzes (Wert in ms, relativ zu Systemstart).	GANZE_ZAHL
4	Windgeschwindigkeit in Y-Richtung (Positiv bedeutet Wind in Richtung Norden)	ZAHL
5	Windgeschwindigkeit	ZAHL
6	Windrichtung	ZAHL
7	Virtuelltemperatur [°C]	ZAHL
8	Messwertzähler Gibt die Anzahl der Datensätze an, die seit dem Systemstart gemessen wurden.	GANZE_ZAHL
9	Standardabweichung der Windgeschwindigkeit in Y-Richtung	ZAHL
10	Standardabweichung der Windgeschwindigkeit	ZAHL
11	Reserviert	ZAHL
12	Standardabweichung der Virtuelltemperatur	ZAHL
13	reserviert	
14	Statusinformation (4 BYTE)	GANZE_ZAHL
15	THIES Status (2 Byte)	GANZE_ZAHL
16	reserviert	
17	Speicherintervall (Gibt das Zeitintervall an, in dem die Daten in den Mittelungsspeicher geschrieben werden)	GANZE_ZAHL
18	Anzahl der Daten im Mittelwertpuffer	GANZE_ZAHL

Messwert- Nummer	Beschreibung	Datentyp
19	Eingelesener, analoger Messwert vom Pin WG/RXD-	ZAHL
20	Eingelesener, analoger Messwert vom Pin WR/RXD+	ZAHL
21	Eingelesener, analoger Messwert vom Pin ADIO	ZAHL
22	Eingelesener, analoger Messwert der Referenzspannung (980..1010)	ZAHL
23	reserviert	
24	Exclusiv- Oder Prüfsumme des Datenstroms (Typ 1)	PRÜF_SUMME
25	ULTRASONIC ID	GANZE_ZAHL
26	Status für Telegramm 9	GANZE_ZAHL
27	Windgeschwindigkeit der Böe (siehe Befehl GU)	ZAHL
28	Windrichtung der Böe (siehe Befehl GU)	ZAHL
29	Gemessene interne Versorgungsspannung	ZAHL
30	Gehäuseinnentemperatur	ZAHL

Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm

7.4.5.6 Datenformate

Wie bereits unter **Verfügbare Messwerte und Datenformate** beschrieben, ist jeder Datenwert von einem bestimmten Typ abgeleitet. Zur Darstellung besitzen die Typen jeweils eine eigene Definition der Formatierung. Der Formatierungsstring wird bei der Eingabe hinter der Messwertnummer angegeben, Formatierungsstring und Messwertnummer sind hierbei durch ein Komma voneinander getrennt.

Beispiel:

Der Befehl

00UTHallo Welt @7,8,2,1@0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

definiert die Ausgabe des Textes ‚Hallo Welt‘, gefolgt von der Virtuelltemperatur (Formatiert: 8 Zeichen insgesamt, 2 Zeichen nach dem Komma, mit Vorzeichen) und einem Zeilenvorschub.

7.4.5.6.1 Ausgabe von festen Texten

Das ULTRASONIC besitzt ein internes Datenformat TEXT, das das einfachste und gleichzeitig universellste Datenformat ist. Es dient dazu, innerhalb der Telegrammausgabe einen festen Text auszugeben. Dieses Datenformat benötigt keine weiteren Formatierungszeichen. Zum Beispiel definiert der Befehl

00UTHallo Welt\0d<cr>
das Ausgabetelegramm

Hallo Welt

Innerhalb dieses Datentyps stehen alle ASCII - Zeichen über das Schlüsselzeichen ‚\‘ zur Verfügung. Es muss allerdings beachtet werden, dass der ASCII- Code mit 2 Zeichen im Hexadezimalformat angegeben wird. So erzeugt die Eingabe

00UT\41

ein A in der Ausgabe. Das Schlüsselzeichen \ wurde eingeführt, um Steuerzeichen wie STX, ETX, CR in ein Telegramm integrieren zu können. Die Eingabe

00UA\0d

hängt einen Zeilenvorschub an das Telegramm an.

Ein konstanter Text kann an beliebiger Stelle in der Telegrammdefinition stehen (Er darf die Formatierung eines anderen Datentyps natürlich nicht unterbrechen). So ist z.B. folgende Definition denkbar:

00UTWG = @5,6,2@ WR = @6,3@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Denkbar ist folgender Ausgabestring:

WG = 000.06 WR = 181

7.4.5.6.2 Datenformat GANZE_ZAHL

Eine ganze Zahl ist eine Zahl, die ohne Kommata ausgegeben wird. Sie kann jedoch ein Vorzeichen enthalten oder / und hexadezimal dargestellt werden.

Format:

@'Messwert','Zeichenanzahl','Format'@

mit

Messwert: siehe **Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm**

Zeichenzahl: Anzahl der ausgegebenen Zeichen inklusiv evtl. Vorzeichen

Format: Format der dargestellten Zahl

0: ohne Vorzeichen und dezimal

1: mit Vorzeichen und dezimal

2: ohne Vorzeichen und hexadezimal

3: mit Vorzeichen und hexadezimal

Die Zeichenanzahl und das ‚Format‘ müssen nicht angegeben werden, sie werden in diesem Fall mit den Werten ‚3‘ (Zeichenanzahl) und ‚0‘ (Format) aufgefüllt.

Beispiel1:

00ut@17@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Gibt das Speicherintervall mit drei Stellen ohne Vorzeichen aus. (Anzeige ist nur bei eingeschalteter Mittelung ungleich null)

Beispiel2:

00ut@17,3,2@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Gibt das Speicherintervall mit drei Stellen ohne Vorzeichen als hexadezimalen Wert aus. (Anzeige ist nur bei eingeschalteter Mittelung ungleich null)

7.4.5.6.3 Datenformat ZAHL

Als Zahl wird eine Fließkommazahl bezeichnet. Sie wird ähnlich formatiert wie die GANZE_ZAHL mit dem Zusatz, dass eine Angabe über die Nachkommastelle gemacht werden kann.

Format:

@'Messwert','Zeichenanzahl','Nachkommastellen','Format'@

mit

Messwert: siehe **Tabelle 6: Messwerte und Datentypen für das anwenderspezifische Telegramm**

Zeichenanzahl: Anzahl der ausgegebenen Zeichen inklusiv Kommata und evtl. Vorzeichen

Nachkommastellen: Anzahl der Stellen nach dem Kommata

Format: Format der dargestellten Zahl

- 0: ohne Vorzeichen und dezimal
- 1: mit Vorzeichen und dezimal
- 2: ohne Vorzeichen und hexadezimal
- 3: mit Vorzeichen und hexadezimal

Die Zeichenanzahl, Nachkommastellen und das ‚Format‘ müssen nicht angegeben werden, sie werden in diesem Fall mit den Werten ‚3‘ (Zeichenanzahl) ‚0‘ (Nachkommastellen) und ‚0‘ (Format) aufgefüllt.

Beispiel 1:

00ut@6@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Gibt die Windrichtung mit drei Stellen vor dem Komma, keiner Nachkommastelle und dezimal aus.

Beispiel 2:

00UT@7,8,2,1@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

Gibt die Virtuelltemperatur mit insgesamt 8 Zeichen, 2 Nachkommastellen und Vorzeichen aus.

7.4.5.6.4 Datenformat PRÜF_SUMME

Das Datenformat PRÜF_SUMME unterstützt die Berechnung einer Prüfsumme auf der Basis einer byteweisen Exklusiv- Oder Verknüpfung. Die PRÜF-SUMME hat folgendes Format:

@24,'First','Last', 'Zeichenanzahl','Format'@

mit

24:	Messwertkennung für EXOR- Prüfsumme
First:	Nummer des Zeichens, an dem die Prüfsummenbildung startet. Dieses Zeichen wird in die Berechnung einbezogen (Zählweise beginnt mit 0).
Last:	Nummer des Zeichens, an dem die Prüfsummenbildung endet. Dieses Zeichen wird nicht in die Berechnung einbezogen.
Zeichenzahl:	Anzahl der ausgegebenen Zeichen inklusiv evtl. Vorzeichen
Format:	Format der dargestellten Zahl
	0: ohne Vorzeichen und dezimal
	1: mit Vorzeichen und dezimal
	2: ohne Vorzeichen und hexadezimal
	3: mit Vorzeichen und hexadezimal

Beispiel 1:

Über einen konstanten Text ‚AABBCC‘ soll über die Zeichen BB die Prüfsumme gebildet werden. Die Ausgabe erfolgt hexadezimal mit 2 Zeichen:

00UTAABBCC XOR=@24,2,4,2,2@\0d<cr> <cr> steht für Carriage Return
(Enter Taste)

Die Ausgabe ist

AABBCC XOR=00h

Die XOR- Verknüpfung von zwei gleichen Zeichen ist immer 0.

Beispiel 2:

Über einen konstanten Text ‚AABBCC‘ soll über das Zeichen ‚B‘ die Prüfsumme (Typ 1) gebildet werden. Die Ausgabe erfolgt hexadezimal mit 2 Zeichen:

00UTAABBCC XOR=@24,2,3,2,2@h\0d<cr>

<cr> steht für Carriage Return
(Enter Taste)

Die Ausgabe ist

AABBCC XOR=42h

Der Wert der Prüfsumme ist 42h. Der ASCII-Wert von 42h ist ‚B‘, was das zu überprüfende Zeichen selbst ist.

7.4.6 Statusinformationen

Innerhalb des ULTRASONIC stehen zwei verschiedene Statusbytes zur Verfügung:

- Erweiterte Statusinformationen.
- THIES- Status.

Der THIES- Status leitet sich aus der erweiterten Statusinformation ab. Im Folgenden wird der Aufbau der Statuswerte beschrieben.

7.4.6.1 Erweiterte Statusinformation

Der erweiterte Status ist bitweise aufgebaut. Die einzelnen Bits im Statuswert haben folgende Bedeutung:

Bit-Nummer	Funktion	Beschreibung	
Bit 0	Generelle Störung	Mittelungszeit < 10 Sek	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn über einen Zeitraum von 10Sek kein neuer Messwert ermittelt werden kann.
		Mittelungszeit > = 10Sek	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn auf Basis einer sekundlichen Messrate weniger als 50% Werte enthalten sind. Beispiel: bei einer Mittelung von 10 Sekunden, müssen 5 Messwerte im Mittelungspuffer enthalten sein.
Bit 1	Heizungskriterium	Ist eins, wenn das Kriterium zum Einschalten der Heizung erfüllt ist.	
Bit 2	Heizung ein	Ist eins, wenn Heizung eingeschaltet ist.	
Bit 3	reserviert	Ist immer null	
Bit 4	Statische Störung	Wird gesetzt, wenn eine statische Störung aufgetreten ist. z.B. dauerhafte Verletzung der VT, keine Messwerte. (> 1min)	
Bit 5 .. Bit 7	reserviert	Ist immer null	
Bit 8	Benutzer Mittelungsspeicher	Gibt den belegten Mittelungsspeicher an. Bit 1 bis Bit 3 geben den Füllgrad des Mittelungspuffers im Binärformat an. 0: Puffer 0 $x \le 1/16$	
Bit 9			
Bit 10			

Bit-Nummer	Funktion	Beschreibung
Bit 11		1: Puffer $1/8 < x \leq 1/8$ gefüllt 2: Puffer $1/8 < x \leq 3/16$ gefüllt 3: Puffer $3/16 < x \leq 1/4$ gefüllt 4: Puffer $1/4 < x \leq 5/16$ gefüllt 5: Puffer $5/16 < x \leq 3/8$ gefüllt 6: Puffer $3/8 < x \leq 7/16$ gefüllt 7: Puffer $7/16 < x \leq 1/2$ gefüllt 8: Puffer $1/2 < x \leq 9/16$ gefüllt 9: Puffer $9/16 < x \leq 5/8$ gefüllt 10: Puffer $5/8 < x \leq 11/16$ gefüllt 11: Puffer $11/16 < x \leq 3/4$ gefüllt 12: Puffer $3/4 < x \leq 13/16$ gefüllt 13: Puffer $13/16 < x \leq 7/8$ gefüllt 14: Puffer $7/8 < x \leq 15/16$ gefüllt 15: Puffer $15/16 < x \leq 1$ gefüllt
Bit 12	reserviert	
Bit 13	Flag Neustart	Ist im ersten Ausgabetelegramm nach Neustart auf 1 gesetzt.
Bit 14..Bit15	reserviert	Ist immer null.
Bit 16..Bit31	reserviert	Ist immer null.

7.4.6.2 THIES Status

Der THIES- Status ist bitweise aufgebaut. Die einzelnen Bits im Statuswert haben folgende Bedeutung:

Bit-Nummer	Funktion	Beschreibung
Bit 0	Generelle Störung	Mittelungszeit < 10 Sek Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn über einen Zeitraum von 10Sek kein neuer Messwert ermittelt werden kann.
		Mittelungszeit >= 10 Sek Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn auf Basis einer sekundlichen Messrate weniger als 50% Werte im Mittelungspuffer enthalten sind. Beispiel: Bei einer Mittelungszeit von 10 Sekunden, müssen mindestens 5 Messwerte im Mittelungspuffer enthalten sein.
Bit 1	Benutzer Mittelungsspeicher	Gibt den belegten Mittelungsspeicher an. Bit 1 bis Bit 3 geben den Füllgrad des Mittelungspuffers im Binärformat an. 0: Puffer 0 < x ≤ 1/8 1: Puffer 1/8 < x ≤ 1/4 gefüllt 2: Puffer 1/4 < x ≤ 3/8 gefüllt 3: Puffer 3/8 < x ≤ 1/2 gefüllt 4: Puffer 1/2 < x ≤ 5/8 gefüllt 5: Puffer 5/8 < x ≤ 3/4 gefüllt 6: Puffer 3/4 < x ≤ 7/8 gefüllt 7: Puffer 7/8 < x ≤ 1 gefüllt
Bit 2		
Bit 3		
Bit 4	reserviert	Ist immer null
Bit 5	Statische Störung	Wird gesetzt, wenn eine statische Störung aufgetreten ist. z.B. dauerhafte Verletzung der VT, keine Messwerte. (> 1min)
Bit 6	Heizungskriterium	Ist eins, wenn das Kriterium zum Einschalten der Heizung erfüllt ist.
Bit 7	H Heizung ein	Ist eins, wenn Heizung eingeschaltet ist.

7.4.6.3 Statusinformationen im Bayern Hessen – Format

Für den Bayern Hessen Kommandointerpreter werden ein separater Betriebsstatus und Fehlerstatus generiert. Sie haben folgenden Aufbau:

Bayern Hessen Betriebsstatus:

Bit-Nummer	Funktion	Beschreibung
Bit 0		Immer null
Bit 1	Benutzter Mittelungsspeicher	Gibt den belegten Mittelungsspeicher an. Bit 1 bis Bit 3 geben den Füllgrad des Mittelungspuffers im Binärformat an. 0: Puffer $0 < x \leq 1/8$ 1: Puffer $1/8 < x \leq 1/4$ gefüllt 2: Puffer $1/4 < x \leq 3/8$ gefüllt 3: Puffer $3/8 < x \leq 1/2$ gefüllt 4: Puffer $1/2 < x \leq 5/8$ gefüllt 5: Puffer $5/8 < x \leq 3/4$ gefüllt 6: Puffer $3/4 < x \leq 7/8$ gefüllt 7: Puffer $7/8 < x \leq 1$ gefüllt
Bit 2		
Bit 3		
Bit 4	reserviert	Ist immer null.
Bit 5	Heizungskriterium	Ist eins, wenn das Kriterium zum Einschalten der Heizung erfüllt ist.
Bit 6	Heizung ein	Ist eins, wenn Heizung eingeschaltet ist.
Bit 7	Reserviert	Ist immer null.

Bayern Hessen Fehlerstatus:

Bit-Nummer	Funktion	Beschreibung	
Bit 0	Generelle Störung	Mittelungszeit < 10Sek	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn über einen Zeitraum von 10Sek kein neuer Messwert ermittelt werden kann.
		Mittelungszeit \geq 10Sek	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn auf Basis einer sekundlichen Messrate weniger als 50% Werte im Mittelungspuffer enthalten sind. Beispiel: Bei einer Mittelungszeit von 10 Sekunden, müssen mindestens 5 Messwerte im Mittelungspuffer enthalten sein.
Bit 1	Statische Störung	Wird gesetzt, wenn eine statische Störung aufgetreten ist. Z.B. dauerhafte Verletzung der VT, keine Messwerte. (> 1min)	
Bit 2..7	reserviert	Immer null.	

7.5 Verhalten des Gerätes unter extremen Messwertaufnahme-Bedingungen

Das ULTRASONIC verfügt intern über ein sehr effektives Fehlererkennungs- und Korrekturverfahren. Es erlaubt anhand der Historie, fehlerhafte Messwerte zu erkennen und wenn möglich zu korrigieren. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass das ULTRASONIC in eine Situation gerät, in der es keine neuen Daten erfassen kann. In diesem Fall werden die Fehlerbits in den Statuswerten gesetzt und evtl. an den Analogausgängen ein definierter Wert ausgegeben.

Grundsätzlich gilt, dass die ausgegebenen Messwerte immer Gültigkeit besitzen und vom Zielsystem interpretiert werden können (es sei denn, im Fehlerfall wird ein bestimmtes Fehlertelegramm ausgegeben). Im Fehlerfall können die Daten ‚zu alt‘ werden, d.h. sie werden über eine gewisse Zeit nicht aktualisiert und frieren ein. In diesem Fall werden die Fehlerbits im Statusbyte gesetzt und die Analogausgänge auf einen definierten Wert gesetzt. Ist bei einem seriellen Telegramm ein spezielles Fehlertelegramm definiert, wird dieses ausgegeben.

7.5.1 Eintreten des Fehlerfalls:

Ein Fehlerfall tritt unter folgenden Umständen ein:

Mittelungszeit < 10Sek (Parameter AV)	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn über einen Zeitraum von > 10Sek kein neuer Messwert ermittelt werden kann.
Mittelungszeit ≥ 10Sek (Parameter AV)	Es wird ein Fehler ausgegeben, wenn auf Basis einer sekundlichen Messrate weniger als 50% Werte im Mittelungspuffer enthalten sind. Beispiel: Bei einer Mittelungszeit von 10 Sekunden, müssen mindestens 5 Messwerte im Mittelungspuffer enthalten sein.

7.5.2 Verhalten der analogen Ausgänge

Sind die analogen Ausgänge aktiv, so werden diese im Fehlerfall auf den Minimal- bzw. Maximalwert geschaltet. Welcher dieser beiden Werte ausgegeben wird, stellt der Parameter EI ein, siehe **Befehl EI**.

7.5.3 Verhalten der Telegrammausgabe

Im Fehlerfall wird das entsprechende Fehlerfalltelegramm ausgegeben. Parallel dazu werden die Fehlerinformationen im Statusbyte angezeigt, siehe **Feste Telegrammformate**.

7.6 Heizungssteuerung

Um ein Vereisen und in Folge Fehlmessungen des Gerätes zu vermeiden, besitzt der ULTRASONIC eine in die Sensorarme eingebaute Heizung. Im Standardbetrieb wird das Ein- und Ausschalten der Heizung durch die akustische virtuelle Temperatur der Luft gesteuert.

Zusätzlich besitzt der Ultrasonic einen PT1000 Temperatursensor im Gerätefuß, dessen Messgröße als plausible Information zur Steuerung der Heizung verwendet wird. Für weitere Informationen, siehe **Befehl HT**. Die Steuerung der Heizung durch die Software kann in 6 Modi konfiguriert werden. Die einzelnen Schaltbedingungen für die Heizung sind unter **Befehl HT** aufgelistet.

Für das Einschaltkriterium müssen folgende Punkte erfüllt sein:

1. Andauernde Störung der Messwertaufnahme für mind.10s.
2. Die Versorgungsspannung muss größer als der eingestellte Schwellwert sein, siehe (HC).

Funktionsüberprüfung durch den Monteur:

Der Monteur stört die Messwertaufnahme z.B. durch Zuhalten eines Sensors mit der Hand.

Für HT1 gilt:

Die Heizung schaltet nach ca. 10s ein.

Für HT3 / HT4 und HT5 gilt:

Die Armheizung schaltet nach 10s ein wenn die Gehäuseinnentemperatur $< 25^{\circ}\text{C}$ beträgt ($< 15^{\circ}\text{C}$ bei HT5). Nach einem Neustart durch „Reboot at Fail“ (siehe Befehl RF für die Zeit bis Neustart) schaltet die Heizung bei anhaltender Störung, unabhängig von der Gehäuseinnentemperatur, sofort ein, vorausgesetzt die Versorgungsspannung liegt oberhalb des Parameters HC. Der Neustart wird dabei ausgelöst, indem eine der beiden Messstrecken mit der Hand permanent blockiert wird. Die Zeit für das Blockieren wird durch den Parameter RF angegeben. Der Monteur erkennt den Neustart dadurch, dass die Ultraschallwandler für ca. 4sec nicht mehr „ticken“.

Die Heizung startet ca. 3s nach dem Neustart und bleibt für die Dauer der Störung an.

Steht die Störung, länger an als die „Reboot at Fail“ Zeit (Parameter RF), startet der Sensor erneut. Die Heizung startet wieder ca. 3s nach dem Neustart. Der Ablauf wiederholt sich, bis die Störung beseitigt ist. Ist für länger als die voreingestellte „Reboot at Fail“ Zeit keine Störung der Messstrecke vorhanden, geht der Sensor mit seiner Heizungssteuerung wieder in den Normalbetrieb.

Wichtig: Ist die Solltemperatur der Arme ca. 30°C erreicht, schaltet die Armheizung

**automatisch ab, um ein Überhitzen der Sensoren zu vermeiden.
Die PTC- Heizung wird in diesem Testbetrieb nicht eingeschaltet.**

**Die Heizungsmodi 2 und 6 sind nur für den Testbetrieb bez. zur
Werkskalibrierung vorgesehen! (siehe auch Befehl HT).**

HT0:

Die Heizung bleibt dauerhaft ausgeschaltet.

HT1:

Heizung softwaregesteuert über Virtuelltemperatur. (Sanftanlauf)

Einschalten Messarme:

Virtuelltemperatur $<$ Parameter HL [Kelvin], oder gestörte Messwertaufnahme.

Ausschalten Messarme:

Nach 10 Sekunden und Virtuelltemperatur $>$ Parameter HH [Kelvin] und
Einschaltkriterium nicht erfüllt.

Einschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Virtuelltemperatur $<$ Parameter HL [Kelvin], oder gestörte Messwertaufnahme.

Ausschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Wenn Virtuelltemperatur > Parameter HL [Kelvin] **und** das Einschaltkriterium nicht mehr erfüllt ist, bleibt die Ultraschallwandler-Heizung noch eine Stunde aktiv und schaltet dann ab.

HT2:

Sanftanlauf durch Rampe (125s), danach bleibt die Heizung dauerhaft eingeschaltet.

HT3:

Heizung softwaregesteuert. (Sanftanlauf)

Einschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur < 2°C oder PT1000 Temperatur < 5°C, oder gestörte Messwertaufnahme und PT1000 Temperatur < 25 °C

Ausschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur > 7°C und PT1000 Temperatur > 8°C und Einschaltkriterium nicht erfüllt.

Einschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Virtuell-Temperatur < 2°C oder PT1000 Temperatur < 5°C, oder gestörte Messwertaufnahme und PT1000 Temperatur < 10°C

Ausschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Wenn Virtuelle Temperatur > 2°C **und** PT1000 Temperatur > 5°C **und** Einschaltkriterium nicht mehr erfüllt ist bei PT1000 Temperatur <10°C, bleibt die Ultraschallwandler-Heizung noch eine Stunde aktiv und schaltet dann ab.

HT4:

Heizung softwaregesteuert. (Sanftanlauf)

Einschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur < 2°C oder PT1000 Temperatur < 5°C, oder Einschaltkriterium und PT1000 Temperatur < 25°C

Ausschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur > 7°C und PT1000 Temperatur > 8°C und Einschaltkriterium nicht erfüllt.

Einschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Virtuell-Temperatur < -25°C oder PT1000 Temperatur < -20°C, oder Einschaltkriterium und PT1000 Temperatur < 5°C

Ausschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Wenn Virtuelle Temperatur > -20°C **und** PT1000 Temperatur > -15°C **und** Einschaltkriterium nicht mehr erfüllt ist bei PT1000 Temperatur <5°C, bleibt die Ultraschallwandler-Heizung noch eine Stunde aktiv und schaltet dann ab.

HT5:

Heizung softwaregesteuert für den Betrieb mit Gehäuseheizung. (Sanftanlauf)

Einschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur < 2°C oder PT1000 Temperatur < 5°C, oder Einschaltkriterium und PT1000 Temperatur < 15°C

Ausschalten Heizung Messarme:

Virtuell-Temperatur > 7°C und PT1000 Temperatur > 15°C und Einschaltkriterium nicht erfüllt.

Einschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Virtuell-Temperatur < -25°C oder PT1000 Temperatur < -20°C, oder Einschaltkriterium und PT1000 Temperatur < 15°C

Ausschalten Ultraschallwandler-Heizung:

Wenn Virtuelle Temperatur > -20°C **und** PT1000 Temperatur > -5°C **und** Einschaltkriterium nicht mehr erfüllt ist bei PT1000 Temperatur <15°C, bleibt die Ultraschallwandler-Heizung noch eine Stunde aktiv und schaltet dann ab.

HT6:

Die Heizung wird sofort dauerhaft, aber nicht getaktet, eingeschaltet. (wie HT 2, ohne Sanftanlauf).

Die Heizung wird nur eingeschaltet, wenn zusätzlich zu den oben genannten Kriterien, die Versorgungsspannung über dem Wert liegt, der durch den Parameter „HC“ angegeben wird. Der Parameter HC legt den Schwellwert der Versorgungsspannung fest ab der die Heizung aktiviert wird.

Mit dem „Befehl PW“ kann die Versorgungsspannung abgefragt werden. Zusätzlich kann sie im anwenderspezifischen Telegramm ausgegeben werden. Unterstützt die vorliegende Hardware die Überwachung der Versorgungsspannung nicht, wird bei Eingabe des Befehls (ID) PW die Meldung „Heating ctrl not supported“ ausgegeben.

Die Messung der Betriebsspannung erfolgt nach Gleichrichtung über einen Tiefpass mit Hilfe eines Analog-Digital-Converters. Auf Grund des zu hohen Aufwandes wurde auf eine echte Effektivwertmessung verzichtet. Dadurch werden die Messwerte über „Befehl PW“ bei DC-Versorgung zwar genau gemessen, liegen jedoch bei AC-Versorgung zwischen Effektiv- und Spitzenwert, werden also zu hoch gemessen.

Zur Einstellung der Schaltschwelle zwischen Versorgung im geheizten Normalbetrieb und unbeheizten Back-Up-Betrieb wird folgendes Vorgehen empfohlen:

1. Auslesen des Messwertes von Parameter „PW“ bei Versorgung des Gerätes für den Normalbetrieb möglichst bei eingeschalteter Heizung (Berücksichtigung des Spannungsabfalls an Versorgung und Kabel bei eingeschalteter Heizung unter Voll-Last, siehe **Befehl HT**).
2. Auslesen des Wertes bei Versorgung des Gerätes im Back-Up-Betrieb bei ausgeschalteter Heizung.
3. Einstellen der Schaltschwelle mit „Befehl HC“ auf Mittelwert zwischen den gemessenen Werten, siehe **Befehl HC**.

Geräteausführung mit zusätzlicher Ultraschallwandler-Beheizung (4.386x.3x.xxx)

Für besonders vereisungsgefährdete Standorte wird eine Geräteausführung mit elektrisch beheizten Ultraschallwandlern angeboten. Durch diese zusätzliche Beheizung wird selbst unter schweren Vereisungsbedingungen ein Messbetrieb ermöglicht.

7.7 Ausgeben aller Systemparameter

Die meisten Parameter des ULTRASONIC werden intern in einem EEPROM gespeichert. Über den Befehl SS können alle gespeicherten Parameter ausgegeben werden.

Es wird empfohlen vor dem Ändern von Parametern eine Sicherungskopie der bestehenden Einstellungen vorzunehmen und in einer Textdatei zu speichern, siehe auch **Befehl SS**.

7.8 Abfrage der Softwareversion

Die Softwareversion wird über den Befehl SV abgefragt. Zu weiteren Informationen siehe **Befehl SV**.

7.9 Betriebsstundenzähler

Das Gerät stellt einen Betriebsstundenzähler zur Verfügung, der über den Parameter OH (Operating Hours) abgefragt werden kann. Er gibt die Betriebsstunden in Stunden zurück, siehe auch **Befehl OH**. Der Betriebsstundenzähler läuft nach 11,4 Jahren über und beginnt mit 0.

7.10 Speichern von Systemereignissen

Das Gerät verfügt intern über einen Ringspeicher, der wichtige Systeminformationen speichert. Mit dem Parameter SM (System event mask) wird festgelegt welche Ereignisse im Systemereignisspeicher abgelegt werden. Folgende Ereignisse stehen zur Verfügung:

1. Systemstart (Wertigkeit 1).
2. Aufschließen im Konfigurationsmodus (Wertigkeit 2).
3. Beschreiben interner Register PR und PT (Wertigkeit 4).
4. Keine gültigen Daten über einen längeren Zeitraum (Wertigkeit 8).
5. Mittelungspufferfüllstand kleiner 2 Inkremente (Basis ist Wert aus erweitertem Status) (Wertigkeit 16).

Sollen z.B. die Ereignisse ‚Systemstart‘ und ‚Beschreiben interner Register PR und PT‘ gespeichert werden, so ist der Wert für SM auf 5 zu setzen, siehe auch **Befehl SM**.

Die Werte werden im Speicher zusammen mit dem Betriebsstundenzähler gespeichert. Die Ausgabe erfolgt im Klartext.

Mit der Abfrage 00SE gibt das System die gespeicherten Informationen aus.

Die Ausgabe startet mit dem Text

‚System events:‘

‚SM00005‘ //Ausgabe des aktuellen Parameter SM

und endet mit der Ausgabe

‚End‘

Zwischen den beiden Ausgaben werden die Statusmeldungen in chronologischer Reihenfolge ausgegeben.

Erklärung der Statusmeldungen:

Zu 1) Systemstart

Meldung wird bei jedem Neustart erzeugt

Zu 2) Aufschließen im Konfigurationsmodus

Wird das System in den Konfigurationsmodus gesetzt, wird dies gespeichert.

Zu 3) Beschreiben interner Register PR und PT

Werden 15 Sekunden keine gültigen Werte gemessen, werden die internen Register PR und PT neu beschrieben.

Zu 4) Keine gültigen Daten über einen längeren Zeitraum

Wird über einen Zeitraum, der durch den Parameter RF einstellbar ist, kein gültiger Messwert ermittelt, führt das System einen Neustart durch. Das ULTRASONIC schreibt vor dem Neustart eine entsprechende Meldung in den Puffer.

Zu 5) Ist der Füllstand des Mittelungspuffers im erweiterten Status < 2 Inkremente wird eine Meldung geschrieben. Es wird eine erneute Meldung geschrieben, wenn der Füllstand zwischenzeitlich > 2 Inkremente beträgt. Diese Meldung kann bei extremen Niederschlagsereignissen auftreten.

7.11 Bayern Hessen Modus

Das ULTRASONIC enthält in der Standardversion einen Befehlsinterpreter für das Bayern Hessen Telegramm. Für weitere Informationen ist hier auf die eigene Dokumentation verwiesen.

Der Befehlsinterpreter für die Bayern Hessen Variante wird mit dem Befehl 00CI00001 eingeschaltet, siehe auch **Befehl CI**.

Für die Kodierung des Betriebsstatus und Fehlerstatus siehe **Statusinformationen im Bayern Hessen – Format**.

Auch im Bayern Hessen Befehlsinterpreter stehen alle Befehle des ULTRASONIC zur Verfügung. Sie werden in den Befehl <CTR B>ST0...<CTRL C> eingebettet. So wird zum Beispiel durch den Befehl <CTR B>ST000KY00001<CTRL C> der Benutzerzugriff eingeschaltet und mit <CTR B>ST000AM00001<CTRL C> die Mittelungszeit geändert.

Weiterhin stehen im Bayern Hessen Modus verschiedene Kombinationen von Messgeräteadressen zur Verfügung, siehe **Befehl BH**.

7.12 Erzwingen eines Neustart

Mit dem Befehl RS wird ein Neustart des ULTRASONIC erzwungen. Die Befehle

```
00KY00001<cr>  
00RS00001 <cr>
```

starten den ULTRASONIC nach ca. 3sec neu, siehe auch **Befehl RS**.

7.13 Stromsparmmodus

Das ULTRASONIC besitzt selbst keinen Stromsparmmodus. Er kann aber so konfiguriert werden, dass er nur begrenzte Zeit mit Strom versorgt werden muss. Zur Optimierung können folgende Parameter verwendet werden:

Fastboot einschalten:

Mit dem Parameter 00FB00001 und FB00002 wird beim Starten vermieden, dass das ULTRASONIC zunächst den Bootloader startet und auf ein Programmupdate wartet, siehe auch **Befehl FB**.
Ein Wert von SM > 0 verzögert den Bootvorgang um ca. 200 ms, siehe **Befehl SM**.

Signal, wenn Mittelungspuffer voll ist:

Der Steckerpin ADIO kann so geschaltet werden, dass der PIN auf + 5 V gesetzt wird, wenn der Mittelungspuffer des ULTRASONIC einen Füllstand > 7/8 erreicht hat. Die kürzeste einstellbare Mittelungszeit ist dabei 600 ms, siehe auch **Befehl AC**, **Befehl AV**.
Das Signal kann dazu verwendet werden, den ULTRASONIC von der Versorgungsspannung zu trennen.

Heizung ausschalten:

Mit dem Befehl 00HT00000 wird die Heizung des ULTRASONIC komplett ausgeschaltet, siehe **Befehl HT**.

7.14 Bootloader

Beim Neustart des ULTRASONIC startet das Gerät zunächst einen Bootloader. Das Programm hat die Aufgabe, einen Programmupload zu starten. Hierzu muss auf einem angeschlossenen PC ein bestimmtes Programm gestartet sein, das die neue Firmware enthält. Nach der Identifizierung startet dann der Programmupload automatisch. Erkennt der Bootloader seine Gegenstelle nicht, wird die ULTRASONIC-Firmware gestartet. Der Bootloader kann übersprungen werden, wenn der Parameter „Fast Boot“ FB auf 00FB00001 oder FB00002 gesetzt wird (siehe **Befehl FB**).

Das Gerät verfügt intern über zwei verschiedene Bootloader:

- THIES spezifischer Bootloader (Busfähig).
- X-Modem CRC Bootloader (256 Byte pro Frame).

Ausgewählt werden die Bootloader über die Befehle FB00000 (THIES- Bootloader) bzw. FB00003 (X-Modem Bootloader).

Gestartet wird der Bootloader nach jedem Systemstart.

Zum X-Modem Upload muss der der Fastboot Parameter auf 3 eingestellt sein (00FB00003).

7.14.1 X-Modem Bootloader

Zum Upload von neuer Firmware über die serielle Schnittstelle wird das Protokoll XMODEM CRC mit einer Nutzdatenlänge 128 Byte pro Paket verwendet. Notwendig sind ein PC und ein Terminalprogramm mit einer entsprechenden Einstellmöglichkeit. Getestet und freigegeben ist der Bootloader mit Windows-Hyperterminal und ZOC (V4.11).

Bedienung:

Der Bootloader startet immer mit 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität und ein Stopbit (9600,8,N,1). Beim Start des Gerätes wird die Version, die verwendete ID und der eingestellte Duplex-Modus des ULTRASONIC ausgegeben. Zum Neustart des Gerätes ohne Abschaltung der Versorgung verwenden sie den Reset-Befehl „<id>RS00001“.

XModem Loader CRC

Version 3.04

Insert 00UP00001 to start bootloader

Um den Bootloader weiter zu parametrisieren, muss der Befehl <id>UP00001 zusammen mit der ID eingegeben werden, hier 00UP00001. Alternativ kann auch direkt der Befehl <id>UP00002 gesendet werden, um direkt mit dem Transfer zu starten. Zur Eingabe des Befehls hat der Anwender ca. 10 Sekunden Zeit. Wird innerhalb dieser Zeit kein gültiger Befehl oder <id>UP00000 eingegeben, startet die ULTRASONIC Firmware. Bei Eingabe von <id>UP00001 schaltet das ULTRASONIC in den Bootloader Modus, in dem weitere Angaben gemacht werden können.

Es erscheint folgende Ausgabe:

*use <id>BR000XX to set baudrate
use <id>ID000XX to set ID
use <id>DM0000X to set duplex mode
use <id>UP00000 to cancel upload
use <id>UP00002 to start upload*

- Die Befehlscodes sind immer mit Großbuchstaben einzugeben (im „normalen“ Betrieb werden auch Kleinbuchstaben akzeptiert).
- Mit BR kann die Baudrate verstellt werden. Es sind alle Baudraten gültig, die 8 Datenbits enthalten. Für weitere Parameter siehe Kapitel **Befehl BR**.
- Mit ID kann die Geräteadresse eingestellt werden. Gültige Werte liegen hier im Bereich $0 \leq ID \leq 99$.
- Mit DM wird der Duplex-Modus umgeschaltet. <id>DM00001 ist Vollduplex, <id>DM00000 ist Halbduplex.
- Mit dem Befehl <id>UP00002 wird der Programmtransfer gestartet.
- Mit <id>UP00000 wird das Transferprogramm abgebrochen und die Ultrasonic-Firmware gestartet.

Hinweis:

Alle Parameter, die hier geändert werden, sind nur für die Zeit des Bootloaders gültig. Sie ändern nicht die Werte im globalen Parameterspeicher.

Nach Eingabe des Befehls <id>UP00002 startet das ULTRASONIC den Datentransfer, indem es periodisch das Zeichen „C“ sendet. Der Anwender hat jetzt ca. 30 sec Zeit um das Transferprogramm des Terminals zu starten. Wird das Transferprogramm gestartet, beginnt der Dateitransfer mit gesicherter CRC-Prüfsumme. Fehlerhafte und verloren gegangene Datenpakete werden automatisch neu gesendet, so dass die empfangenen Daten fehlerfrei sind.

Erst wenn die Binärdaten komplett auf dem ULTRASONIC vorhanden sind, wird das neue Programm in den Programmspeicher geschrieben. Nach erfolgreicher Übertragung startet das neue Programm automatisch.

Wird die Übertragung abgebrochen, startet das ULTRASONIC nach entsprechender Timeoutzeit (20 s) automatisch die vorhandene Firmware.

7.15 Fastboot

Siehe **Stromsparmmodus**.

7.16 Plausibilität

Um fehlerhaft gemessene Werte zu erkennen, verfügt das ULTRASONIC über einen internen Plausibilitätstest, der Messwerte anhand der Historie beurteilt. Fehlerhafte Messwerte können zum Beispiel durch starken Regen oder Fremdkörper in der Messstrecke hervorgerufen werden.

Wird ein fehlerhafter Messwert erkannt, setzt das ULTRASONIC seine Messwertaufnahme auf die maximale Geschwindigkeit. In diesem Modus ist die Wahrscheinlichkeit höher in einer gestörten Umgebung (z.B. Regen) einen gültigen Messwert zu ermitteln. Es wird jetzt jede 4 ms ein kompletter Datensatz über alle 4 Sensoren ermittelt, so dass das ULTRASONIC 250 Messwerte pro Sekunde erzeugt.

Zur Einstellung der Plausibilitätstest siehe auch **Befehl MD**, **Befehl PC**.

7.17 Online-Hilfe

Für die Kurzbeschreibung von Befehlen enthält das ULTRASONIC eine Online-Hilfe, die Informationen zu einzelnen Befehlen ausgibt. Durch Eingabe des Befehls und einem ‚?‘ wird der Hilfetext für das Kommando zurückgegeben.

Wird der Befehl

00?? <cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

einggegeben, listet das ULTRASONIC alle Befehle mit der entsprechenden Hilfe auf.

Beispiel:

Es soll die Hilfe für die Einstellung der Baudrate aufgerufen werden, siehe **Befehl BR**.

Mit dem Kommando

00BR?<cr> <cr> steht für Carriage Return (Enter Taste)

gibt das ULTRASONIC folgende Antwort:

BR: Set / get Baudrate

0 -> reserved	10 -> 1200 7E1
1 -> reserved	11 -> 1200 7E1
2 -> 1200 8N1	12 -> 4800 7E1
3 -> 2400 8N1	13 -> 9600 7E1
4 -> 4800 8N1	14 -> 19200 7E1
5 -> 9600 8N1*	15 -> 38400 7E1
6 -> 19200 8N1	16 -> 57600 7E1
7 -> 38400 8N1	17 -> 115200 7E1
8 -> 57600 8N1	
9 -> 115200 8N1	

8 Kundenseitiges Konfigurieren des Ultrasonic-Anemometers

Die Einstellung des Ultrasonic Anemometers erfolgt vor Auslieferung an den Kunden im Werk. Das Beiblatt „*Werkseinstellung*“ beschreibt die Einstellung.

Es ist möglich, die werksseitige Einstellung des Ultrasonic Anemometers kundenseitig zu verändern bzw. auf neue Anforderungen anzupassen. Hierbei ist zu beachten, dass bei Änderung der Einstellung die von Werk vergebene Bestell- Nr. dann nicht mehr zur Identifizierung beitragen kann.

Das Anemometer 2D lässt sich über seine serielle Datenschnittstelle unter Verwendung von Befehlen konfigurieren.

siehe Kapitel:

- *Zugriffsmodus*
- *Befehlsliste*

Hierzu kann ein beliebiges Standard –Terminalprogramm wie z.B. „Procomm“, „Telix“ oder ein Windows Terminalprogramm (z.B. Hyper Terminal) verwendet werden.

Empfehlung:

Nach erfolgter Konfiguration bitte das Beiblatt „*Werkseinstellung*“ anpassen und im Wartungs- oder Reparaturfall mit an den Hersteller senden.

8.1 Speichern von Parameterdatensätzen

Das ULTRASONIC kann drei komplette Parameterdatensätze intern speichern. Mit dem Kommando SP und RP werden komplette Parametersätze abgespeichert bzw. aus dem Speicher gelesen und verwendet. Das Speichern von Parametersätzen findet z.B. Verwendung, wenn Tests mit verschiedenen Geräteeinstellungen (z.B. verschieden benutzerdefinierte Telegramme) durchgeführt werden sollen. Ist eine Konfiguration mit benutzerdefiniertem Telegramm erstellt, kann diese gespeichert und eine weitere Konfiguration erstellt werden. Auch diese kann gespeichert werden. Jetzt kann der Anwender durch Laden der entsprechenden Konfiguration aus den gespeicherten Konfigurationen auswählen.

Mit dem Befehl 00SP00001 werden z.B. alle Parameter in den Puffer ,1' gespeichert. Mit dem Befehl 00RP00001 werden alle Parameter gelesen und vom System verwendet. Nach dem Rücklesen der Daten aus dem Puffer mit dem Befehl RP wird automatisch ein Systemstart durchgeführt, siehe auch **Befehl RP**, **Befehl SP**.

Der Puffer mit dem Index ,0' enthält alle Werte der Auslieferung und kann nicht überschrieben werden.

8.2 Herstellen des Auslieferungszustandes

Der Parameterdatensatz in der Auslieferung wird im Parameterdatensatz ,0' gespeichert. Durch den Aufruf 00RP00000 wird das Gerät in den Zustand bei der Auslieferung gesetzt. Nach dem Lesen wird automatisch ein Systemstart durchgeführt.

8.3 Verwalten von Benutzerinformationen

Das Gerät stellt einen Datenpuffer von 32 Texten mit jeweils 32 Zeichen zur Verfügung, in dem beliebiger Text gespeichert werden kann. Mit dem Befehl UD wird dieser Puffer verwaltet. Das Format der Eingabe ist

00UDn,xxxx

mit

n: Index 1..32

xxxx: Text mit einer Maximallänge von 32 Zeichen

Speichern von Benutzerinformationen:

Der Befehl

00UD1,THIES ULTRASONIC

speichert den Text ,THIES ULTRASONIC' an Datenposition eins.

Die Abfrage

00UD1

liefert das Ergebnis

01: THIES ULTRASONIC

Bei der Abfrage wird immer die Datensatznummer mit ausgegeben um ein gezieltes Ändern zu ermöglichen.

Die Abfrage

00UD

gibt alle anwenderspezifischen Texte zurück, z.B.

01: THIES ULTRASONIC

03: Montiert in Göttingen

Löschen von Definitionen:

Datensätze müssen einzeln gelöscht werden. Hierzu wird die Datensatznummer, gefolgt von einem Komma benötigt. Die Eingabe von

00UD3,

löscht den Text an Position 3.

9 Befehlsliste

	Befehl	Beschreibung
Befehl AA	<id>AA<para5>	Funktionen für PIN WG/RXD - (Analog channel A)
Befehl AB	<id>AB<para5>	Funktionen für PIN WR/RXD + (Analog channel B)
Befehl AC	<id>AC<para5>	Funktionen für den PIN ADIO (Analog channel C)
Befehl AN	<id>AN<para5>	Analoger Ausgabe-Modus (Analog output)
Befehl AO	<id>AO<para5>	Skalierung der analogen Windrichtungsausgabe (Angle Output)
Befehl AR	<id>AR<para5>	Skalierung der analogen Windgeschwindigkeitsausgabe (Analog Range)
Befehl AS	<id>AS<para5>	Setzt die Analogausgänge auf einen festen Wert
Befehl AT	<id>AT<para5>	Testet die analogen Ein-Ausgänge
Befehl AU	<id>AU<para5>	Update der analogen Eingänge (Analog Update rate)
Befehl AV	<id>AV<para5>	Mittelungszeitraum (Averaging time)
Befehl AY	<id>AY<para5>	Skalierung des Minimalwertes für analogen Eingang PIN WG/RXD-
Befehl AZ	<id>AZ<para5>	Skalierung des Maximalwertes für analogen Eingang PIN WG/RXD-
Befehl BH	<id>BH<para5>	Wählt die Bayern Hessen Messgeräteadressen
Befehl BL	<id>BL<para5>	Gibt die Version des Bootloaders zurück (Boot Loader version)
Befehl BP	<id>BP<para5>	Zeit für Pretrigger im Burst-Modus (Burst Pretrigger)
Befehl BS	<id>BS<para5>	Buffertiefe im Burst-Modus (Burst Store)
Befehl BR	<id>BR<para5>	Wählen der Baudrate (Baud Rate)
Befehl BT	<id>BT<para5>	Busabschlusswiderstand
Befehl BX	<id>BX<para5>	Wählen der Baudrate (Baud rate Extension)
Befehl BY	<id>BY<para5>	Skalierung des Minimalwertes für analogen Eingang PIN WG/RXD+
Befehl BZ	<id>BZ<para5>	Skalierung des Maximalwertes für analogen Eingang PIN WG/RXD+
Befehl CA	<id>CA<para5>	Abgleichwert für die Analogen Ausgänge in 0.1 Promille (Steigung)
Befehl CB	<id>CB<para5>	Abgleichwert für die Analogen Ausgänge (Offsetkorrektur)
Befehl CI	<id>CI<para5>	Wählt den Kommandointerpreter (Command Interpreter)
Befehl CY	<id>CY<para5>	Skalierung des Minimalwertes für analogen Eingang PIN ADIO
Befehl CZ	<id>CZ<para5>	Skalierung des Maximalwertes für analogen Eingang PIN ADIO
Befehl DA	<id>DA<para5>	Datenanforderung im Bayern Hessen Befehlsinterpreter
Befehl DE	<id>DE<para5>	Standardabweichung (standard Deviation)
Befehl DF	<id>DF<para5>	Setze Initialwerte (Default values)
Befehl DM	<id>DM<para5>	Duplex Modus der seriellen Schnittstelle (Duplex Mode)
Befehl DV	<id>DV<para5>	Geräteversion, Datum- Zeitinformationen der Firmware
Befehl DY	<id>DY<para5>	Effektive akustische Messstreckenlänge der Y-Strecke (nominal 20000)
Befehl EI	<id>EI<para5>	Analogwertausgabe max. / min. im Fehlerfall (Error Inversion)
Befehl FB	<id>FB<para5>	Geräteneustart mit / ohne Möglichkeit zum Firmwareupdate (Fast Boot)
Befehl GU	<id>GU<para5>	Maximalwert der WG und deren WR im Mittelungszeitraum, Böe (Gust)
Befehl HC	<id>HC<para5>	Schwellwert der Versorgungsspannung zur Einschalt-Unterdrückung der Heizung (Heating Control)
Befehl HL	<id>HL<para5>	Untere Schwelltemperatur zum Schalten der Heizung in Kelvin
Befehl HH	<id>HH<para5>	Obere Schwelltemperatur zum Schalten der Heizung in Kelvin
Befehl HT	<id>HT<para5>	Heizungssteuerung (Heating control)
Befehl ID	<id>ID<para5>	Geräte-Kennung (ID)

	Befehl	Beschreibung
Befehl IT	<id>IT<para5>	Gehäuseinnentemperatur
Befehl KY	<id>KY<para5>	Zugriffsschüssel (Key)
Befehl MA	<id>MA>>para5>	Automatische Anpassung der Messwertaufnahme (Measurement Automation)
Befehl MD	<id>MD>>para5>	Intervall der Messwertaufnahme der Laufzeiten (Measurement Delay)
Befehl OH	<id>OH<para5>	Abfrage des Betriebsstundenzählers (Operational Hours)
Befehl OR	<id>OR<para5>	Telegramm Ausgabeintervall (Output Ratio)
Befehl OS	<id>OS<para5>	Skalierung der Windgeschwindigkeitsausgabe (Output Scale)
Befehl PC	<id>PC<para5>	Plausibilitätstest (Plausibility Check)
Befehl PR	<id>PR<para5>	Periodendauer Empfänger (Periodic time of Receiver)
Befehl PT	<id>PT<para5>	Periodendauer Sender (Periodic time of Transmitter)
Befehl PW	<id>PW<para5>	Ausgabe der gemessenen Versorgungsspannung (Power)
Befehl RC	<id>RC<para5>	Steilheitskalibrierung des A/D-Wandlers
Befehl RD	<id>RD<para5>	Antwortverzögerung auf Telegrammanfrage (Response delay)
Befehl RF	<id>RF<para5>	Neustart bei ungültigen Messwerten (Restart at Fail)
Befehl RP	<id>RP<para5>	Lese Parameterdatensatz (Read Parameters)
Befehl RS	<id>RS<para5>	Neustart ULTRASONIC (Reset)
Befehl SC	<id>SC<para5>	Startwert der Kennlinie der Analogausgänge, 4...20mA (Start Current)
Befehl SE	<id>SE<para5>	Ausgabe der gespeicherten Vorfälle im System (System Events)
Befehl SH	<id>SH<para5>	Seriennummer (High Word) (Serial number high word)
Befehl SL	<id>SL<para5>	Seriennummer (Low Word) (Serial number low word)
Befehl SM	<id>SM<para5>	Systemereignismaske (System event Mask)
Befehl SP	<id>SP<para5>	Speichere Parameterdatensatz (Store Parameters)
Befehl SS	<id>SS<para5>	System-Status (System Status)
Befehl SV	<id>SV<para5>	Software Version (Software Version)
Befehl TB	<id>TB<para5>	Legt das Datentelegramm fest, das nach Burstmessung die Daten ausgibt
Befehl TF	<id>TF<para5>	Transformator zur Erzeugung der Schallsignale
Befehl TN	<id>TN<para5>	Laufzeitverzögerung Nord Sensor (Sensor delay NORTH Sensor)
Befehl TR	<id>TR<para5>	Telegrammabfrage (Transmit request)
Befehl TT	<id>TT<para5>	Selbständige Telegrammausgabe (Transmit telegram)
Befehl TS	<id>TS<para5>	Laufzeitverzögerung Süd Sensor (Sensor delay SOUTH Sensor)
Befehl UA	<id>UA<para5>	Definitionen anwenderspezifisches Telegramm (User Added telegram)
Befehl UD	<id>UD<para5>	Benutzerdefinierte Zeichen (User data)
Befehl UR	<id>UR<para5>	Entfernen im anwenderspezifischem Telegramm (Remove User telegram)
Befehl US	<id>US<para5>	Speichern anwenderspezifische Telegrammdefinition (User telegram save)
Befehl UT	<id>UT<para5>	Anwenderspezifisches Telegramm (User telegram)
Befehl VC	<id>VC<para5>	Konstante Geschwindigkeitskorrektur (Velocity Correction)
Befehl XI	<id>XI<para5>	Externe ID (External ID)

10 Befehle und Beschreibung

Befehl AA

T <id>AA<para5> Funktionen für PIN 1
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Setzt den Modus für PIN 1. Werte für diesen Parameter können nur geändert werden, wenn das ULTRASONIC in der Betriebsart Halbduplex läuft (siehe **Befehl DM**).
 Für die Signalleitung PIN 1 können folgende Funktionen festgelegt werden:

Parameterbeschreibung:

- 0: Analoges Eingangssignal wird nicht benutzt. Vollduplex Betrieb ist möglich (siehe **Befehl DM**).
- 1: PIN 1 wird als analoger Eingang benutzt. Der analoge Spannungswert an PIN 1 wird zyklisch vom System eingelesen und digital gewandelt. Der analoge Ausgabewert für WG wird abgeschaltet (siehe **Befehl AN**).
 Bei einer maximalen Eingangsspannung von 10,0V beträgt der ausgegebene Digitalwert 65536 (16bit) bei einer Auflösung von 152ppm.
 Voraussetzung für den Modus ist der Halbduplex Betrieb (siehe **Befehl DM**).
- 2: Selbsttest der analogen Windgeschwindigkeitsausgabe
 In diesem Zustand wird das analoge Ausgangssignal der Windgeschwindigkeit über das analoge Eingangssignal zurückgelesen. Voraussetzung ist, dass der analoge Windgeschwindigkeitsausgang als Spannungsausgang geschaltet ist. (siehe **Befehl AN**)
 PIN 1 darf nicht extern beschaltet sein. Analoge Werte werden vom ULTRASONIC ausgegeben und wieder eingelesen.
 Über das benutzerdefinierte Telegramm kann der eingelesene digitale Wert ausgegeben werden (siehe **Anwenderspezifisches Telegramm**).
 Voraussetzung für den Modus ist der Halbduplex Betrieb (siehe **Befehl DM**).
- 3: Analoge Ausgabe der Windgeschwindigkeit im Azimut. Wird ausgegeben, wenn AN != 2, siehe **Befehl AN**.
- 4: Eingang wird als SONIC ID verwendet (Bit 0). Ist der Modus gewählt, in dem das ULTRASONIC seine ID über die externen Leitungen erhalten soll, muss dieser PIN wie folgt konfiguriert werden: 00AA00004. (siehe auch **Befehl XI**).

Für die Verwendung von AA, AB und teilweise AC darf der Parameter AN nicht auf 2 gesetzt sein! Siehe auch Befehl AN.

Wertebereich: 0...4
 Initialwert: 0

Befehl AB

T <id>AB<para5> Funktionen für PIN 4
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Setzt den Modus für PIN 4. Werte für diesen Parameter können nur geändert werden, wenn das ULTRASONIC in der Betriebsart Halbduplex läuft (siehe **Befehl DM**).
 Für die Signalleitung PIN 4 können folgende Funktionen festgelegt werden:

Parameterbeschreibung:

- 0: Signal wird nicht benutzt. Vollduplex Betrieb ist möglich (siehe **Befehl DM**).
- 1: PIN 4 wird als analoger Eingang benutzt. Der analoge Spannungswert an PIN 4 wird zyklisch vom System eingelesen und digital gewandelt. Der analoge Ausgabewert für WR wird abgeschaltet (siehe **Befehl AN**).
 Voraussetzung für den Modus ist der Halbduplex Betrieb (siehe **Befehl DM**).
 Bei einer maximalen Eingangsspannung von 10,0V beträgt der ausgegebene Digitalwert 65536 (16bit) bei einer Auflösung von 152ppm.
- 2: Selbsttest der analogen Windrichtungsausgabe
 In diesem Zustand wird das analoge Ausgangssignal der Windrichtung über das analoge Eingangssignal zurückgelesen. Voraussetzung ist, dass der analoge Windrichtungsausgang als Spannungsausgang geschaltet ist (siehe **Befehl AN**).
 PIN 4 darf nicht extern beschaltet sein. Analoge Werte werden vom ULTRASONIC ausgegeben und wieder eingelesen.
 Über das benutzerdefinierte Telegramm kann der eingelesene digitale Wert ausgegeben werden (siehe **Anwenderspezifisches Telegramm**).
 Voraussetzung für den Modus ist der Halbduplex Betrieb (siehe **Befehl DM**).
- 3: Analoge Ausgabe der Windrichtung im Azimut. Wird ausgegeben, wenn AN != 2, siehe **Befehl AN**.
- 4: Eingang wird als SONIC ID verwendet (Bit 1). Ist der Modus gewählt, in dem das ULTRASONIC seine ID über die externen Leitungen erhalten soll, muß dieser PIN wie folgt konfiguriert werden: 00AB00004. (siehe auch **Befehl XI**).

Für die Verwendung von AA, AB und AC darf der Parameter AN nicht auf 2 gesetzt sein! Siehe auch Befehl AN.

Wertebereich: 0... 4
 Initialwert: 0

Befehl AC

T <id>AC<para5> Funktionen für PIN 3 (ADIO)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Setzt den Modus für den PIN 3 (ADIO). Er kann wahlweise als analoger Eingang, digitaler Eingang oder als analoger Ausgang, digitaler Ausgang geschaltet werden. Die Funktionen von PIN 3 (ADIO) sind unabhängig vom gewählten Duplex-Modus.

Parameterbeschreibung:

- 0: Signal wird nicht benutzt.
- 1: PIN wird als analoger Eingang benutzt. Der analoge Spannungswert wird zyklisch vom System eingelesen. Eingangswiderstand 200kΩ. Bei einer maximalen Eingangsspannung von 10,0V beträgt der ausgegebene Digitalwert 65535 bei einer Auflösung von 16 Bit oder ca. 15ppm.
- 2: reserviert
- 3: Analoge Ausgabe der akustischen Virtuelltemperatur. Wird ausgegeben, wenn AN != 2, siehe **Befehl AN**. Der Analogausgang ist fest im Bereich von – 40°C bis + 80°C skaliert.
- 4: Eingang wird als SONIC ID verwendet (Bit 2). Ist der Modus gewählt, in dem der ULTRASONIC seine ID über die externen Leitungen erhalten soll, muß dieser PIN wie folgt konfiguriert werden: 00AC00004. (siehe auch **Befehl XI**). Eingangswiderstand 200kΩ.
- 5: PIN wird als digitaler Ausgang geschaltet. Der Ausgang wird auf +5V gesetzt, wenn der Mittelungspuffer das erste Mal nach dem Start über 80% gefüllt ist. Die Funktion kann dazu benutzt werden, wenn der ULTRASONIC derart betrieben werden soll, dass er nach einer vollständigen Messung von der Versorgungsspannung getrennt werden soll, siehe auch **Stromsparmmodus**.
- 6: PIN 3 (ADIO) wird als digitaler Ausgang geschaltet. Der Ausgang wird auf 0 V gesetzt.
- 7: PIN 3 (ADIO) wird als digitaler Ausgang geschaltet. Der Ausgang wird auf +5 V gesetzt.
- 8: PIN 3 (ADIO) wird zur Heizungssteuerung verwendet. Ein Pegel von < 2V schaltet die Heizung aus, ein Pegel von > 2 V aktiviert die parametrisierte Heizungssteuerung, siehe Kapitel 7.6. Eingangswiderstand 200kΩ.
- 9: PIN 3 (ADIO) wird zur Heizungssteuerung verwendet. Ein Pegel von >2V schaltet die Heizung aus, ein Pegel von < 2V aktiviert die parametrisierte Heizungssteuerung, siehe Kapitel 7.6. Eingangswiderstand 200kΩ.
- 10: Wie 8) mit zusätzlichem 10 k Pull-up Widerstand an PIN3 (ADIO)
- 11: Wie 9) mit zusätzlichem 10 k Pull-down Widerstand an PIN3 (ADIO)
- 12: Wie 8) mit zusätzlichem 10 k Pull-down Widerstand an PIN3 (ADIO)
- 13: Wie 9) mit zusätzlichem 10 k Pull-up Widerstand an PIN3 (ADIO)
- 14: Triggert eine einzelne Messung auf steigende Flanke, wenn PIN3 (ADIO) auf + 5V gesetzt wird. Dieser Modus kann zur synchronen Messwertaufnahme verwendet werden. Benötigte Impulslänge > 1µsec. Eingangswiderstand 10kΩ pull down.
- 15: Startet die kontinuierliche Messung auf steigende Flanke, wenn PIN3 (ADIO) auf + 5V gesetzt wird. Benötigte Impulslänge > 1µsec. Die laufende Messung kann durch Befehlseingabe AC15 wieder gestoppt werden. Eingangswiderstand 10kΩ pull down.

- 16: Startet die Messung im Burst-Modus, wenn PIN 3 (ADIO) auf +5V gesetzt wird. Benötigte Impulslänge > 1µsec. Ist PIN 3 (ADIO) offen, wird keine Messung gestartet (Interner Pull-down Widerstand eingeschaltet). Ist PIN3 (ADIO) fest auf +5V, wird Burstmode automatisch gestartet, wenn vorherige Messung beendet wurde. Eingangswiderstand 10 kΩ pull down.
- 17: Startet die Messung im Burst-Modus, wenn PIN 3 (ADIO) auf AGND gezogen wird. Ist PIN 3 (ADIO) offen, wird keine Messung gestartet. (Interner Pull-up Widerstand eingeschaltet) Ist PIN 3 (ADIO) fest auf AGND, wird Burstmode automatisch gestartet, wenn vorherige Messung beendet wurde. Eingangswiderstand 10kΩ pull up.
- 18: Für Windrichtungen < 170° gibt der ADIO-Pin 5V aus, für Windrichtungen > = 170° 0V.
- 19: PIN 3 (ADIO) gibt den internen Status der Heizung aus. Ein Pegel von 0V bedeutet Heizung aus, ein Pegel von 5V bedeutet Heizung ein.
- 20: PIN 3 (ADIO) gibt den internen Status der Heizung aus. Ein Pegel von 0V bedeutet Heizung ein, ein Pegel von 5V bedeutet Heizung aus. Parameter wird benutzt, wenn Gerät mit Gehäuseheizung versehen ist. Der „high“ Pegel an ADIO deaktiviert die Gehäuse-Heizung.

Wertebereich: 0... 20
Initialwert: 0

Befehl AN

T <id>AN<para5> Analoger Ausgabe-Modus (Analog output)
Zugriff Benutzermodus
Beschreibung: Setzt den Modus für die Ausgabe der anlogen Windrichtung (WR) und Windgeschwindigkeit (WG). Mit diesem Befehl kann zwischen Stromausgang und Spannungsausgang umgeschaltet werden. Eine Änderung des Wertes bezieht sich immer auf beide Ausgänge (WR und WG) gleichzeitig. Der Ausgangswertebereich kann mit dem **Befehl SC** eingestellt werden. Er ist entweder 0...20mA (0...10V) oder 4..20mA (2...10V), siehe **Befehl SC**. Der Befehl kann nur geändert werden, wenn der Betriebsmodus Halbduplex gewählt ist, siehe **Befehl DM**.

Parameterbeschreibung:

- 0: Spannungsausgang
1: Stromausgang
2: Analoge Ausgänge werden nicht benutzt. Die Interne Berechnung und Ausgabe der Analogwerte wird komplett abgeschaltet, wenn AN=2 gesetzt wird und AA=AB=AC=0 ist.

Wertebereich: 0...2
Initialwert: 0

Befehl AO

T <id>AO<para5> Skalierung der analogen Windrichtungsausgabe (Angle output)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Bei der analogen Ausgabe der Windrichtung kann die Skalierung gewählt werden, in der der Winkel ausgegeben wird. Um zu bestehenden Anlagen kompatibel zu bleiben, ist es teilweise notwendig, einen erweiterten Winkelbereich auszuwählen. Siehe auch **Befehl AN**, **Befehl DM**, **Befehl SC**.

Parameterbeschreibung:

0: Ausgabe des Winkels im Bereich 0...360° (0° ist Norden)
 1: reserviert
 2: reserviert
 3: Ausgabe von WR und WG
 Bei 0m/s Windgeschwindigkeit wird genau die Hälfte des analogen Wertes ausgegeben (5V;10mA bzw. 6V; 12mA).

Für einen Stromausgang 0..20mA gilt:
 0..10mA = 20..0m/s (aus Richtung Norden)
 10..20mA = 0..20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Stromausgang 4..20mA gilt:
 4..12mA = 20..0m/s (aus Richtung Norden)
 12..20mA = 0..20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Spannungsausgang 0..10V gilt:
 0..5V = 20..0m/s (aus Richtung Norden)
 5..10V = 0..20m/s (aus Richtung Süden)

Für einen Spannungsausgang 2..10V gilt:
 2..6V = 20..0m/s (aus Richtung Norden)
 6..10V = 0..20m/s (aus Richtung Süden)

Wertebereich: 0...3
 Initialwert: 3

Befehl AR

<id>AR<para5> Skalierung der analogen Windgeschwindigkeitsausgabe (Analog Range)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Legt den Bereich fest, über den die analoge Windgeschwindigkeitsausgabe skaliert wird. Der Standard ULTRASONIC skaliert die Windgeschwindigkeit wie folgt:
 0...10V (2...10V) entsprechen 0...60m/s.
 Es kann aber auch sinnvoll sein, die Windgeschwindigkeit von 0...30m/s zu skalieren:
 0...10V (2...10V) entsprechen 0...30m/s.
 Mit diesem Parameter wird das Messbereichsende festgelegt. Die Angabe erfolgt in m/s.

Parameterbeschreibung:

0...100: Legt das Messbereichsende der Windgeschwindigkeit (WG) fest.

Wird z.B. das Kommando AR00045 eingegeben, so entsprechen 10V bzw. 20mA einer Windgeschwindigkeit von 45m/s.

Wertebereich: 1... 100
Initialwert: 20

Befehl AS

<id>AS<para5> Setzt die Analogausgänge auf einen festen Wert
Zugriff: Benutzermodus

Beschreibung: Setzt die analogen Ausgänge auf einen festen Wert. Der Wert ist wird in Inkremente für den internen AD-Wandler angegeben. Der Wert ,0' für AS deaktiviert die Funktion. Funktion wird für den Geräteabgleich genutzt.

Wertebereich: 0...65535
Initialwert: 0

Befehl AT

<id>AT<para5> Testet die analogen Ein-Ausgänge.
Zugriff: Benutzermodus

Beschreibung: Legt auf die Ausgänge auf verschiedene Spannungen und liest diese wieder ein. Funktioniert nur im Halbduplex-Modus. Die analogen Ein/ Ausgänge dürfen nicht beschaltet sein.

Wertebereich: 0...65535
Initialwert: 0

Befehl AU

<id>AU<para5> Update-Rate der analogen Ein-/Ausgänge (Analog Update)
Zugriff: Benutzermodus

Beschreibung: Mit Hilfe dieses Kommandos wird das Zeitintervall festgelegt, in dem die angewählten analogen Eingänge abgetastet und die Ausgänge geschrieben werden. Der Parameter legt das Intervall zwischen den kompletten Aktualisierungsintervallen in ms fest.

Pro Analog-Mess-Kanal werden ca. 2.5ms Wandlungszeit benötigt. In der Konfiguration der Analogeingänge kann jeder der drei PINs, PIN 1, PIN 4, PIN 3 (ADIO) einzeln als analoger Eingang definiert werden.

Die Zeit für ein Aktualisierungsintervall ist die Summe der A/D-Wandlungen der einzelnen Mess-Kanäle, bei 3 Kanälen also 7,5msec.

Bei der Verwendung der analogen Datenausgabe (siehe **Befehl AN**) werden die Kanäle PIN 1, PIN 4 gleichzeitig verwendet und benötigen ca. 5ms Wandlungszeit.

Beispiel:

PIN 3 (ADIO) wird als analoger Eingang geschaltet.

Das Abtastintervall beträgt (bei AU00050) 50ms. Das ULTRASONIC ist nach ca. 3ms mit der Wandlung fertig, wenn kein anderer analoger Kanal eingeschaltet ist.

Wird das Abtastintervall kürzer eingestellt als das Aktualisierungsintervall dauert, dominiert die tatsächliche Dauer des Aktualisierungsintervalls und der eingestellte Wert für das Abtastintervall hat keinen Einfluss.

Wird der Parameter AU auf 0 gesetzt, werden die analogen Ein/Ausgänge nicht abgetastet bzw. aktualisiert.

Wertebereich: 1...256
Initialwert: 50

Befehl AV

<id>AV<para5> Mittelungszeitraum (Average)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Mit Hilfe dieses Kommandos wird der Zeitraum festgelegt, über die das ULTRASONIC seine Messwerte mittelt. Aufgrund der hohen Messgeschwindigkeit von bis zu 2 ms zum Erzeugen eines Messwertes, ist die Verwendung einer Mittelung in den meisten Fällen sinnvoll.
 Parameterbeschreibung:

Parameter für AV	Eingestellte Mittelungszeit
0	Der Parameter OR gibt das Mittelungsintervall in ms an
1	Mittelung über 1s
2	Mittelung über 10s
3	Mittelung über 60s
4	Mittelung über 120s
5	Mittelung über 10min
6 ... 60000	Mittelung über n* 100ms, z.B. 00AV00025 bedeutet eine Mitteilung über 2,5s

Tabelle 7: Einstellen der Mittelungszeiträume mit Parameter AV

Die Mittelwertspeicher sind als gleitender Speicher ausgelegt. Bei jeder Messung erhält der Messwert einen Zeitstempel. Der Mittelwertpuffer ist immer so groß, dass nur Daten über den Mittelungszeitraum im Speicher vorhanden sind. Beim Starten sind die Daten des Mittelungsspeichers sofort gültig. Es wird sofort über die vorhandenen Messwerte gemittelt.

Bei einem gewählten Mittelungszeitraum von AV0, berechnet sich der Mittelungszeitraum aus dem gewählten Ausgabeintervall OR (siehe Befehl OR).

Wertebereich: 0...60000
 Initialwert: 10

Befehl AY

<id>AY<para5> Skaliert den Ausgabewert des minimalen Messwertes für den analogen Eingang PIN WG/RXD- (Analog channel A)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl AY wird der Ausgabewert für 0V Eingangsspannung definiert. Der Wert für den Parameter AY berechnet sich wie folgt:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (\text{Skalierter Ausgabesollwert} * 10)$$

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl AZ**.

Befehl AZ

<id>AZ<para5> Skaliert den Ausgabewert des maximalen Messwertes des analogen Eingang PIN WG/RXD- (Analog channel A)

Zugriff: Benutzermodus

Beschreibung: Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl AZ wird der Ausgabewert für 10,0V Eingangsspannung definiert.
Der Wert für den Parameter AZ berechnet sich wie folgt:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (\text{Skalierter Ausgabesollwert} * 10)$$

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl AY**.

Befehl BH

<id>BH<para5> Wählt die Bayern Hessen Messgeräteadressen (Bayern-Hessen Geräteadresse)

Zugriff: Benutzermodus

Beschreibung: Das ULTRASONIC enthält mehrere Befehlsinterpreter. Im Standard Modus ist der THIES- Befehlsinterpreter aktiv. Mit dem **Befehl CI** kann der Befehlsinterpreter gewechselt werden. Ist der Bayern - Hessen Interpreter gewählt, so werden die Messwerte für Windrichtung, Windgeschwindigkeit und Virtuelltemperatur unter verschiedenen Messgeräteadressen abgefragt. Welche Messgeräteadressen aktiv sind, wird mittels dem Befehl BH festgelegt. Es stehen folgende Kombinationen zur Auswahl:

Parameterbeschreibung:

Parameter	Geräteadressen		
	WG	WR	VT
0	011	001	022
1	400	410	420
2	202	201	211
3	011	001	021
4	081	082	083
5	001	002	003
6	008	009	010

Tabelle 8: Messgeräteadressen im Bayern Hessen Befehlsinterpreter

Siehe auch **Befehl CI, Bayern Hessen Modus**.

Befehl BL

<id>BL<para5> Gibt die Software Version des Bootloaders zurück (Boot-Loader Version)

Zugriff: Abfragemodus

Beschreibung: Bei Abfrage des Parameters wird die Softwareversion des Bootloaders zurückgegeben.
Zur Interpretation muss die ausgegebene Version durch 100 dividiert werden. Ein ausgegebener Wert 00BLV00300 repräsentiert die Version V3.00. Die ‚3‘ bedeutet die Hauptversion, die 00 ist das Build – Label.

Befehl BP

<id>BP<para5> Legt den Pretrigger im Burst-Modus fest (Burst Pretrigger)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Gibt im Burst-Modus die Zeit (ms) der Datenaufzeichnung vor dem eigentlichen Triggerereignis an.
 Wertebereich: 00000...65535
 Initialwert: 100ms

Befehl BR

<id>BR<para5> Wählen der Baudrate (Baud Rate)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Die ULTRASONIC Kommunikation kann mit bei verschiedenen Baudraten erfolgen. Der Einstellbereich reicht von 1200 Baud bis 921 Kbaud. Mit den Befehlen BR und BX kann die Baudrate gewählt werden. Mit dem Befehl BR wird die Baudrate im Bereich von 1200 Baud bis 115200 Baud festgelegt. Der Befehl BX legt die Baudrate von 230400 Baud bis 921600 Baud fest. Für BR sind folgende Baudraten definiert:

Parameterbeschreibung:

	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115.2K
8N1	2	3	4	5 *	6	7	8	9
7E1	10	11	12	13	14	15	16	17
7O1	18	19	20	21	22	23	24	25
8N2	26	27	28	29	30	31	32	33
7E2	34	35	36	37	38	39	40	41
7O2	42	43	44	45	46	47	48	49

Tabelle 9: Liste der Baudrate mit Telegramm BR

Bei der Abfrage der Baudrate mit dem Befehl BR gibt das ULTRASONIC die letzte programmierte Baudrate zurück, die entweder mit dem Befehl BR oder BX eingestellt wurde.

Wertebereich: 2...49
 Initialwert: 5

Befehl BS

<id>BS<para5> Setzt Puffergröße im Burst-Modus
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Wenn der Burstmode aktiviert ist, kann mit diesem Parameter die Puffergröße eingestellt werden. Die maximale Puffergröße beträgt 40000 komplette Messzyklen. Der Burstmode wird durch das Kommando 00AC00016, bzw. 00AC00017 aktiviert, siehe **Befehl AC**.
 Wertebereich: 1...40000
 Initialwert: 1000

Befehl BT

<id>BT<para5> Setzte Busabschlusswiderstand
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Schaltet einen 100R Widerstand zwischen die Leitungen TXD+ und TXD- wenn BT00001 gesetzt ist. Wenn BT00000, dann ist Widerstand ausgeschaltet.
 Wertebereich: 0...1
 Initialwert: 0

Befehl BX

<id>BX<para5> Wählen der Baudrate (Baud Rate extention)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Die ULTRASONIC Kommunikation kann mit bei verschiedenen Baudraten erfolgen. Der Einstellbereich reicht von 1200Baud bis 921Kbaud. Mit den Befehlen BR und BX kann die Baudrate gewählt werden. Mit dem Befehl BR wird die Baudrate im Bereich von 1200 Baud bis 115200 Baud festgelegt. Der Befehl BX legt die Baudrate von 230400 Baud bis 921600 Baud fest. Für BX sind folgende Baudraten definiert:

Parameterbeschreibung:

101:	230400 Baud	8,N,1
102:	460800 Baud	8,N,1
103	921600 Baud	8,N,1

Tabelle 10: Liste der Baudrate mit Telegramm BX

Bei der Programmierung der erweiterten Baudrate ist ein Sicherheitsmechanismus integriert, der das Einstellen einer Baudrate mit dem Befehl BX nicht durchführt, wenn eine Kommunikation mit dieser Baudrate nicht aufgebaut werden kann. Bei den meisten PCs ist die maximale Baudrate auf 115200 Baud festgelegt. Eine höhere Baudrate kann nicht eingestellt werden. Besitzt das ULTRASONIC eine Baudrate >115200 kBaud, kann eventuell mit dem Gerät nicht kommuniziert werden. Um mit diesen Baudraten arbeiten zu können, benötigt ein Standard PC eine spezielle Erweiterungskarte. Um den ULTRASONIC auf eine erweiterte Baudrate einstellen zu können, muss wie folgt vorgegangen werden:

Ausgangssituation:

Die Kommunikation zum ULTASONIC ist vorhanden (z.B. 9600 Baud).

Änderung der Baudrate:

Der Anwender wählt eine neue Baudrate aus, z.B. 230400 Baud.

Das ULTRASONIC ändert seine Baudrate, speichert den Parameter aber noch nicht ab.

Der Anwender stellt seinen PC auf die neue Baudrate um.

Er wiederholt die Eingabe zum Ändern der Baudrate (gleiches Kommando wie oben)

Dies ist für den ULTRASONIC das Zeichen, dass eine Kommunikation mit der neuen

Baudrate funktioniert, und es speichert den Parameter intern ab.

Kann der Anwender die neue Baudrate am PC nicht einstellen, muss das ULTRASONIC neu gestartet werden. Es stellt dann automatisch die letzte gültige Baudrate ein (hier 9600 Baud).

Beispiel:
 00KY00001<cr> Öffnet Zugriffsschlüssel
 00BX00103<cr> Umstellen das ULTRASONIC Baudrate auf
 921600 Baud
 00BX00103<cr> Baurate am PC auf 921600 Baud einstellen
 Befehl für Baudrate wiederholen. Der
 ULTRASONIC speichert die Baudrate ab.
 Bei jedem Neustart wird diese Baudrate
 geladen.

Bei der Abfrage der Baudrate mit dem Befehl BX gibt das ULTRASONIC die letzte programmierte Baudrate zurück, die entweder mit dem Befehl BR oder BX eingestellt wurde.

Wertebereich:
 Initialwert:

101...103
 Als Initialwert für die Baudrate ist der Befehl BR verantwortlich.

Befehl BY

<id>BY<para5>

Skaliert den Ausgabewert des minimalen Messwertes des analogen Eingangs PIN WR/RXD + (Analog channel B)

Zugriff:

Benutzermodus

Beschreibung:

Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl BY wird der Ausgabewert für 0V Eingangsspannung definiert. Der Wert für den Parameter BY berechnet sich wie folgt:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (\text{Skalierter Ausgabesollwert} * 10)$$

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl BZ**.

Befehl BZ

<id>BZ<para5>

Skaliert den Ausgabewert des maximalen Messwertes des analogen Eingangs PIN WR/RXD + (Analog channel B)

Zugriff:

Benutzermodus

Beschreibung:

Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl BZ wird der Ausgabewert für 10,0 V Eingangsspannung definiert.

Der Wert für den Parameter BZ berechnet sich wie folgt:

$$\text{Parameterwert} = 30000 + (\text{Skalierter Ausgabesollwert} * 10)$$

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl BY**.

Befehl CA

<id>CA<para5>

Kalibrierwert für die analogen Strom/ Spannungsausgänge (Steigung).

Zugriff:

Konfigurationsmodus

Beschreibung:

Der Initialwert von 60000 entspricht der unkalibrierten Steigung 1,0000. Der Unterschied zum Initialwert ändert die Steilheit um 0,1 Promille ($1 * 10^{-4}$) pro Inkrement. Der Kalibrierwert liegt unterhalb des Initialwertes von 60000, weil die interne Verstärkung zum Ausgleich der Genauigkeiten der Referenz und der Bauteilstreuungen um 1% zu hoch vorgehalten wird.

Wertebereich:
 Initialwert:

59000...61000
 Geräteabhängig

Befehl CB

<id>CB<para5> Kalibrierwert für die analogen Strom/ Spannungsausgänge (Offsetkorrektur).
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Der Initialwert von 1000 repräsentiert eine Offsetkorrektur von 0.
 Die Differenz zum Initialwert addiert (Wert >1000) oder subtrahiert einen Offset (Wert < 1000) als Vielfaches eines Inkrementes des 16-Bit LSB-Wertes (ca. 15ppm von FS) als Offset auf den jeweiligen Ausgabewert.

Wertebereich: 800...1200
 Initialwert: Geräteabhängig

Befehl CI

<id>CI<para5> Wählt den Kommandointerpreter (Command Interpreter)
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Das ULTRASONIC enthält mehrere Befehlsinterpreter. Im Standard Modus ist der THIES- Befehlsinterpreter aktiv. Mit dem **Befehl CI** kann der Befehlsinterpreter gewechselt werden. Der Befehlsinterpreter entscheidet über das Format der eingegebenen Befehle. Als Standard Befehlsinterpreter ist „THIES“ eingestellt.
 Er erwartet die Befehle in der Form:

XXBBnnnn<CR> Telegramm zum Ändern eines Parameters

XXBB<CR> Abfragetelegramm

Mit

XX = zweistellige ID (Initialwert ist 00, siehe **Befehl CI**)

BB = zwei Zeichen Befehlskennung

nnnn= 5 Zeichen Parameter

<CR> -> Carriage Return als Endekennung

Beim Ändern eines Parameters ist darauf zu achten, dass der entsprechende Zugriffsschlüssel gewählt ist, siehe **Befehl KY**.

Parameterbeschreibung:

0: Standard Thies Befehlsinterpreter

1: Bayern Hessen Befehlsinterpreter

Wertebereich: 0...1

Initialwert: 0

Befehl CY

<id>CY<para5> Skaliert den Ausgabewert des minimalen Messwertes des analogen Eingangs PIN ADIO (Analog channel C)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl CY wird der Ausgabewert für 0V Eingangsspannung definiert. Der Wert für den Parameter CY berechnet sich wie folgt:
 Parameterwert = 30000 + (Skalierter Ausgabesollwert *10)

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl CZ**.

Befehl CZ

<id>CZ</para5> Skaliert den Ausgabewert des minimalen Messwertes des analogen Eingangs PIN ADIO (Analog channel C)
Zugriff: Benutzermodus
Beschreibung: Die Messwerte der analogen Eingänge können skaliert ausgegeben werden. Mit dem Befehl CZ wird der Ausgabewert für 10,0V Eingangsspannung definiert.
Der Wert für den Parameter CZ berechnet sich wie folgt:
Parameterwert = 30000 + (Skalierter Ausgabesollwert *10)

Siehe auch **Analoge Eingänge** und **Befehl CY**.

Befehl DA

<id>DA</para5> Datenanforderung im Bayern Hessen Befehlsinterpreter
Zugriff: Abfragemodus
Beschreibung: Fordert die Daten im Bayern Hessen Format an. Der Befehl DA verhält sich konform der Bayern Hessen Spezifikation. Er kann sowohl mit als auch ohne Messgeräteadresse verwendet werden.
Wertebereich: Abhängig von den gewählten Messgeräteadressen, siehe **Befehl BH**.
Initialwert: kein Initialwert

Befehl DE

<id>DE</para5> Standardabweichung (Deviation)
Zugriff: Benutzermodus
Beschreibung: Schaltet die Berechnung der Standardabweichung ein bzw. aus. Das ULTRASONIC verfügt über die Möglichkeit zur Berechnung der Standardabweichung. Bei eingeschalteter Berechnung wird die Standardabweichung für die Windrichtung, Geschwindigkeit und Temperatur ermittelt. Weil die Berechnung der Standardabweichung je nach Mittelungszeitraum recht zeitintensiv ist, kann sie separat ein / ausgeschaltet werden. Die Standardabweichung ist nicht aktiv wenn Momentanwerte ausgegeben werden.

Parameterbeschreibung:

0: Standardabweichung aus
1: Standardabweichung ein

Einige Werte der Standardabweichung werden in Telegramm 5 ausgegeben. Alle weiteren Werte stehen im benutzerdefinierten Telegramm zur Verfügung, siehe **Feste Telegrammformate** und **Anwenderspezifisches Telegramm**.

Wertebereich: 0...1
Initialwert: 0

Befehl DF

<id>DF<para5>	Setze Initialwerte (Default values)
Zugriff:	Konfigurationsmodus
Beschreibung:	Setzt alle Parameter auf ihren Initialwert. Nach diesem Befehl werden alle Parameter des ULTRASONIC auf ihren Initialwert geschrieben. Parameterbeschreibung: 1: ACHTUNG: Die Werte im EEPROM werden nicht überschrieben. Nach einem Neustart liest das ULTRASONIC seine ‚alten‘ Parameter aus dem EEPROM aus 2: setzt alle Parameter auf den Initialisierungswert. ACHTUNG: Überschreibt die EEPROM-Parameter mit den Initialisierungswerten.
Wertebereich:	0...2
Initialwert:	Kein Initialwert

Befehl DM

<id>DM<para5>	Duplex Modus
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Der Duplex Modus entscheidet über die Art der physikalischen Verbindung der seriellen Digitalchnittstelle. Im Vollduplex Modus werden jeweils Sende- und Empfangssignale über getrennte Leitungspaare übertragen. Es ist somit ein wahlfreies Senden und Empfangen möglich. Im Halbduplex Betrieb findet die Übertragung der Sende- bzw. Empfangssignale über das gleiche Leitungspaar statt. Je nach Einstellung ergeben sich Einschränkungen auf die Funktion der Stecker Pins des ULTRASONICs, siehe Befehl AA, Befehl AB, Befehl AC, Befehl TT, Serielle Datenausgabe, 7.1.1. Ab Softwareversion V3.10 kann auch im Halbduplexbetrieb die selbstständige Telegrammausgabe eingeschaltet werden. Hierbei wird die Telegrammausgabe erst nach einer Minute aktiv, so dass in der Zwischenzeit weitere Kommandos an das Gerät gesendet werden können. Bei einem Neustart des Gerätes mit Halbduplexbetrieb und selbstständiger Telegrammausgabe wird die Telegrammausgabe erst nach einer Minute nach dem Gerätestart aktiv. Bei aktiver selbstständiger Telegrammausgabe im Halbduplexbetrieb ist es unter Umständen nicht möglich mit dem Gerät zu kommunizieren. Um Befehle an das Gerät zu senden muss diese dann neu gestartet werden. Weil innerhalb der ersten Minute keine Daten ausgegeben werden, ist es möglich dem Gerät Befehle zu senden. Das Umschalten vom Halbduplex in den Vollduplex Modus kann nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: <ul style="list-style-type: none"> Die Pins WG/RXD- und WR/RXD+ dürfen nicht als Analog-Ein- / Ausgänge geschaltet sein, siehe Befehl AA und Befehl AB.
Parameterbeschreibung:	0: Halbduplex Betrieb (RS485, Sendetreiber wird abgeschaltet wenn keine Daten gesendet werden) 1: Vollduplex Betrieb (RS485 Sendetreiber wird abgeschaltet wenn keine Daten gesendet werden) 2: Vollduplex Betrieb (RS422, Sendetreiber wird in den Sendepausen nicht abgeschaltet)
Wertebereich:	0...2
Initialwert:	2

Befehl DV

<id>DV<para5> Lese Geräteinformationen
 Zugriff: Nur Abrage
 Beschreibung: Gibt die Geräteversion und Datum- Zeitinformationen der Firmware aus.
 Wertebereich: kein
 Initialwert: kein

Befehl DY

<id>DY<para5> Effektive akustische Länge der Y-Messstrecke (Distance Y-Path)
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Effektiver akustischer Abstand zwischen den Ultraschall-Wandlern Nord und Süd.
 Dieser Parameter wird beim werksseitigen Abgleich eingestellt und darf nicht geändert werden.
 Wertebereich: 18000...21000
 Initialwert: Geräteabhängig

Befehl EI

<id>EI<para5> Analogwert im Fehlerfall (Error inversion)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Definiert ob im Fehlerfall der Minimalwert oder der Maximalwert an den Analogausgängen ausgegeben wird. Stellt das ULTRASONIC während einer Messung einen statischen Fehler fest, so gibt es unter bestimmten Voraussetzungen einen Fehler aus. Die Ausgabe soll den Anwender davor schützen, dass er fehlerhafte Messwerte interpretiert. Das ULTRASONIC schaltet Analogsignale der Windrichtung und Windgeschwindigkeit im Fehlerfall auf den maximalen bzw. minimalen Ausgabewert. Der Parameter bestimmt im Fehlerfall die Ausgabe des minimalen oder maximalen analogen Ausgabewertes.

Parameterbeschreibung:

- 0: Analogausgänge werden im Fehlerfall auf Maximum gesetzt
- 1: Analogausgänge werden im Fehlerfall auf 0 gesetzt
- 2: Analogausgang der Windgeschwindigkeit wird im Fehlerfall auf 0 gesetzt
 Analogausgang der Windrichtung wird im Fehlerfall auf Maximum gesetzt
- 3: Analogausgang der Windgeschwindigkeit wird im Fehlerfall auf Maximum gesetzt
 Analogausgang der Windrichtung wird im Fehlerfall auf 0 gesetzt
- 4: Analogausgänge werden im Fehlerfall auf 2mA bzw. 1V gesetzt
 Der Parameter SC muss dafür auf 1 eingestellt sein!

Die Ausgabe im Fehlerfall bei Parameter 0..3 ist unabhängig von Parameter SC, siehe **Befehl SC**.

Wertebereich: 0...4
 Initialwert: 0

Befehl FB

<id>FB<para5> Fast Boot
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Das ULTRASONIC verfügt über einen Bootloader, der beim Starten des Gerätes automatisch aufgerufen wird. Der Bootloader hat die Aufgabe, ein neues Programm in den Speicher des ULTRASONICs zu laden. Hierzu sendet der Bootloader eine bestimmte Zeichenkette über die RS485 und wartet auf

eine entsprechende Antwort. Empfängt das Gerät eine gültige Antwort, startet das Programmupdate.

Mit dem Befehl FB kann das ULTRASONIC dazu veranlasst werden, beim nächsten Start den Bootloader zu übergehen. In diesem Fall wird nicht versucht, ein Update über die RS485 anzustoßen. Die Folge ist, dass das ULTRASONIC schneller mit seinem Hauptprogramm startet.

Mit dem Parameter FB wird das Startverhalten beeinflusst.

Parameterbeschreibung:

- 0: Fastboot ausgeschaltet. Nach einem Neustart startet zunächst der THIES-Bootloader, anschließend das Hauptprogramm.
- 1: Fastboot eingeschaltet. Bei Systemstart steht das erste Datentelegramm nach 200ms zur Verfügung (ausgeschaltete Mittelung).
- 2: Der Bootloader unterdrückt die Ausgabe der Startparameter bei 9600 Baud (ab Bootloader- Version V1.43).
- 3: Fastboot ausgeschaltet. Nach einem Neustart startet zunächst der X-Modem Bootloader, anschließend das Hauptprogramm.

Bei einem möglichst schnellen Systemstart ist der Parameter SM auf ‚0‘ zu setzen, siehe auch **Befehl SM** und **Speichern von Systemereignissen**.

Wertebereich:

0...3

Initialwert:

0

Befehl GU

<id>GU<para5>

Zugriff:

Beschreibung:

Maximalwert im Mittelungspuffer (Böenermittlung, engl. Gust)

Benutzermodus

Bei der Verwendung von Mittelwertpuffern kann mit diesem Parameter die maximale Windgeschwindigkeit und zugehörige Windrichtung (Böe) im Mittelwertpuffer ermittelt werden. Der Wert des Befehls GU gibt die zeitliche Länge der Böe in 100 ms-Schritten an. Mit GU00000 wird die Böenermittlung ausgeschaltet.

Siehe hierzu auch Abschnitt **Böenerfassung**.

Parameterbeschreibung:

- 0: Böenermittlung ausgeschaltet.
- >0: Böenermittlung eingeschaltet. Die Länge der Böe muss kleiner sein als der eingestellte Mittelungszeitraum.

Beispiel:

AV00003

GU00030

Das Gerät ermittelt im gleitenden Mittelwertpuffer (hier 1 Minute) die maximale Böe. Der Böenwert ist der Mittelwert aus 3 Sekunden. Alle Werte im Mittelungspuffer werden sukzessiv überprüft. Die Ermittlung der Böe erfolgt nach jeder Messung.

Wertebereich:

0...30

Initialwert:

0

Befehl HC

<id>HC</id>
Zugriff: Spannungsschwellwert zur Heizungsunterdrückung (Heating Control)
Benutzermodus
Beschreibung: Mit diesem Parameter wird die minimale Versorgungsspannung in Volt angegeben, ab der die Heizungsteuerung aktiviert wird. Unterschreitet die Versorgungsspannung diesen Wert, wird die Heizung deaktiviert bzw. ausgeschaltet. Unterstützt wird der Parameter ab Firmware V3.09 und der Hardwarerevision V08-08. Ob das vorliegende Gerät diese Option unterstützt, kann über das Kommando (ID) PW ermittelt werden. Gibt (ID) PW einen Zahlenwert zurück, wird die Heizungsteuerung unterstützt. Wird die Heizungsteuerung nicht unterstützt, antwortet das Gerät mit der Ausgabe: „System power ctrl not supported“.

Wertebereich: 5..48
Initialwert: 10

Befehl HL

<id>HL</id>
Zugriff: Untere Schwellwerttemperatur zum Schalten der Heizung (Heating low)
Benutzermodus
Beschreibung: Mit diesem Parameter wird die untere Schwellwerttemperatur für die Heizungsteuerung für HT00001 angegeben. Unterschreitet die akustische Virtuelltemperatur diesen Wert, wird die Heizung eingeschaltet. Die Eingabe erfolgt in Kelvin.
273K entsprechen 0°C, -273°C entsprechen 0K
275K entsprechen 2°C

Wertebereich: 220K..320K
Initialwert: 275

Befehl HH

<id>HH</id>
Zugriff: Obere Schwellwerttemperatur zum Schalten der Heizung (Heating high)
Benutzermodus
Beschreibung: Mit diesem Parameter wird die obere Schwellwerttemperatur für die Heizungsteuerung für HT00001 angegeben. Überschreitet die akustische Virtuelltemperatur diesen Wert, ist das Temperaturkriterium zum Einschalten der Heizung nicht erfüllt. Sind alle anderen Kriterien zum Ausschalten der Heizung erfüllt, wird die Heizung ausgeschaltet. Die Eingabe erfolgt in Kelvin.
273K entsprechen 0°C, -273°C entsprechen 0K.
280K entsprechen 7°C.

Wertebereich: 220K..320K
Initialwert: 280

Befehl HT

<id>HT</id>

Zugriff:

Beschreibung:

Heizungssteuerung (Heating)

Benutzermodus

Um eine Vereisung zu vermeiden, verfügt das ULTRASONIC über eine effektive Heizung, die die Sensorarme und die Ultraschallwandler bei Bedarf erwärmt.

Über den Befehl HT kann die Funktion der Heizung beeinflusst werden. Um ein Ansprechen der elektrischen Überlastsicherung in der externen Versorgung des Gerätes bei Einschalten der Heizung zu vermeiden, wird diese getaktet eingeschaltet. Als Basis dient eine Impulsbreite von 100ms. Beim Start ist das Verhältnis von eingeschalteter Heizung zur ausgeschalteten Heizung 1:100.

Nach jeweils weiteren 100ms verschiebt sich das Verhältnis um 5ms zu

Gunsten der eingeschalteten Heizung.

Nach 2 Sekunden ist die Heizung komplett an. Bei Geräten mit PTC-Heizung wird diese auch getaktet eingeschaltet.

Zeit nach Einschalten[ms]	Zeit Heizung an	Zeit Heizung aus
0	1	99
100	6	94
200	11	89
...
1900	96	4
2000	Komplett an	

Tabelle 11: Tastverhältnis beim Einschalten der Heizung

Parameterbeschreibung:

- 0: Heizung immer aus.
- 1: Heizung softwaregesteuert über Virtuelltemperatur.
- 2: Heizung immer ein.
- 3: Heizung softwaregesteuert über Virtuelltemperatur und Gehäusetemperatur.
- 4: Heizung softwaregesteuert über Virtuelltemperatur und Gehäusetemperatur.
- 5: Heizung softwaregesteuert über Virtuelltemperatur und Gehäusetemperatur.
- 6: Die Heizung wird sofort dauerhaft, aber nicht getaktet, eingeschaltet.

Hinweis:

Detaillierte Beschreibung siehe Heizungssteuerung Kapitel 7.6.

Die Funktion des Heizmodus HT4 beeinflusst ungünstig, wenn die Montage des Geräts auf einem beheizten Rohr erfolgt

Das Temperaturkriterium zur Steuerung der Heizung wird immer aus dem letzten gültigen Messwert abgeleitet und nicht aus dem aktuellen Mittelwert. Im Dauerbetrieb ist die Heizung durch eine Temperaturüberwachung geschützt. Übersteigt die Temperatur der Messarme ca. +40°C, schaltet die Heizung automatisch ab. Beim Unterschreiten eines Schwellwertes schaltet sie wieder ein.

Siehe auch Befehl HC.

Wertebereich: 0...6

Initialwert: Geräteabhängig

Befehl ID

<id>ID<para5> ULTRASONIC ID
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Mit diesem Befehl wird die ID des ULTRASONICs festgelegt, wenn der Parameter XI auf 0 gesetzt ist, siehe **Befehl XI**. Die ID wird in jedem Telegramm des ULTRASONIC verwendet, wenn der Befehlsinterpreter ‚THIES‘ gewählt ist, siehe **Befehl CI**. Nachdem die ID geändert ist, reagiert das ULTRASONIC sofort auf die neue Kennung.

Die ID 99 ist eine erweiterte ID. Auf Befehle mit der ID 99 antwortet das ULTRASONIC immer (bei richtiger Baudrate). Die ID 99 darf nicht im Busbetrieb verwendet werden.

Beispiel:

00KY00001	öffnen mit Benutzerschlüssel
00ID00023	Ändern der ID von 0 auf 23
!23ID00023	ULTRASONIC quittiert Änderung
23DM	Abfrage des Duplex-Modus mit neuer ID
!23DM00000	Antwort vom ULTRASONIC
23ID00000	Ändern der ID von 23 auf 0
!00ID00000	ULTRASONIC quittiert Änderung

Wertebereich: 0...99
 Initialwert: 0

Befehl IT

<id>IT<para5> Gehäuseinnentemperatur
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Gibt die Gehäuseinnentemperatur in 0.1° zurück. Die Auflösung der Temperatur beträgt ca. 0.1°C. Ein Wert von 256 bedeutet 25,6°C. Die Gehäuseinnentemperatur wird zur Heizungssteuerung verwendet. Die Zeitkonstante zum angleichen der Gehäuseinnentemperatur zur Außentemperatur beträgt ca. 20min.
 Die Gehäuseinnentemperatur kann bei Geräten ab Lieferdatum Oktober 2009 und Softwareversion V3.10 verwendet werden.

Befehl KY

<id>KY<para5>	Zugriffsmodus (Key)
Zugriff:	Abfragemodus
Beschreibung:	Um die Parameter des ULTRASONICs zu ändern, sind für die meisten Befehle Zugriffsberechtigungen notwendig. Damit wird ein versehentliches Ändern der Parameter vermieden. Die Zugriffe staffeln sich in drei Ebenen: <ul style="list-style-type: none"> • Abfragemodus • Benutzermodus • Konfigurationsmodus
Parameterbeschreibung:	
00000:	Abfragemodus Parameter, die keine Zugriffsbeschränkung besitzen sind solche, die nicht in das EEPROM gespeichert werden, z.B. die zyklische Telegrammabfrage oder die Ausgabe des Systemstatus.
00001:	Benutzermodus (USER ACCESS) Mit dem Benutzerschlüssel sind Parameter geschützt, die das Verhalten des ULTRASONIC beeinflussen, wie z.B. Mittelungszeitraum und Baudrate. Der Anwender kann diese Parameter ändern, er sollte sich jedoch im Klaren sein, dass eine Änderung der Parameter auch das Verhalten des ULTRASONICs ändert. Es wird empfohlen, vor jeder Änderung die aktuelle Konfiguration mit dem Befehl SS ausgeben zu lassen und abzuspeichern.
xxxxx:	Konfigurationsmodus (CONFIG ACCESS) Parameter, die mit diesem Schlüssel geschützt sind, sollten nicht geändert werden. Sie werden überwiegend beim werksseitigen Geräteabgleich eingestellt. Ein Verstellen dieser Parameter kann zu einer kompletten Fehlfunktion führen. Zur Vollständigkeit sind die Parameter in dieser Dokumentation mit aufgenommen, sie sollten allerdings nicht geändert werden.
Wertebereich:	Nach einem Neustart wird immer in den Abfragemodus geschaltet. Wird ein Befehl falsch geschrieben, oder ein ungültiger Befehl eingegeben, setzt das ULTRASONIC den Zugriffsmodus sofort auf Abfragemodus.
Initialwert	0, 1, xxxxx 0

Befehl MA

<id>MA>>para5> Automatische Anpassung der Messwertaufnahme (Measurement Automation)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Legt fest, ob bei einer erkannten Fehlmessung das Messintervall MA automatisch geändert wird, siehe **Befehl MD**.

Parameterbeschreibung:

- 0: Ein erkannter fehlerhafter Messwert innerhalb des Plausibilitätstests hat keinen Einfluss auf das Intervall der Messwertaufnahme.
- >0: Ein erkannter fehlerhafter Messwert innerhalb des Plausibilitätstests hat zur Folge, dass das Messintervall auf den eingestellten Wert gesetzt wird, und im Fehlerfall mit dieser Frequenz zu messen. Der Parameter MA dividiert mit 10 ersetzt im Fehlerfall das Messwertintervall, das mit dem Parameter MD eingestellt wird. Haben MD (multipliziert mit 10) und MA die gleichen Werte, ändert sich die Messgeschwindigkeit im Fehlerfall nicht. Das Messintervall wird zurückgesetzt, wenn 4 aufeinander folgende Datensätze keinen Fehler zeigen.

Der Wert für MA ist in 0,1ms angegeben,
 d.h. ein MA-Wert von 30 entspricht 3,0 ms

Wertebereich: 0...100
 Initialwert: 30

Befehl MD

<id>MD>>para5> Messintervall (Measurement Delay)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Gibt die Zeit in ms an, die zwischen zwei Laufzeitmessungen gewartet wird. Das ULTRASONIC misst zyklisch die Streckenlaufzeiten der Einzelstrecken. Der Parameter MD definiert den Zeitraum zwischen zwei Laufzeitmessungen. Im Standardbetrieb beträgt die Zeit 10ms, so dass alle 20ms ein kompletter Datensatz von allen Sensoren aufgenommen wird. Erkennt das ULTRASONIC eine Fehlmessung, so kann der Wert MD auf 0 gesetzt werden, d.h. dass die Laufzeitmessungen direkt ohne zeitliche Verzögerung aufeinander folgen, siehe **Befehl MA**. Wird z.B. ein Sensor blockiert, erkennt man das Umschalten von MD auf MA an der höheren Wieder-holfrequenz der Laufzeitmessungen.

Wertebereich: 0...1000
 Initialwert: 5

Befehl OH

<id>ZB<para5> Betriebsstundenzähler (Operational Hours)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Der Betriebsstundenzähler gibt die tatsächlich angefallenen Betriebsstunden als 5-stellige Zahl aus. Somit können maximal 99999 Stunden Betriebsdauer ohne Übertrag mitgezählt werden. Dies entspricht einem Zeitraum von ca. 11,4 Jahren.
 Der Zählerstand bleibt bei Stromausfall oder De-Installation des Gerätes selbstverständlich erhalten.

Initialwert: 0

Befehl OR

<id>OR</id> Telegramm Ausgabeintervall (Output Rate)
 Benutzermodus
 Beschreibung: Bei selbstständiger Telegrammausgabe wird mit diesem Parameter das Zeitintervall angegeben, in dem Telegramme über die serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Die Angabe erfolgt in Millisekunden. Ist die Ausgabegeschwindigkeit höher als die Daten übertragen werden können, wird die anstehende Ausgabe verworfen.
 Ist die Ausgabe schneller als die Messwerterfassung, werden die vorhandenen Messwerte erneut ausgegeben.
 Ist die Mittelung ausgeschaltet AV=0 (siehe **Befehl AV**), ist der Mittelungszeitraum gleich dem Ausgabeintervall, unabhängig davon ob selbstständige Telegrammausgabe gewählt ist oder nicht.
 Siehe auch **7.4.2 Selbstständige Telegrammausgabe, Befehl TT, Befehl DM.**

Parameterbeschreibung:

0: Es wird immer dann ein Telegramm ausgegeben, wenn die interne Messwerterfassung einen neuen Datensatz berechnet hat.
 1 ... 60000 Gibt das Ausgabeintervall in Millisekunden an.

Wertebereich: 0 ... 60000 [ms]
 Initialwert: 100

Befehl OS

<id>OS</id> Skalierung der Windgeschwindigkeitsausgabe (Output Scale)
 Benutzermodus
 Beschreibung: Mit diesem Befehl wird festgelegt, in welcher Einheit die Windgeschwindigkeit im seriellen Telegramm ausgegeben wird. Es stehen hierzu verschiedene Maßeinheiten zur Verfügung.

Parameterbeschreibung:

Parameter	Maßeinheit	Umrechnungsfaktor bezogen auf m/s
0	m/s	1
1	Km/h	1m/s => 3.6 km/h
2	miles/h	1m/s => 2.237 miles/h
3	knots	1m/s => 1.94 kn

Tabelle 12: Umrechnungsfaktoren zwischen verschiedenen Windgeschwindigkeiten

Wertebereich: 0...3
 Initialwert: 0

Befehl PC

<id>PC<para5>	Plausibilitätstest (Plausibility Check)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Schaltet die Plausibilitätstests ein / aus. Jeder Messwert wird bei eingeschalteter Plausibilität einer Prüfung unterzogen. Es wird überprüft, ob der Messwert plausibel ist und in die Folge der aufgenommenen Messwerte passt. Ist das der Fall, wird er zur weiteren Verarbeitung freigegeben. Ist dies nicht der Fall, wird der Messwert verworfen. In der Standardkonfiguration hat das folgende Auswirkungen: <ul style="list-style-type: none"> • Die Heizung wird eingeschaltet, siehe Befehl HT. • Das Messwernerfassungsintervall wird auf den Wert von MA gesetzt, siehe Befehl MD.
Wertebereich:	0...7
Initialwert:	7

Befehl PR

<id>PR<para5>	Periodische Empfangszeit (Periodic time Receiver)
Zugriff:	Konfigurationsmodus
Beschreibung:	Der Wert setzt die Empfangs-Periodendauer im seriellen Register im Analogteil des ULTRASONIC. Dieser Wert darf unter keinen Umständen geändert werden. Er wird werksseitig eingestellt.
Wertebereich:	13...99
Initialwert:	Geräteabhängig
Einheit:	100ns

Befehl PT

<id>PT<para5>	Periodische Sendezeit (Periodic time Transmitter)
Zugriff:	Konfigurationsmodus
Beschreibung:	Der Wert setzt die Sendeperiodendauer im seriellen Register im Analogteil des ULTRASONIC. Dieser Wert darf unter keinen Umständen geändert werden. Er wird werksseitig eingestellt.
Wertebereich:	13...99
Initialwert:	Geräteabhängig
Einheit:	100ns

Befehl PW

<id>PW<para5>	Systemspannung (Power)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Gibt die gemessene Versorgungsspannung in Volt zurück. Der Parameter wird ab Softwareversion V3.09 und Hardware 08-08 unterstützt. Unterstützt das vorliegende Gerät die Messung der Versorgungsspannung nicht, wird der Text: „System power ctrl not supported“ bei der Abfrage ausgegeben.

Befehl RC

<id>RC<para5>	Korrekturfaktor für analoge Eingangswerte (Reference Correction)
Zugriff:	Konfigurationsmodus
Beschreibung:	Der Befehl gibt einen Korrekturfaktor in 10 ppm für die Messwerte der analogen Eingänge an. Der Wert wird werksseitig kalibriert und darf nicht verändert werden.
Wertebereich:	0...1000
Initialwert:	Geräteabhängig

Befehl RD

<id>RD<para5>	Antwortverzögerung (Response delay)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Der Befehl verzögert nach einem Kommando über die serielle Schnittstelle die Antwort um die angegebene Zeit in ms.
Wertebereich:	0...1000
Initialwert:	5
Einheit:	ms

Befehl RF

<id>RF<para5>	Neustart bei ungültigen Messwerten (Restart at Fail)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Mit dem Befehl wird festgelegt, nach welcher Zeit das ULTRASONIC einen Neustart durchführen soll, wenn keine gültigen Daten gemessen werden. Ein Parameterwert von 0 schaltet die Funktion ab. Der Neustart wird nur dann ausgelöst, wenn im angegebenen Zeitintervall kein gültiger Messwert ermittelt wurde.
Wertebereich:	0; 10...1000
Initialwert:	60
Einheit:	Sekunden

Befehl RP

<id>RP<para5>	Lese Parameterdatensatz (Read Parameter)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Mit dem Befehl kann ein vorher gespeicherter Datensatz geladen werden, siehe auch Befehl SP . Nach dem Laden wird automatisch ein Neustart durchgeführt. Der Datensatz mit dem Index ,0' enthält die Parameter bei der Auslieferung und kann nicht überschrieben werden. Die Datensätze ,1' und ,2' können frei verwendet werden.
Wertebereich:	0...2

Befehl RS

<id>RS<para5>	Neustart ULTRASONIC (Reset)
Zugriff:	Benutzermodus
Beschreibung:	Durch das Senden des Kommandos wird der Watchdog des ULTRASONIC nicht mehr bedient. Dies hat nach ca. 2sek einen Kaltstart zur Folge. Das ULTRASONIC startet komplett neu.
Parameterbeschreibung:	
	1: Das ULTRASONIC führt einen Kaltstart aus. Er verhält sich so, wie nach dem Anschließen der Versorgungsspannung.
Wertebereich:	1
Initialwert:	kein Initialwert

Befehl SC

<id>SC<para5> Minimalwert der Analogausgänge (Start Current)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Bei der Verwendung der Analogausgänge kann der auszugebende Minimalwert eingestellt werden. Der Endwert der Ausgänge wird dadurch nicht beeinflusst. Der Minimalwert beträgt 0% oder 20% vom Endwert. Abhängig vom Parameter AN wird der eingestellte Minimalwert in einen Strom bzw. Spannungswert umgesetzt. Es lassen sich so die Strom- und Spannungsausgänge mit 0...20mA, 4..20mA, 0...10V, und 2...10V realisieren, siehe **Befehl AN**.
 Siehe auch: **Befehl AA**, **Befehl AB**.

Parameterbeschreibung:

0: Minimalwert 0% vom Maximalwert
 1: Minimalwert 20% vom Maximalwert

Zusammen mit dem Parameter AN lassen sich die analogen Ausgänge wie folgt konfigurieren:

	Parameter SC=0	Parameter SC=1
Parameter AN=0	0..10V	2..10V
Parameter AN=1	0..20mA	4..20mA

Parameter AA= 0; AB = 0

Tabelle 13: Konfiguration der Analogausgänge WG/RXD- u. WR/RXD+ mit Parameter AN u. SC

Wertebereich: 0...1
 Initialwert: 0

Befehl SE

<id>SE>>para5> Ausgabe der gespeicherten Systeminformationen (System Event)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Gibt die gespeicherten Systeminformationen zurück. Es stehen 178 Einträge zur Verfügung, bevor die ältesten Einträge des Ringspeichers überschrieben werden. Es werden die Ereignisse gespeichert, die durch den Befehl SM aktiviert sind, siehe **Befehl SM**.

Befehl SH

<id>SH<para5> Seriennummer (High Word) (Serial number High word)
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Während des werksseitigen Abgleichs des ULTRASONIC bekommt jedes ULTRASONIC eine Seriennummer. Mit dieser Seriennummer kann das ULTRASONIC eindeutig identifiziert werden. Das Speichern der Seriennummer ist in High und Low – Byte aufgeteilt. Die Seriennummer darf nicht verändert werden.
 Wertebereich: 0...65535

Befehl SL

<id>SH<para5> Seriennummer (Low Word) (Serial number Low word)
Zugriff: Konfigurationsmodus
Beschreibung: Während des werksseitigen Abgleichs des ULTRASONIC bekommt jedes ULTRASONIC eine Seriennummer. Mit dieser Seriennummer kann das ULTRASONIC eindeutig identifiziert werden. Das Speichern der Seriennummer ist in High und Low – Byte aufgeteilt. Die Seriennummer darf nicht verändert werden.

Wertebereich: 0...65535

Befehl SM

<id>SM>>para5> Maske zum Speichern von Systeminformationen (System event Mask)
Zugriff: Benutzermodus
Beschreibung: Gibt die Maske an, mit welcher Systeminformationen in den Systemspeicher geschrieben werden sollen. Ist die entsprechende Wertigkeit in der Maske gesetzt, werden zugehörige Ereignisse in dem Systemereignisspeicher geschrieben. Folgende Ereignisse können gewählt werden:

- 1: Systemstart
- 2: Aufschließen im Konfigurationsmodus
- 4: Beschreiben interner Register PR und PT
- 8: Keine gültigen Daten über einen längeren Zeitraum
- 16: Mittelungspufferfüllstand kleiner 2 Inkrement (Basis ist Wert aus erweitertem Status)

Wird der Parameter auf ‚0‘ gesetzt, ist der Systemspeicher ausgeschaltet. Der Maskenwert ist die Summe der zu speichernden Systeminformationen. Der Wert ‚5‘ speichert z.B. die Ereignisse ‚Systemstart‘ und ‚Beschreiben interner Register PR und PT‘. Ein Wert von SM > 0 verzögert den Bootvorgang um ca. 200ms. Dies ist bei der Verwendung von ‚Fastboot‘ zu beachten, siehe **Speichern von Systemereignissen**.

Wertebereich: 0...255
Initialwert: 0

Befehl SP

<id>SP<para5> Speichere Parameterdatensatz
Zugriff: Benutzermodus
Beschreibung: Mit dem Befehl kann ein Datensatz gespeichert werden. Alle Parameter werden intern gespeichert und können durch RP wieder geladen werden, siehe **Befehl RP**. Der Datensatz mit dem Index ‚0‘ enthält die Parameter bei der Auslieferung und kann nicht überschrieben werden.

Die Datensätze ‚1‘ und ‚2‘ sind frei verwendbar.

Wertebereich: 0...2

Befehl SS

`<id>SS</para5>` System-Status (system status)
 Zugriff: Abfragemodus

Beschreibung: Gibt die eingestellten Parameter aller Befehle aus. Es werden hier alle im EEPROM gespeicherten Parameter ausgegeben. Bevor die Parameter des ULTRASONIC geändert werden, sollte mit Hilfe dieses Befehls eine Liste der eingestellten Parameter erstellt und gesichert werden, z.B. durch Kopieren der Parameter in eine Textdatei.

Parameterbeschreibung:

Bei Verwendung des Befehls SS ist kein Parameter erforderlich. Der Aufruf bei eingestellter Geräte - ID 00 ist wie folgt:

00SS<cr> mit <cr> Carriage Return (Enter Taste)

Wertebereich: kein Wertebereich
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl SV

`<id>SV</para5>` Software Version (software version)
 Zugriff: Abfragemodus

Beschreibung: Der Befehl liest die aktuelle Softwareversion aus und gibt sie zurück. Zur Interpretation muss die ausgegebene Version durch 100 dividiert werden. Ein ausgegebener Wert 00SV00123 repräsentiert die Version V1.23. Die ‚1‘ bedeutet die Hauptversion, die 23 ist das Build – Label.

Befehl TB

`<id>TB</para5>` Telegramm im Burstmode
 Zugriff: Abfragemodus

Beschreibung: Mit dem Befehl TB wird das Telegramm eingestellt, das die Daten nach Beendigung einer Burst- Messung ausgibt. Zulässige Telegramme sind alle Datentelegramme. Siehe auch **Befehl TR**.

Wertebereich: 1...13
 Initialwert: 2

Befehl TF

`<id>TF</para5>` Transformator zur Erzeugung der Schallsignale (Transformer)
 Zugriff: Konfigurationsmodus

Beschreibung: Gibt den Type des verwendeten Transformators zur Erzeugung der Analsignale an.

Wertebereich: 0..1h
 Initialwert: Geräteabhängig

Befehl TN

`<id>TN</para5>` Laufzeitverzögerung Nord Sensor (Sensor Time delay NORTH Sensor)
 Zugriff: Konfigurationsmodus

Beschreibung: Geräteabhängige Verzögerungszeit des Sensors. Dieser Parameter wird beim werksseitigen Abgleich eingestellt und darf nicht geändert werden.

Wertebereich: 0..FFFh
 Initialwert: 0

Befehl TR

<id>TR<para5> Telegrammabfrage (Telegram Request)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Mit dem Befehl TR wird gezielt ein Telegramm vom ULTRASONIC angefordert. Nach der Interpretation sendet das ULTRASONIC das angeforderte Telegramm zurück. Das Gerät spezifiziert eine Reihe vordefinierter Telegramme, sowie die Möglichkeit, ein eigenes Telegramm zu konfigurieren, siehe **Feste Telegrammformate, Anwenderspezifisches Telegramm**.
 Im Halbduplex Modus ist der Befehl TR die einzige Möglichkeit um Messwerte über die RS485 Schnittstelle anzufordern.
 Die Antwortzeit des UILTRASONIC bei der Telegrammanfrage ist wie folgt definiert:
 Die Zeitspanne nach dem Erhalt des letzten Zeichens bis zum Senden des ersten Zeichens des Antworttelegramms ist auch bei eingeschalteter Standardabweichung
 < 1ms (gemessen an RXD+ und TXD+ der RS485).
 Um die Antwort des UTRASONIC zu verzögern, kann der Befehl RD verwendet werden.

Parameterbeschreibung:

- 1: VD Telegramm (Windgeschwindigkeit, Windrichtung)
- 2: VDT Telegramm (Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Virtuelltemperatur)
- 3: V4DT Telegramm (Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Virtuelltemperatur)
- 4: NMEA V2.0
- 5: VDT mit Standardabweichungen
- 6: Benutzerdefiniertes Telegramm
- 7: Geschwindigkeitskomponenten Vx und Vy
- 8: VD Telegramm Variante 1
- 9: VDT Telegramm Variante 1
- 10...13: reserviert
- 12: Wissenschaftliches Diagnosetelegramm
- 14: NMEA V2.0
- 16: Benutzerdefiniertes Telegramm mit Fehlercodes

Wertebereich: 1...16

Initialwert: kein Initialwert

Befehl TS

<id>TS<para5> Laufzeitverzögerung Süd Sensor (Sensor Time delay SOUTH Sensor)
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Geräteabhängige Verzögerungszeit des Sensors. Dieser Parameter wird beim werksseitigen Abgleich eingestellt und darf nicht geändert werden.
 Wertebereich: 0...4096
 Initialwert: Geräteabhängig

Befehl TT

<id>TT</para5> Selbständige Telegrammausgabe (Telegram Transmission)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Legt die Nummer des Telegramms fest, die das ULTRASONIC zyklisch selbstständig sendet. Es stehen dieselben Telegramme zur Verfügung, wie unter **Befehl TT** beschrieben ist. Das Zeitintervall, in dem die Telegramme gesendet werden, wird mit dem **Befehl OR** festgelegt. Das selbstständige Senden ist nur im Vollduplex Modus möglich, siehe **Befehl DM**.
 Wertebereich: Ist TT = 0, ist die selbstständige Telegrammausgabe abgeschaltet.
 Initialwert: 0...16
 0

Befehl UA

<id>UA</para5> Zeichen im anwenderdefinierten Telegramm hinzufügen (Add User telegram item)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: In dem anwenderspezifischen Telegramm kann mit Hilfe dieses Befehls eine neue Definition an das Ende des Telegramms hinzugefügt werden, siehe **Anwenderspezifisches Telegramm, Befehl US**. Die erzeugten Daten können mit dem Befehl TR00006 bzw. TT00006 abgefragt werden, siehe auch **Befehl TR, Befehl TT**.
 Wertebereich: Zeichenkette
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl UD

<id>UD,</para5> Benutzerdefinierter Text (User data)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Das Gerät stellt einen Datenpuffer von 32 Texten mit jeweils 32 Zeichen zur Verfügung, in dem beliebiger Text gespeichert werden kann. Mit dem Befehl UD wird dieser Puffer verwaltet. Das Format der Eingabe ist 00UDn,xxxx mit n: Index 1..32
 xxxx: Text mit einer Maximallänge von 32 Zeichen
 Abfrage: 00UD
 gibt alle anwenderspezifischen Texte zurück, z.B.
 01: THIES ULTRASONIC
 03: Standort Wasserkuppe
 00UDn mit 0<n<33
 gibt den Text mit dem Index ‚n‘ zurück
 Siehe auch **Verwalten von Benutzerinformationen**.
 Wertebereich: Zeichenkette
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl UR

<id>UR<para5> Löschen einer oder mehrerer Definitionen am Ende des benutzerdefinierten Telegramms (Remove User telegram item)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Mit Hilfe dieses Befehls können eine oder mehrere Definitionen vom Ende des benutzerdefinierten Telegramms gelöscht werden. Das ULTRASONIC spaltet intern die ihm übergebenen Zeichenketten in separate Definitionen auf. So ist z.B. die Ausgabe einer Variablen immer eine eigenständige Definition. Mit diesem Befehl können schrittweise Definitionen gelöscht werden, siehe auch **Anwenderspezifisches Telegramm, Befehl US**. Die erzeugten Daten können mit dem Befehl TR00006 bzw. TT00006 abgefragt werden, siehe auch **Befehl TR, Befehl TT**.

Parameterbeschreibung:

0..30 Anzahl der zu löschenden Definitionen am Ende des anwenderspezifischen Telegramms.
 Wertebereich: 0...30
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl US

<id>US<para5> Speichere anwenderspezifische Telegrammdefinition (User telegram save)
 Zugriff: Benutzermodus
 Beschreibung: Mit diesem Befehl wird die aktuelle Definition des anwenderspezifischen Telegramms in das EEPROM gespeichert. Alle Änderungen, die mit den Befehlen UA, UR und UT vorgenommen werden, werden nicht permanent gesichert. Der Befehl US dient dazu die Definitionen im EEPROM zu speichern. Die erzeugten Daten können mit dem Befehl TR00006 bzw. TT00006 abgefragt werden, siehe auch **Befehl TR, Befehl TT**.

Parameterbeschreibung:

2: Speichert die Telegrammdefinition im internen EEPROM ab.
 Wertebereich: 2
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl UT

<id>UT<para5> Anwenderspezifisches Telegramm (User Telegram)
 Zugriff: Abfragemodus
 Beschreibung: Mit diesem Befehl wird eine neue Definition des anwenderspezifischen Telegramms erstellt. Eine bereits existierende Definition wird überschrieben, siehe auch **Anwenderspezifisches Telegramm, Befehl US**. Die erzeugten Daten können mit dem Befehl TR00006 bzw. TT00006 abgefragt werden, siehe **Befehl TR, Befehl TT**.

Wertebereich: Zeichenkette
 Initialwert: kein Initialwert

Befehl VC

<id>VC<para5> Konstante Geschwindigkeitskorrektur (Velocity Correction)
 Zugriff: Konfigurationsmodus
 Beschreibung: Gibt den Faktor an, mit dem die Geschwindigkeit korrigiert wird. Die Angabe erfolgt in Promille. Dieser Faktor darf nicht verändert werden.
 Wertebereich: 0...2000
 Initialwert: 1055

Befehl XI

<id>XI<para5> Externe ID (External ID)
Zugriff: Benutzermodus
Beschreibung: Wenn gesetzt, wird die Geräte- ID über die externen Leitungen WG/RXD- (BIT 0), WR/RXD+ (BIT 1) und ADIO (BIT 2) ermittelt. Die Kanäle müssen hierbei entsprechend konfiguriert werden. Siehe **Befehl AA**, **Befehl AB**, **Befehl AC**. Beim Starten liest das ULTRASONIC die ID ein und speichert sie in das EEPROM ab. Das Umprogrammieren der ID wird über die RS485 beim Start als Befehlssequenz ausgegeben.
Ist der Parameter auf 0 gesetzt, liest das ULTRASONIC seine ID aus dem internen EEPROM aus.

Parameterbeschreibung:

0: ULTRASONIC liest ID vom internen EEPROM
1: ULTRASONIC liest ID von externen Leitungen
Wertebereich: 0...1
Initialwert: 0

11 Anhang 1 Vordefinierte Datentelegramme

11.1 Telegramm 1 VD

Windgeschwindigkeit und Windrichtung

Befehl: TR1 Befehl: TT1

Telegrammaufbau: (STX)xx.x xxx*xx(CR)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nn.n	Windgeschwindigkeit		2	„FF.F“	Windgeschwindigkeit	
6		Leerzeichen	20h	6		Leerzeichen	20h
7	nnn	Windrichtung		7	„FFF“	Windrichtung	
10	*	Prüfsummenkennung	2Ah	10	*	Prüfsummenkennung	2Ah
11	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..9)		11	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..9)	
13	CR	Carriage Return	0Dh	13	CR	Carriage Return	0Dh
14	ETX	End of Text	03h	14	ETX	End of Text	03h

11.2 Telegramm 2 VDT

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und akustische virtuelle Temperatur

Befehl: TR2 Befehl: TT2

Telegrammaufbau: (STX)xx.x xxx xxx.x xx*xx(CR)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nn.n	Windgeschwindigkeit		2	FF.F	Windgeschwindigkeit	
6		Leerzeichen	20h	6		Leerzeichen	20h
7	nnn	Windrichtung		7	FFF	Windrichtung	
10		Leerzeichen	20h	10		Leerzeichen	20h
11	±nn.n	Temperatur		11	±FF.F	Temperatur	
16		Leerzeichen	20h	16		Leerzeichen	20h
17	nn	Statuswert hexadezimal		17	nn	Statuswert hexadezimal	
19	*	Prüfsummenkennung	2Ah	19	*	Prüfsummenkennung	2Ah
20	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..18)		20	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..18)	
22	CR	Carrige return	0Dh	22	CR	Carrige return	0Dh
23	ETX	End of Text	03h	23	ETX	End of Text	03h

11.3 Telegramm 3 V4DT

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und akustische virtuelle Temperatur

Befehl: TR3 Befehl: TT3

Telegrammaufbau: (STX)xxx.x xxx xxx.x x xx*xx(CR)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nnn.n	Windgeschwindigkeit		2	FFF.F	Windgeschwindigkeit	
7		Leerzeichen	20h	7		Leerzeichen	20h
8	nnn	Windrichtung		8	FFF	Windrichtung	
11		Leerzeichen	20h	11		Leerzeichen	20h
12	±nn.n	Temperatur		12	±FF.F	Temperatur	
17		Leerzeichen	20h	17		Leerzeichen	20h
18	n	K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mph		18	n	K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mph	
19		Leerzeichen	20h	19		Leerzeichen	20h
20	nn	Statuswert hexadezimal		20	nn	Statuswert hexadezimal	
22	*	Prüfsummenkennung	2Ah	22	*	Prüfsummenkennung	2Ah
23	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..18)		23	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..18)	
25	CR	Carrige return	0Dh	25	CR	Carrige return	0Dh
26	ETX	End of Text	03h	26	ETX	End of Text	03h

11.4 Telegramm 4 NMEA

NMEA V 2.0

Befehl: TR4 Befehl: TT4

Telegrammaufbau: \$WIMWV,xxx.x,R,xxx.x,N,A*xx(CR)(LF)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	\$	Dollar	24h	1	\$	Dollar	24h
2	W		57h	2	W		57h
3	I		49h	3	I		49h
4	M		4Dh	4	M		4Dh
5	W		57h	5	W		57h
6	V		56h	6	V		56h
7	,	Komma	2Ch	7	,	Komma	2Ch
8-12	nnn.n	Windrichtung		8	,	Komma	2Ch
13	,	Komma	2Ch	9	R		52h
14	R		52h	10	,	Komma	2Ch
15	,	Komma	2Ch	11	,	Komma	2Ch
16-20	nnn.n	Windgeschwindigkeit		12		K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mp	
21	,	Komma	2Ch	13	,	Komma	2Ch
22		K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mp		14	V	V = ungültig	

Telegrammaufbau: \$WIMWV,xxx.x,R,xxx.x,N,A*xx(CR)(LF)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
23	,	Komma	2Ch	15	*	Prüfsummenkennung	2Ah
24	A, V	A = gültig, V = ungültig		16	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..14 einschließlich)	
25	*	Prüfsummenkennung		18	CR	Carrige return	0Dh
26-27	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..24 einschließlich)		19	LF	Line Feed	0Ah
28	CR	Carrige return	0Dh				
29	LF	Line Feed	0Ah				

11.5 Telegramm 5 VDT, Standardabweichung

Standardabweichung

Bei der Verwendung der Standardabweichung wird das VDT Telegramm um die Standardabweichungen der Windgeschwindigkeit und.

Befehl: TR5 Befehl: TT5

Telegrammaufbau: (STX)xx.x xx.x xxx xxx xxx.x xxx.x xx*xx(CR)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall Das Telegrammformat entspricht dem des Datentelegramms mit entsprechendem Statuswert.			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert				
1	STX	Start of Text	02h				
2	nn.n	Windgeschwindigkeit					
6		Leerzeichen	20h				
7	nnn	Windrichtung					
10		Leerzeichen	20h				
11	±nn.n	Temperatur					
16		Leerzeichen	20h				
17	nn.n	Windgeschwindigkeit (Standardabweichung)					
21		Leerzeichen	20h				
22	±nn.n	Temperatur (Standardabweichung)					
27		Leerzeichen	20h				
28	nn	Statuswert hexadezimal					
30	*	Prüfsummenkennung	2Ah				
31	nn	Prüfsumme hexadezimal (1..33)					
33	CR	Carrige return	0Dh				
34	ETX	End of Text	03h				

11.6 Telegramm 8 VD Variante 1

Windgeschwindigkeit und Windrichtung Variante 1

Befehl: TR8 Befehl: TT8

Telegrammaufbau: (STX)xx.x.xxx*(CRLF)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nn.n	Windgeschwindigkeit X		2	FF.F	Windgeschwindigkeit X	
6		Leerzeichen	20h	6		Leerzeichen	20h
7	nnn	Windrichtung		7	FFF	Windrichtung	
10	*	Prüfsummenkennung	2Ah	10	*	Prüfsummenkennung	2Ah
11	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..9)		11	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..9)	
13	CR	Carriage Return	0Dh	13	CR	Carriage Return	0Dh
14	LF	Line Feed	0Ah	14	LF	Line Feed	0Ah
15	ETX	End of Text	03h	15	ETX	End of Text	03h

11.7 Telegramm 9 VDT Variante 1

Windgeschwindigkeit, Windrichtung, akustische virtuelle Temperatur, Status und Prüfsumme (Typ 2)

Befehl: TR9 Befehl: TT9

Telegrammaufbau: !iivvdddttttwfR			
Nr.	Zeichen	Zeichenvorrat	Funktion
1	!		Antwortzeichen
2	i	0 ... 9	Geräte ID
3	i	0 ... 9	Geräte ID
4	v	0 ... 9	Windgeschwindigkeit * 10 ¹ m/s
5	v	0 ... 9	Windgeschwindigkeit * 10 ⁰ m/s
6	v	0 ... 9	Windgeschwindigkeit * 10 ⁻¹ m/s
7	d	0 ... 9	Windrichtung * 10 ² Grad
8	d	0 ... 9	Windrichtung * 10 ¹ Grad
9	d	0 ... 9	Windrichtung * 10 ⁰ Grad
10	t	+ ... -	Vorzeichen
11	t	0 ... 9	Temperatur * 10 ¹ °C
12	t	0 ... 9	Temperatur * 10 ⁰ °C
13	t	0 ... 9	Temperatur * 10 ⁻¹ °C
14	w	ASCII	Statusbyte, siehe 7.4.6.4
15	f	ASCII	Prüfsumme (Typ2) 1

11.8 Telegramm 11 VDT Variante 2

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und akustische virtuelle Temperatur

Befehl: TR11 Befehl: TT11

Telegrammaufbau: (STX)xx;xx.x;xxx;xxx.x;xxxx*xx(CR)(LF)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nn	ID		2	FF	ID	
4	;	Semikolon		4	;	Semikolon	
5	nn.n	Windgeschwindigkeit		5	FF.F	Windgeschwindigkeit	
9	;	Semikolon		9	;	Semikolon	
10	nnn	Windrichtung		10	FFF	Windrichtung	
13	;	Semikolon		13	;	Semikolon	
14	±nn.n	Temperatur		14	±FF.F	Temperatur	
19	;	Semikolon		19	;	Semikolon	
20	nnnn	Statuswort (erweiterter Status)		20	nnnn	Statuswort (erweiterter Status)	
24	*	Stern		24	*	Stern	
25	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..23)		25	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..23)	
27	CR	Carriage Return	0Dh	27	CR	Carriage Return	0Dh
28	LF	Line Feed	0Ah	28	LF	Line Feed	0Ah
29	ETX	End of Text	03h	29	ETX	End of Text	03h

11.9 Telegramm 12 Wissenschaftliches Telegramm

Wissenschaftliches Diagnostetelegramm

Befehl: TR12 Befehl: TT12

Telegrammaufbau: WG;WR;VT;V13;T13; C31;C13;N1;N2;N3;N4;TS;TC	
WG	Windgeschwindigkeit (7,2;)
WR	Windrichtung (6,2;)
VT	Virtuelltemperatur (6,2;)
V13	Geschwindigkeit der Strecke 13 (7,2;)
T13	Virtuelltemperatur der Strecke 13 (7,2;) (letzter gemessener Wert im Mittelungsintervall; - 273,15 wenn kein gültiger Wert)
C31	Messwert Laufzeit Wandler 3 in Richtung Wandler 1 (Süd Richtung Nord) (5;)
C13	Messwert Laufzeit Wandler 1 in Richtung Wandler 3 (Nord Richtung Süd) (5;)
N1	Interner Zähler (5;)
N2	Zeitintervall, in dem die Werte in den Hauptmittelspeicher geschrieben werden (5;)
N3	Anzahl der Werte im Hauptmittelspeicher (5;)
N4	THIES Status (2 h;)
TS	Telegrammstatus, siehe 7.4.6.1 Erweiterte Statusinformation (hexadezimale Anzeige) (4 h;)
TC	Interner Tickcount in ms vom Prozessor (9;\r\n)

Bedeutung (7,2;) (x;y)
 X=> Anzahl aller Stellen im Telegramm
 Y=> Anzahl der Nachkommastellen
 z. B. (7;2;)
 0000.00;

11.10 Telegramm 13 VDT Variante 3

Windgeschwindigkeit, Windrichtung und akustische virtuelle Temperatur

Befehl: TR13 Befehl: TT13

Telegrammaufbau: (STX)xx;xx.x;xxx;xxx.x;xxx.x;xxxxx;xxxx*xx (CR)(LF)(ETX)				Telegrammausgabe im Fehlerfall			
Nr.	Zeichen	Funktion	Wert	Nr.	Zeichen	Funktion	Wert
1	STX	Start of Text	02h	1	STX	Start of Text	02h
2	nn	ID		2	FF	ID	
4	;	Semikolon		4	;	Semikolon	
5	nn.n	Windgeschwindigkeit (vektoriell)		5	99.9	Windgeschwindigkeit (vektoriell)	
9	;	Semikolon		9	;	Semikolon	
10	nnn	Windrichtung		10	999	Windrichtung	
13	;	Semikolon		13	;	Semikolon	
14	±nn.n	Temperatur		14	±99.9	Temperatur	
19	;	Semikolon		19	;	Semikolon	
20	±nn.n	Windgeschwindigkeit Vy		20	±99.9	Windgeschwindigkeit Vy	
25	;	Semikolon		25	;	Semikolon	
26	nnnnn	Anzahl der Mittelwerte		26	99999	Anzahl der Mittelwerte	
31	;	Semikolon		31	;	Semikolon	
32	nnnn	Statuswort (erweiterter Status)		32	9999	Statuswort (erweiterter Status)	
36	*	Stern		36	*	Stern	
37	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..32 einschließlich)		37	nn	Prüfsumme hexadezimal (2..32 einschließlich)	
39	CR	Carriage Return	0Dh	39	CR	Carriage Return	0Dh
40	LF	Line Feed	0Ah	40	LF	Line Feed	0Ah
41	ETX	End of Text	03h	41	ETX	End of Text	03h

12 Technische Daten

Windgeschwindigkeit	Messbereich	0,01...75m/s (Anlauf: 0,01m/s) Skalierung des Analogausgangs frei wählbar
	Genauigkeit	$\leq 5\text{m/s}$: $\pm 0,1\text{m/s}$ (RMS - Mittel über 360°) $> 5\text{m/s}$: $\pm 2\%$ vom Messwert (RMS - Mittel über 360°)
	Auflösung	0,1m/s: in den Telegrammen: 00001 bis 00005, 00008, 00009 00011 bis 00013
		0,01m/s: in den benutzerdefinierten Telegrammen: (00006)
Windrichtung (Strömungsrichtung)	Messbereich	1°; 181°
Virtuell Temperatur	Messbereich	- 50°C + 70°C
	Genauigkeit	$\pm 0,5\text{K}$ bis 35m/s
	Auflösung	0,1K (in den Telegrammen 00001 bis 00005, 00008, 00009, 00011 bis 00013)
Datenausgabe digital	Schnittstelle	RS 485 / RS 422
	Baudrate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 einstellbar
	Ausgabe	Momentanwerte, Windgeschwindigkeit, -richtung und akustische Virtuelltemperatur Gleitende Mittelwerte 0,5sec..100min frei einstellbar Standardabweichung für Windgeschwindigkeit und akustische Virtuelltemperatur Vordefinierte Telegramme, benutzerdefinierte Telegramme
	Ausgaberate	1 pro 1msec bis 1 pro 60 Sekunden in msec einstellbar
	Statuserkennung	Heizung, Messstreckenausfall
Datenausgabe analog	Elektrischer Ausgang	0 ... +20mA / 0... +10V oder 4... +20mA / 2... +10V Windgeschwindigkeit, Windrichtung und virt. Temperatur
		Bürde am Stromausgang maximal 400Ω
		Bürde am Spannungsausgang minimal 4000Ω
	Ausgabe	Momentanwerte Gleitende Mittelwerte 0,5sec bis 100min frei einstellbar.
	Ausgaberate	Aktualisierungsrate 1Hz bis 100Hz einstellbar.
	Auflösung	16Bit
Analoge Eingänge	Anzahl	Bis zu fünf analoge Eingänge möglich (3 x Standard, 2 x zusätzlich nach Rücksprache mit Hersteller konfigurierbar)
	Auflösung	16Bit
	Abtastrate	0,1Hz.. 100Hz pro Kanal
	Eingangsbereich	0V bis +10,0V
	Datenverarbeitung	Ausgabe der Messwerte im anwenderspezifischen Telegramm
	Genauigkeit	$\pm 0,1\%$ im Bereich -50°C ... +70°C

	Linearität, integral Effective noise free Bits	INL: typ. < 6 LSB Typ. 14 Bit* * bei DC-Versorgung zur Vermeidung von dynamischem Übersprechen in der Anschlussleitung
Allgemein	Interne Messrate	Bis zu 400 Messdatensätze pro Sekunde bei +20°C
	Busbetrieb	Busbetrieb von bis zu 98 Geräten möglich
	Programmupdate	Programmupdate im Busbetrieb möglich
	Temperaturbereich	Betriebstemperatur – 50°C... + 80°C beheizt – 30°C... + 80°C unbeheizt Lagerung – 50°C... + 80°C Messbetrieb mit Heizung bis - 75°C möglich
	Rel. Feuchte	0 ... 100% r.F.
Betriebsspannung	Versorgung: Elektronik - ohne Heizungsbetrieb	U: 8...78V DC oder 12...55V AC, 45...65Hz P: typ. 1,5VA , max. 2,5VA
	Versorgung: Elektronik + Heizung - mit Heizungsbetrieb der US-Arme	U: 24V AC/DC ±15%, 45...65Hz P: typ. 40VA , max. 50VA @ 24V
Ohne Wandlerheizung	Vereisungsresistenz	nach THIES STD 012001
Mit Wandlerheizung	Vereisungsresistenz	nach THIES STD 012002
	Gehäusematerial	Edelstahl (V4A)
	Montageart 4.3865.xx.xxx 4.3866.xx.xxx 4.3867.xx.xxx	Flanschplatte mit Bohrungen Flanschplatte mit Bohrungen Montagefuß
	Anschlussart 4.3865.xx.xxx 4.3866.xx.xxx 4.3867.xx.xxx	Kabelverschraubung und 5m Kabel Stecker Stecker
Abmessung		Siehe Maßbild
	Schutzart	IP 67 (bei bestimmungsgemäßer Montage und ggf. aufgeschraubter und konfektionierter Kupplungsdose, siehe Kapitel „Betriebsvorbereitung“)
	Gewicht	2,5kg

13 Maßbilder

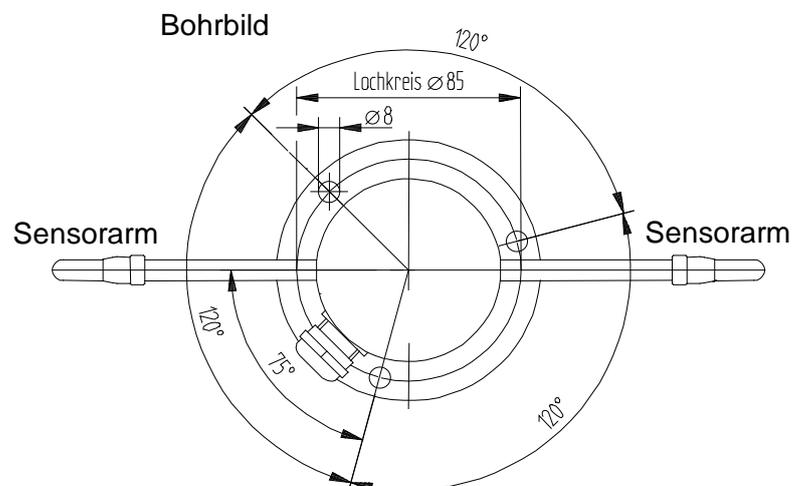
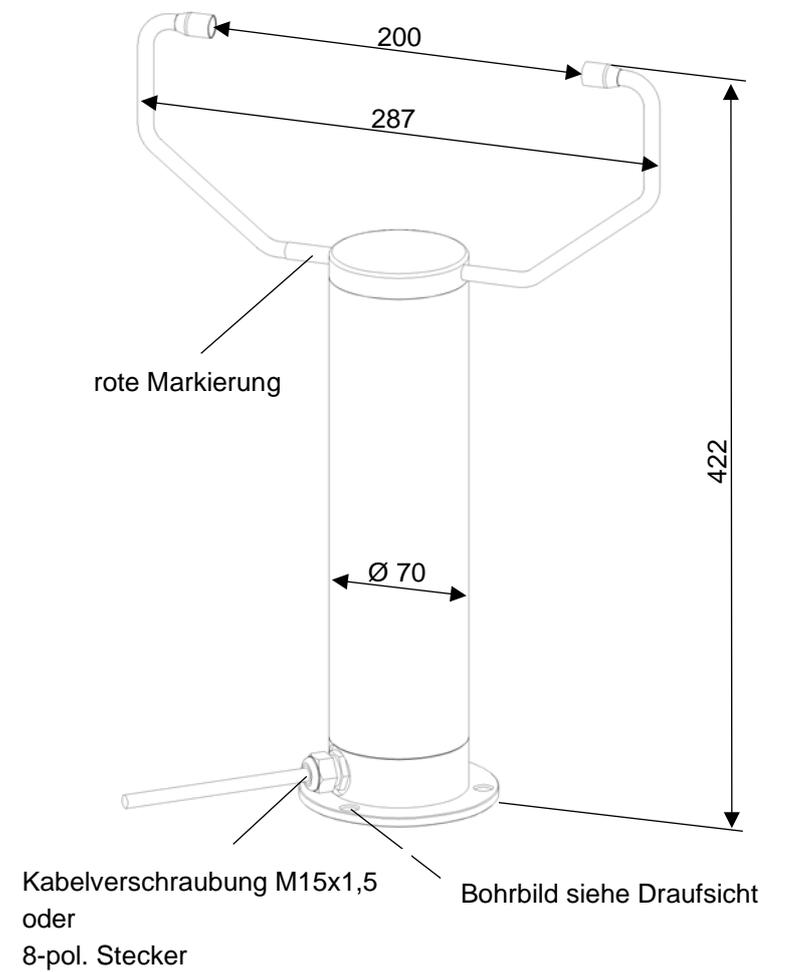


Abbildung 2: Maßbild 4.3865... und 4.3866...

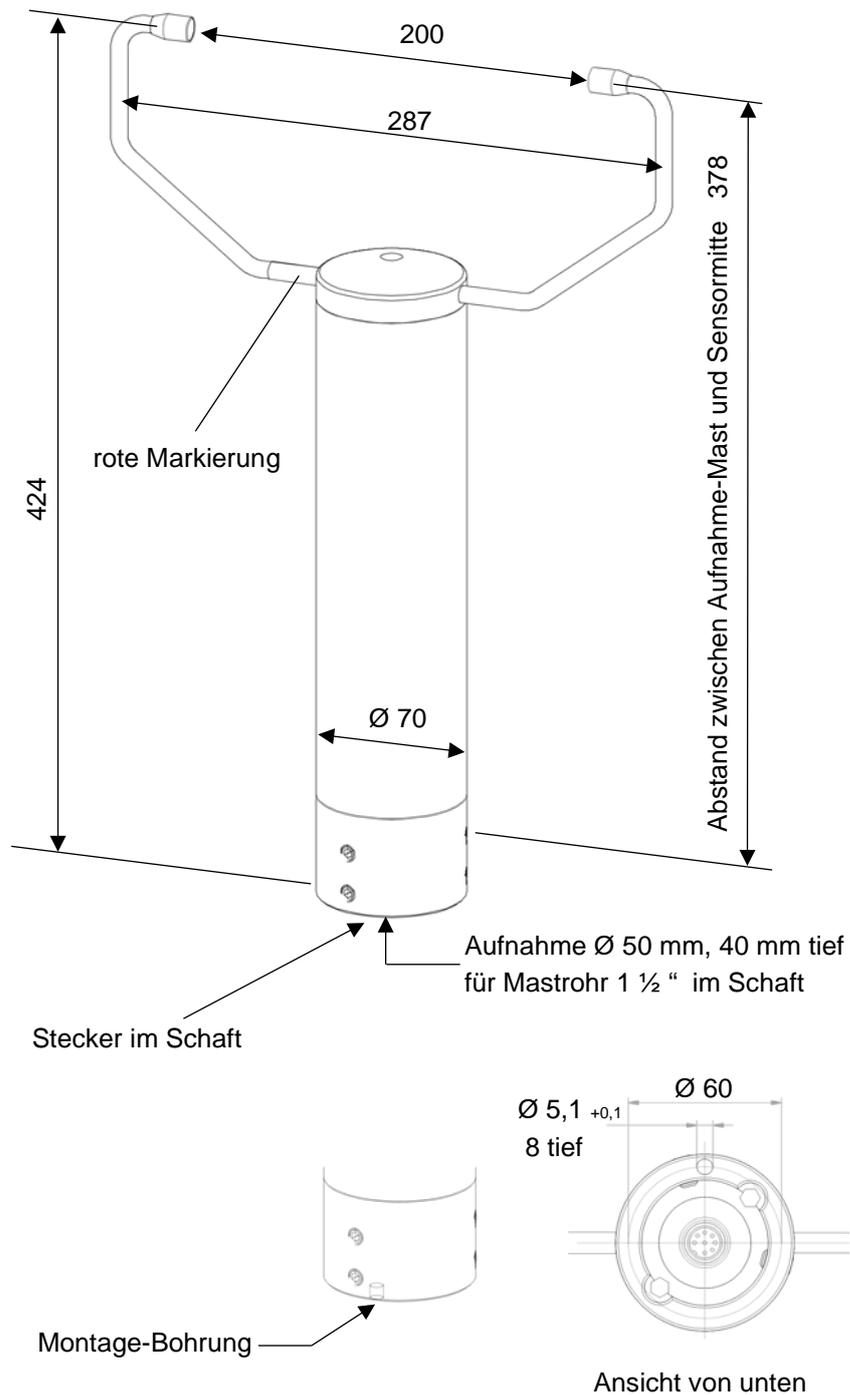


Abbildung 3: Maßbild 4.3867....

14 Zubehör (als Option lieferbar)

Anschlusskabel, komplett	507751	15m Kabel mit geberseitiger Kupplungsdose. Das andere Ende des Kabels ist mit Ader-Kennzeichnungsrings versehen.
PC-Programm Meteo- Online	9.1700.98.000	Zur graphischen Darstellung der gemessenen Werte auf einem PC
Netzgerät	9.3388.00.000	Zur Stromversorgung des US – Anemometer 4.386x.xx.xxx Primär: 230V/50Hz Sekundär: 26V/90VA
Schnittstellenwandler	9.1702.xx.000	Zur RS 422 Signalwandlung in RS 232

15 Weitere Informationen / Dokumente als Download

Weitere Informationen können in der Kurz-BA nachgelesen werden. Diese Dokumente sowie die Bedienungsanleitung liegen unter folgendem Link zum Download bereit.

Kurz-BA

https://www.thiesclima.com/db/dnl/https://www.thiesclima.com/db/dnl/4.386x.xx.xxx_US-Anemometer-1D_d_kurz.pdf

Bedienungsanleitung

https://www.thiesclima.com/db/dnl/4.386x.xx.xxx_US-Anemometer-1D_d.pdf

16 EC-Declaration of Conformity

Manufacturer: Adolf Thies GmbH & Co. KG
 Hauptstraße 76
 37083 Göttingen, Germany
<http://www.thiesclima.com>

Product: Ultrasonic Anemometer 1D

Doc. Nr. 602-44785_CE

Article Overview:

4.3366.00.349	4.3865.00.141	4.3865.00.340	4.3865.00.341	4.3865.01.300	4.3865.01.310	4.3865.01.316	4.3865.02.300	4.3866.00.340	4.3866.00.348
4.3866.01.310	4.3867.00.340	4.3867.01.311							

The indicated products correspond to the essential requirement of the following European Directives and Regulations:

2014/30/EU	26.02.2014	DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
2017/2102/EU	15.11.2017	DIRECTIVE (EU) 2017/2102 of the European Parliament and of the Council of November 15, 2017 amending Directive 2011/65 / EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
2012/19/EU	13.08.2012	DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The indicated products comply with the regulations of the directives. This is proved by the compliance with the following standards:

DIN EN 61000-6-2	2019-11	Electromagnetic compatibility Immunity for industrial environment
DIN EN 61000-6-3:2007 + A1:2011	2011-09	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
DIN EN 61010-1	2020-03	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements
DIN EN 63000	2019-05	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.

Legally binding signature:



General Manager - Dr. Christoph Peper

Legally binding signature:



Development Manager - ppa. Jörg Petereit

This declaration certifies the compliance with the mentioned directives, however does not include any warranty of characteristics.
 Please pay attention to the security advises of the provided instructions for use.

17 UK-CA-Declaration of Conformity

Manufacturer: Adolf Thies GmbH & Co. KG
 Hauptstraße 76
 37083 Göttingen, Germany
<http://www.thiesclima.com>

Product: Ultrasonic Anemometer 1D

Doc. Nr. 602-44785_CA

Article Overview:

4.3366.00.349	4.3865.00.141	4.3865.00.340	4.3865.00.341	4.3865.01.300	4.3865.01.310	4.3865.01.316	4.3865.02.300	4.3866.00.340	4.3866.00.348
4.3866.01.310	4.3867.00.340	4.3867.01.311							

The indicated products correspond to the essential requirement of the following Directives and Regulations:

1091	08.12.2016	The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
RoHS Regulations 2012	01.01.2021	The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
3113	01.01.2021	Regulations: waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The indicated products comply with the regulations of the directives. This is proved by the compliance with the following standards:

BS EN IEC 61000-6-2	25.02.2019	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Immunity standard for industrial environments
BS EN IEC 61000-6-3	30.03.2021	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. Emission standard for equipment in residential environments
BS EN 61010-1+A1	31.03.2017	Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use. General requirements
BS EN IEC 63000	10.12.2018	Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Legally binding signature:



General Manager - Dr. Christoph Peper

Legally binding signature:



Development Manager - ppa. Jörg Peterleit

This declaration certifies the compliance with the mentioned directives, however does not include any warranty of characteristics.

Please pay attention to the security advises of the provided instructions for use.

**Sprechen Sie mit uns über Ihre Systemanforderungen.
Wir beraten Sie gern.**

ADOLF THIES GMBH & CO. KG

Meteorologie und Umweltmesstechnik
Hauptstraße 76 · 37083 Göttingen · Germany
Tel. +49 551 79001-0 · Fax +49 551 79001-65
info@thiesclima.com

www.thiesclima.com

